
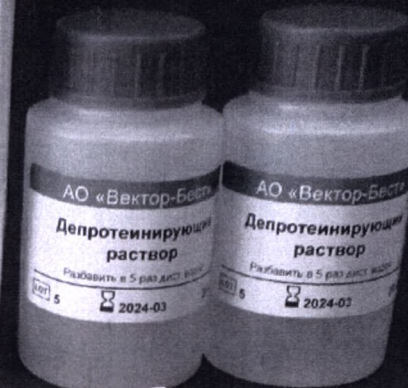


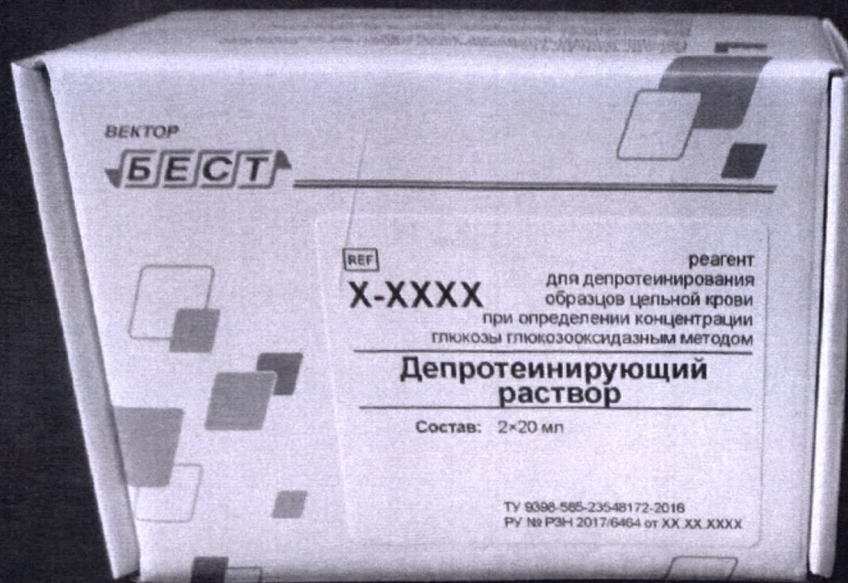

ИНСТРУКЦИЯ
по применению реагента для депротеинирования образцов цельной крови
при определении концентрации глюкозы глюкозооксидазным методом
(Депротеинирующий раствор)

1. НАЗНАЧЕНИЕ
для депротеинирования образцов цельной крови с целью последующего количественного определения концентрации глюкозы подмергают свежезабранные (немедленно после взятия) образцы цельной крови. Возможно использование образцов цельной крови с гепарином и фторидом натрия в качестве ингибиторов гликолиза можно при температуре от 18 до 25 °С не более 1 сут. при температурах от 2 до 8 °С.

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО "Вектор-Бест"
Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492
Приемная: тел. (383)-227-60-30
www.vector-best.ru
vbobtk@vector-best.ru
X-XXXX

ПАСПОРТ № 744-21
Депротеинирующий раствор

Реагент для депротеинирования образцов цельной крови при определении концентрации глюкозы глюкозооксидазным методом

Номер серии 5

Хранить при температуре 2-25°C
Транспортировать при 2-25°C.

Дата изготовления 2021-03
Дата выдачи паспорта 2021-03-03
Срок годности наборов до 2024-03

Внешний вид





№ 2
2024 г.







ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

реагент
для депротенирования
образцов цельной крови
при определении концентрации
глюкозы глюкозооксидазным методом

Депротенирующий раствор

Состав: 2×20 мл

ТУ 9398-585-23548172-2016

ПУ № РЗН 2017/6464 от XX.XX.XXXX



REF

LOT

5

X-XXXXX




2021-03



2024-03

Депротенирующий раствор



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVD



Для профессионального применения