

Фотографические изображения

Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO391084I.

Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO391084I.



Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO391084I



Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO391084I

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test




SD BIOSENSOR

Head office: C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site: 74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Distribution by:

Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com



Authorized Representative
MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80, 66386 St. Ingbert, Germany

Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO3910841



(EN)

For use as part of an IVD method only

CONTENTS

- 1.) Test device (individually in a foil pouch with desiccant) x 25
- 2.) Extraction Buffer Tube x 25
- 3.) Nozzle cap x 25
- 4.) Sterile swab x 25
- 5.) Instructions for use x 1
- 6.) Quick Reference Guide x 1
- 7.) Film (can be attached to the test device when performing outdoor testing) x 25

(HU)

Csak in-vitro diagnosztikai módszer részeként történő felhasználásra

ARTALOM

- 1.) Vizsgálóeszköz (egyenlően fóliás csomagolás szűrőszerezettel együtt) x 25
- 2.) Extraction Buffer Tube puffercső x 25
- 3.) Zárókapok x 25
- 4.) Steril kenetgyűjtő pálcák x 25
- 5.) Használati utasítás x 1
- 6.) Rövid referencia kézikönyv x 1
- 7.) Film (a vizsgálóeszközhöz rögzíthető, ha kültéri vizsgálatot végeznek) x 25

(CS)

Pouze k použití jako součást metody IVD

Obsah

- 1.) Testovací proužek (jednotlivě ve fóliovém obalu s vysoušečem) x 25
- 2.) Zkoumavka s extrakčním pufrům x 25
- 3.) Špičatý uzávěr x 25
- 4.) Sterilní vataová tyčinka x 25
- 5.) Návod k použití x 1
- 6.) Stručný návod x 1
- 7.) Fólie (lze připojit k testovacímu proužku při provádění venkovních testů) x 25

(PL)

Do stosowania wyłącznie w ramach metod diagnostyki in vitro

ZAWARTOŚĆ

- 1.) Pasek testowy (pojedynczo w foliowym woreczku ze środkiem pochłaniającym wilgoć) x 25
- 2.) Probówka z instalacją ekstrakcyjnym x 25
- 3.) Zatyczka z dozownikiem x 25
- 4.) Sterylna wymazówka x 25
- 5.) Instrukcja obsługi x 1
- 6.) Skrócona instrukcja obsługi x 1
- 7.) Folia (może być przyłączona do urządzenia testowego podczas przeprowadzania testów zewnętrznych) x 25

Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO391084I

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test


25 TESTS
KIT

REF 9901-NCOV-01G

For use as part of an IVD method only

CONTENTS

- 1.) Test device (individually in a foil pouch with desiccant) x 25
- 2.) Extraction Buffer tube x 25
- 3.) Nozzle cap x 25
- 4.) Sterile swab x 25
- 5.) Instructions for use x 1
- 6.) Quick Reference Guide x 1
- 7.) Film (can be attached to the test device when performing outdoor testing) x 28



Distribution by:



Q.C

Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO391084I



Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO391084I, в составе:

1. Тест-полоска в индивидуальной упаковке, 25 шт
2. Пробирка с экстрагирующим буфером, 25 шт
3. Крышка с пипеткой, 25 шт.
4. Зонд-тампон стерильный, 25 шт.
5. Пленка защитная
6. Краткое справочное руководство
7. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № _ от _____

Срок годности см. на упаковке

Срок годности изделия не подтвержден в режиме реального времени

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «SD Biosensor, Inc.» («СД Биосенсор, Инк.»)

C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, Republic of Korea

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д. 2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.recaption_dia@roche.com

Только для профессионального применения

Кат. номер 09327592190


Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO3910841, в составе:

1. Тест-полоска в индивидуальной упаковке, 25 шт



Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO391084I, в составе:

1. Тест-полоска в индивидуальной упаковке, 25 шт

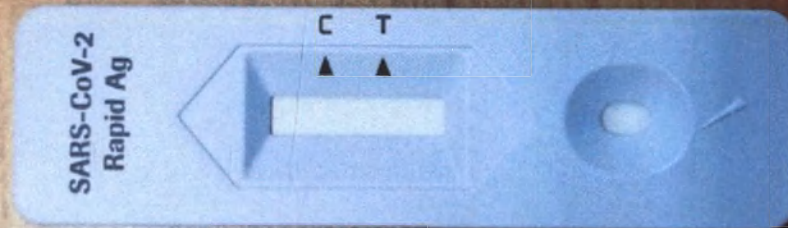

Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO391084I, в составе:

2. Пробирка с экстрагирующим буфером, 25 шт;



Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO391084I, в составе:

3. Крышка с пипеткой, 25 шт.



Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO391084I, в составе:

4. Зонд-тампон стерильный, 25 шт.



Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO391084I, в составе:

4. Зонд-тампон стерильный, 25 шт.




Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO391084I, в составе:

4. Зонд-тампон стерильный, 25 шт.




Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO391084I, в составе:

5. Пленка защитная

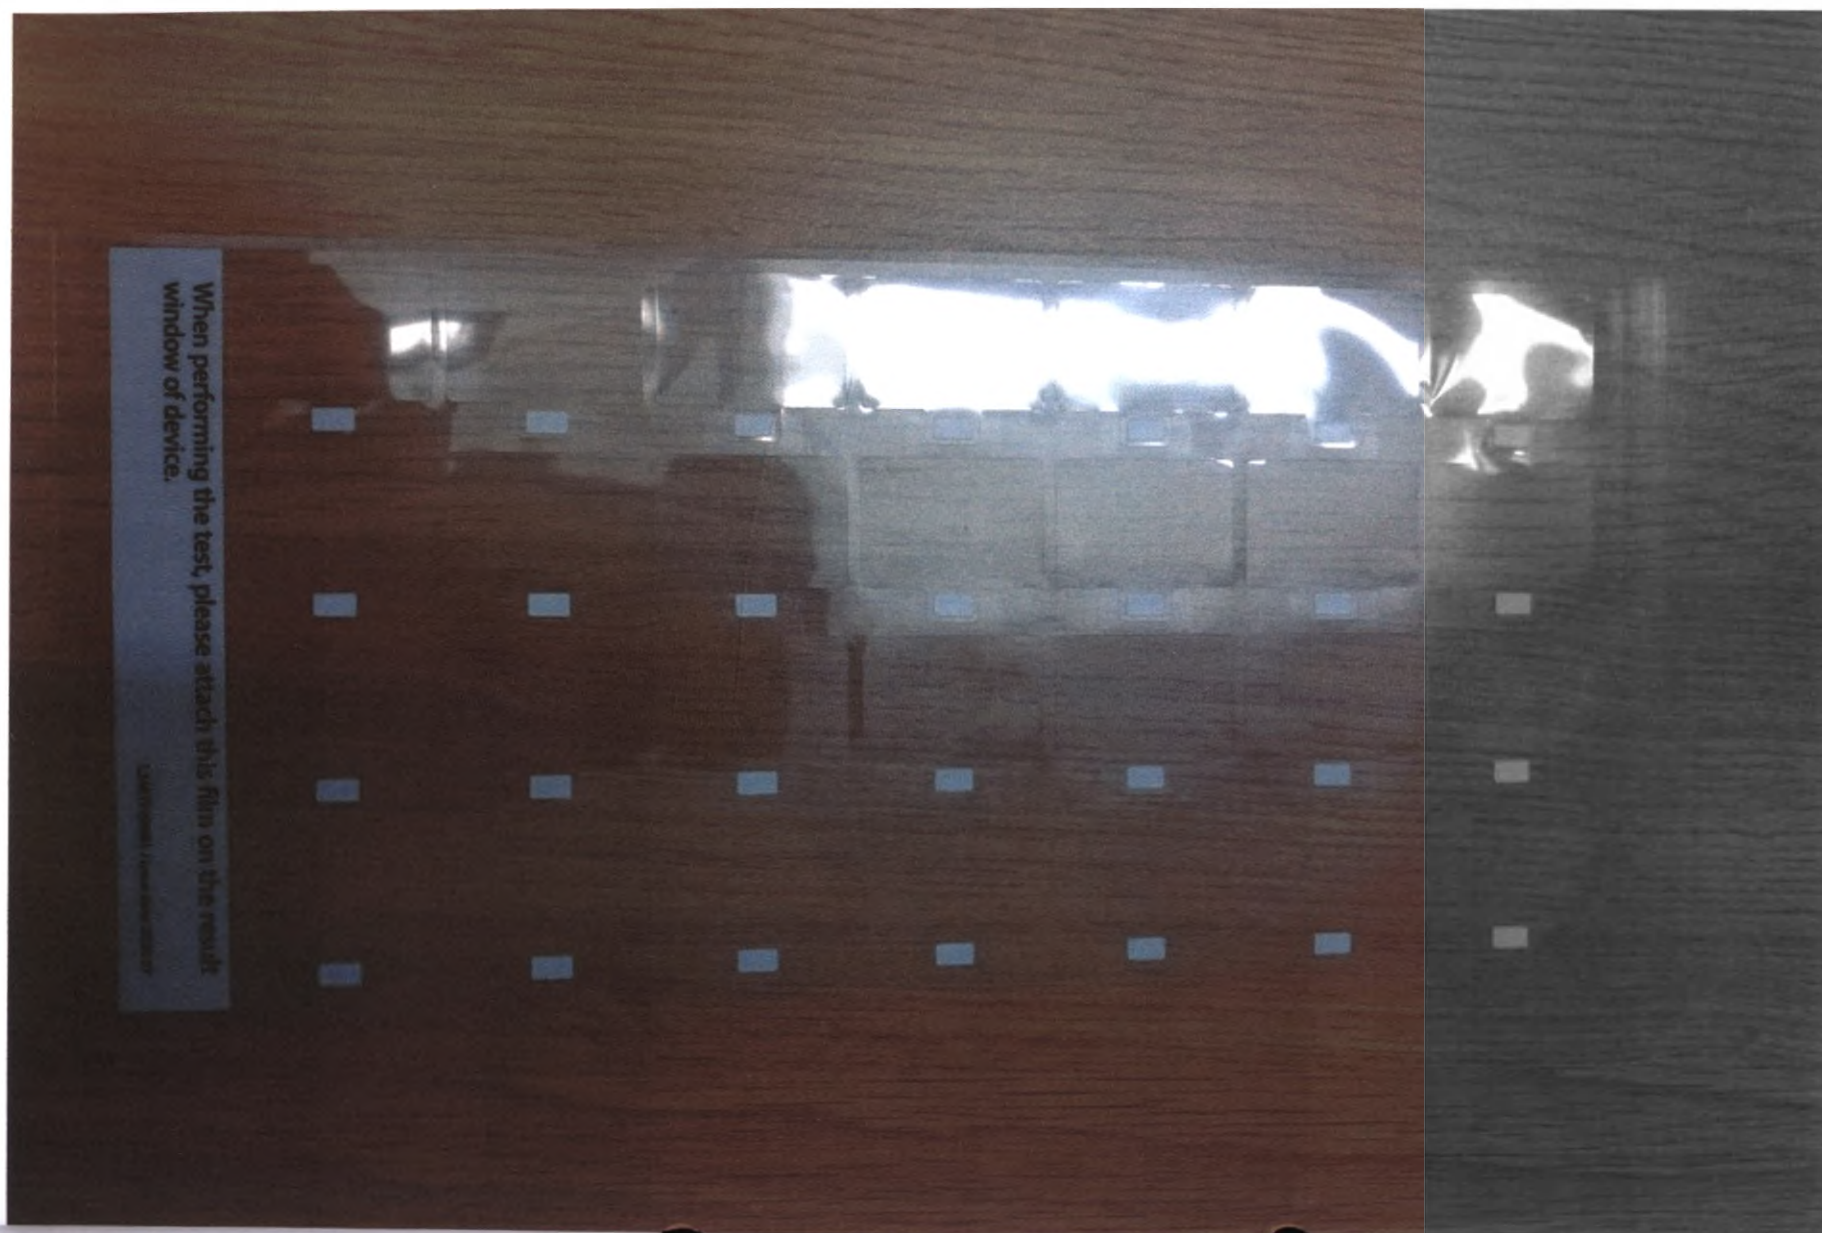

Набор реагентов для качественного экспресс определения специфических антигенов SARS-CoV-2 в мазке со слизистой оболочки носоглотки человека иммунохроматографическим методом (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Серия: LOT QCO391084I, в составе:

6. Краткое справочное руководство

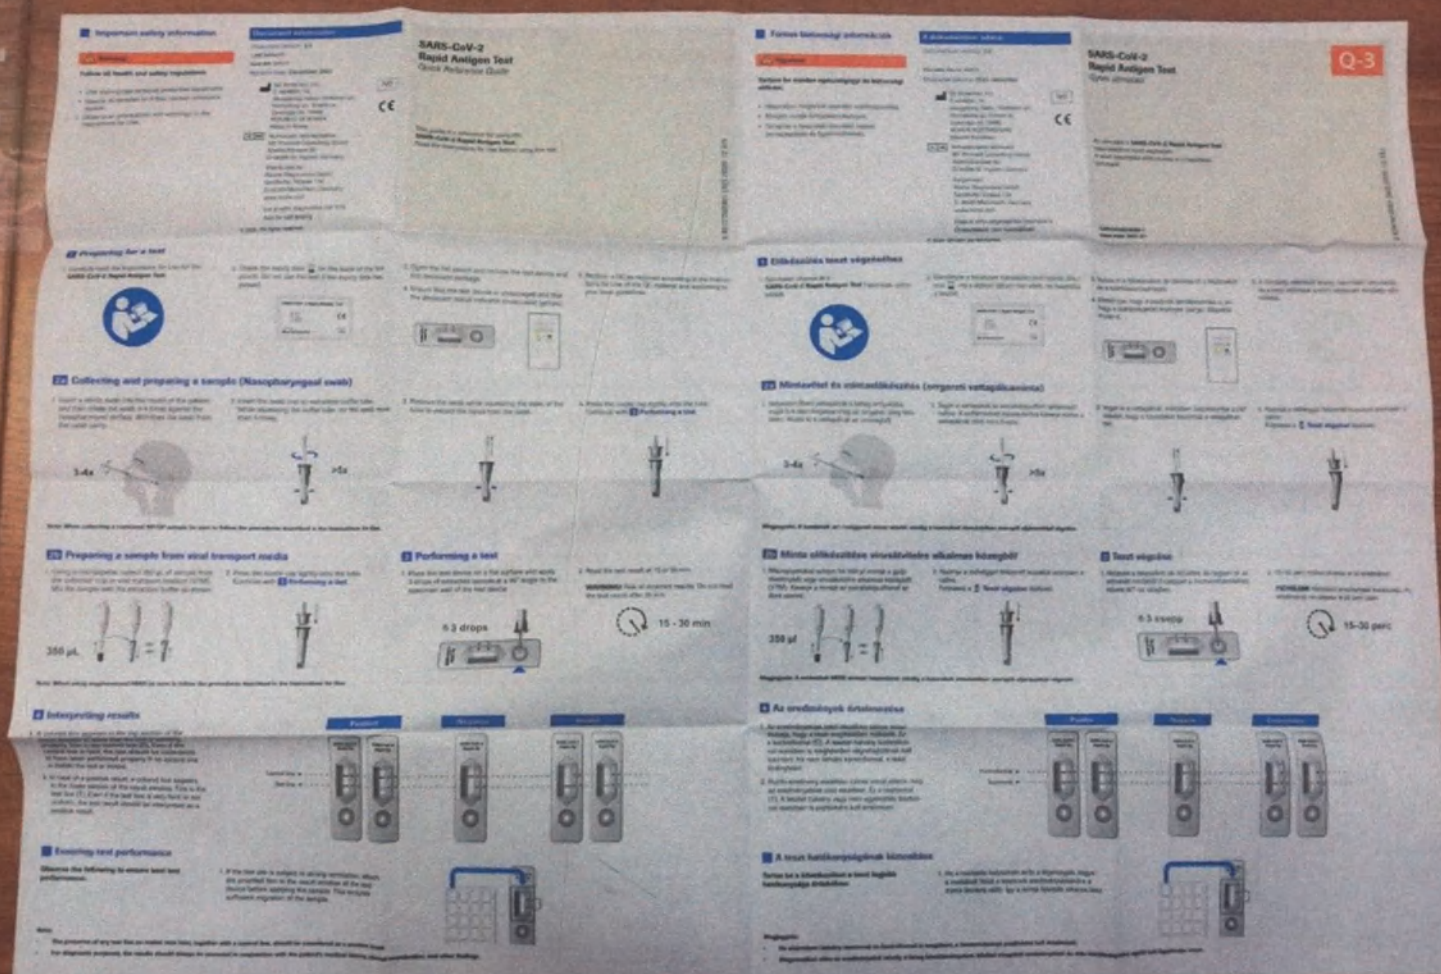

7. Инструкция по применению

3927-01 7 2.0



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
листа (ов) *12*