




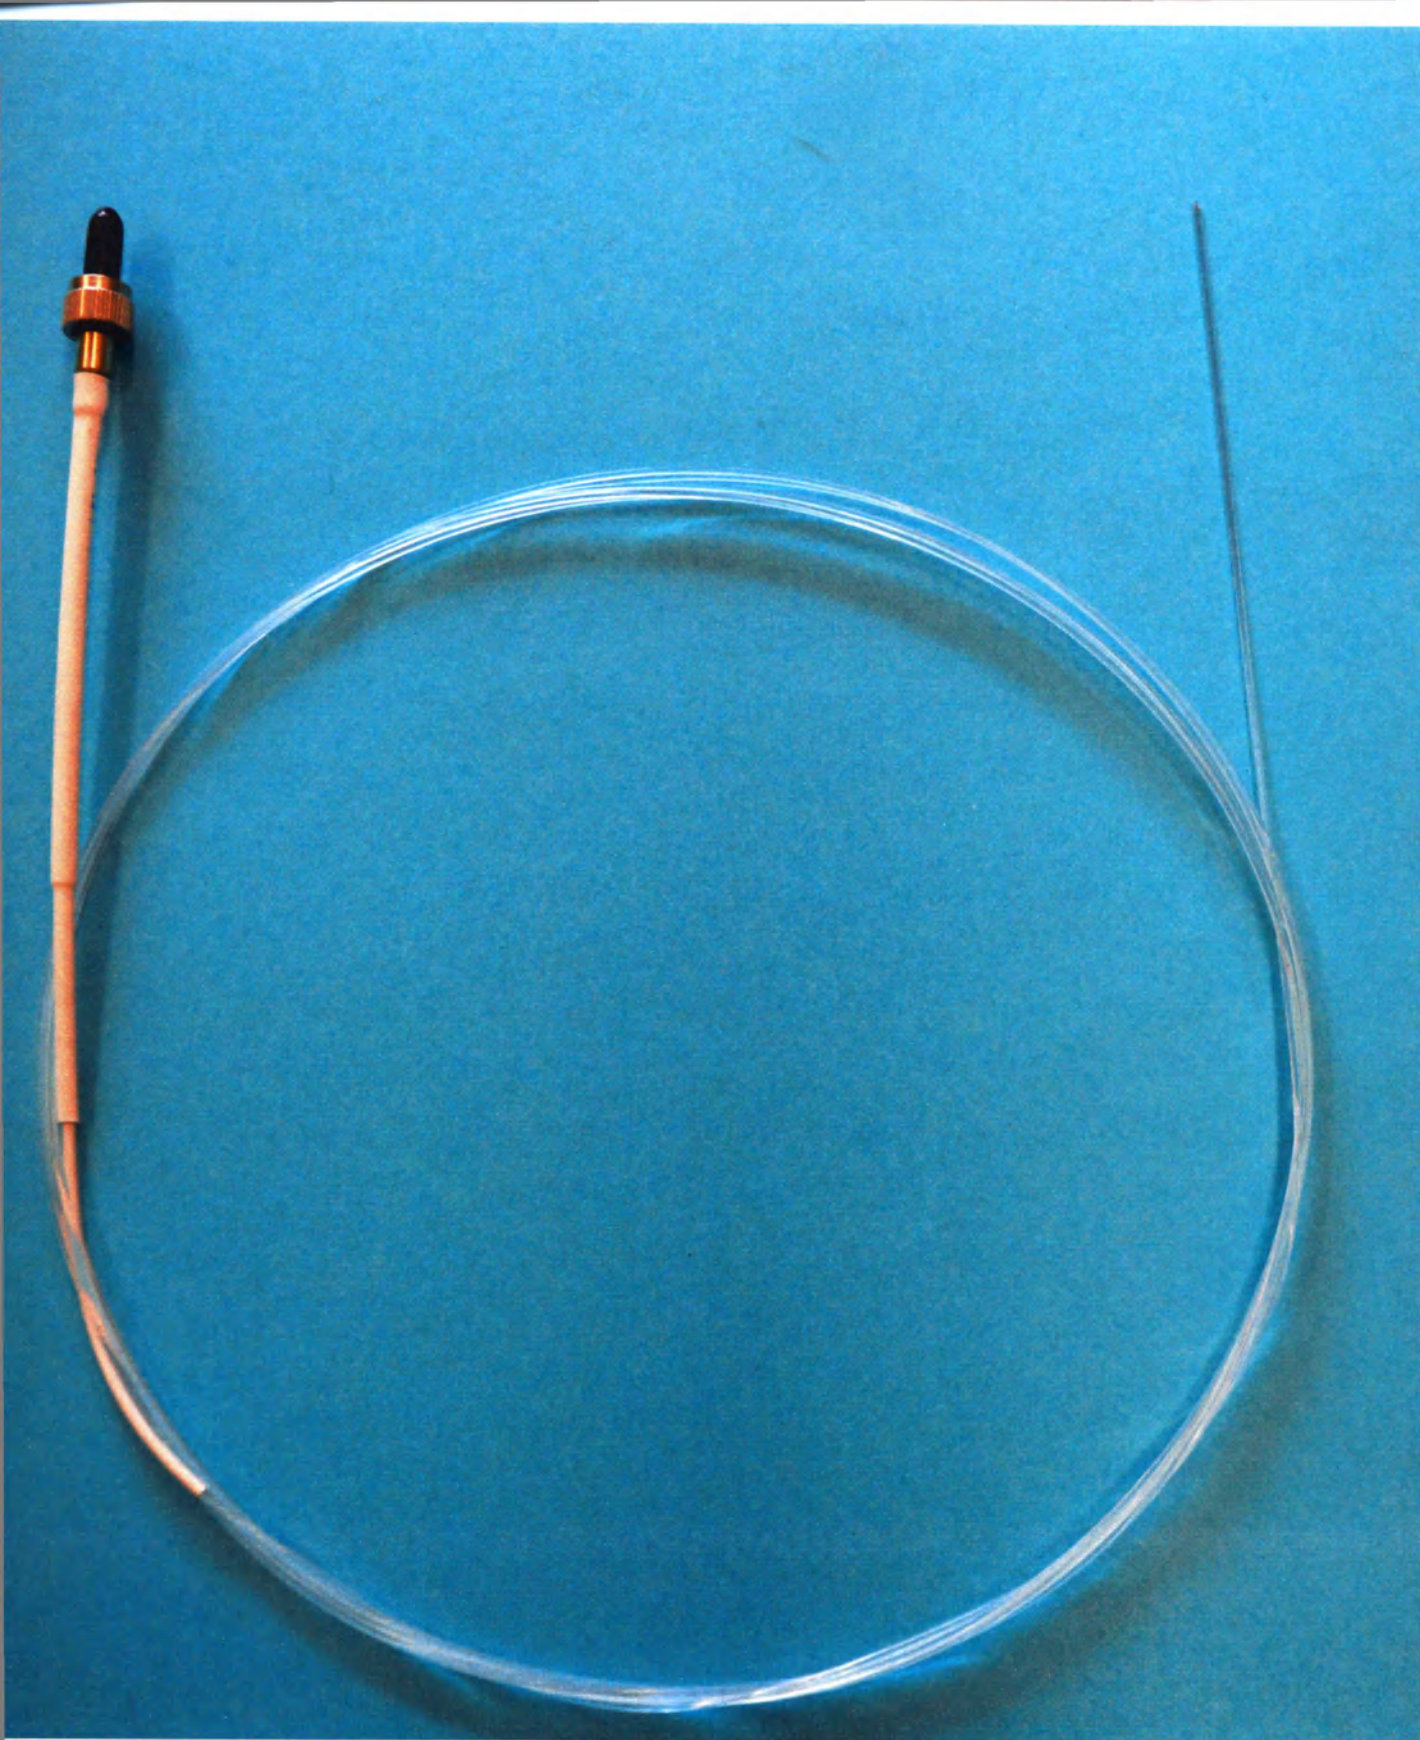


Световод с прямым выходом излучения

Световод диффузионного типа

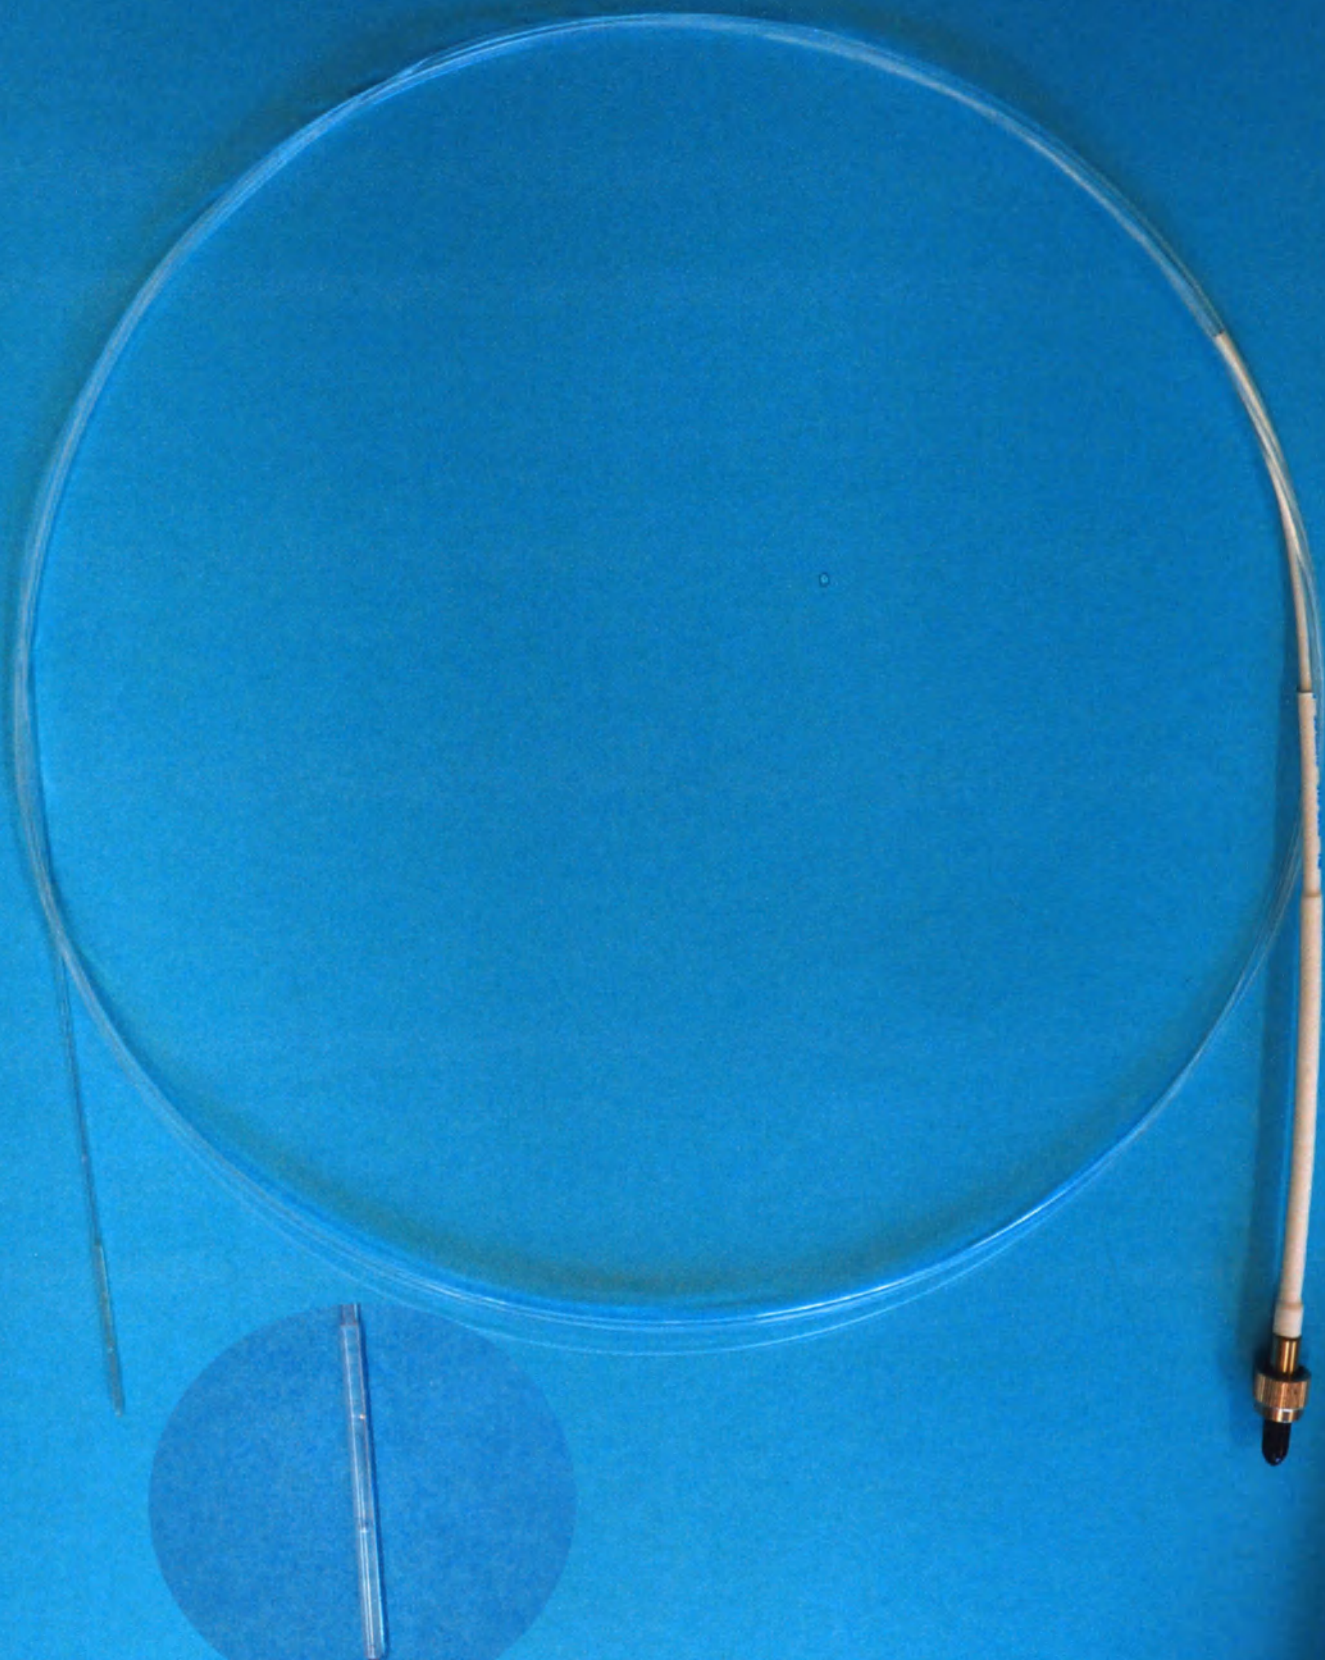


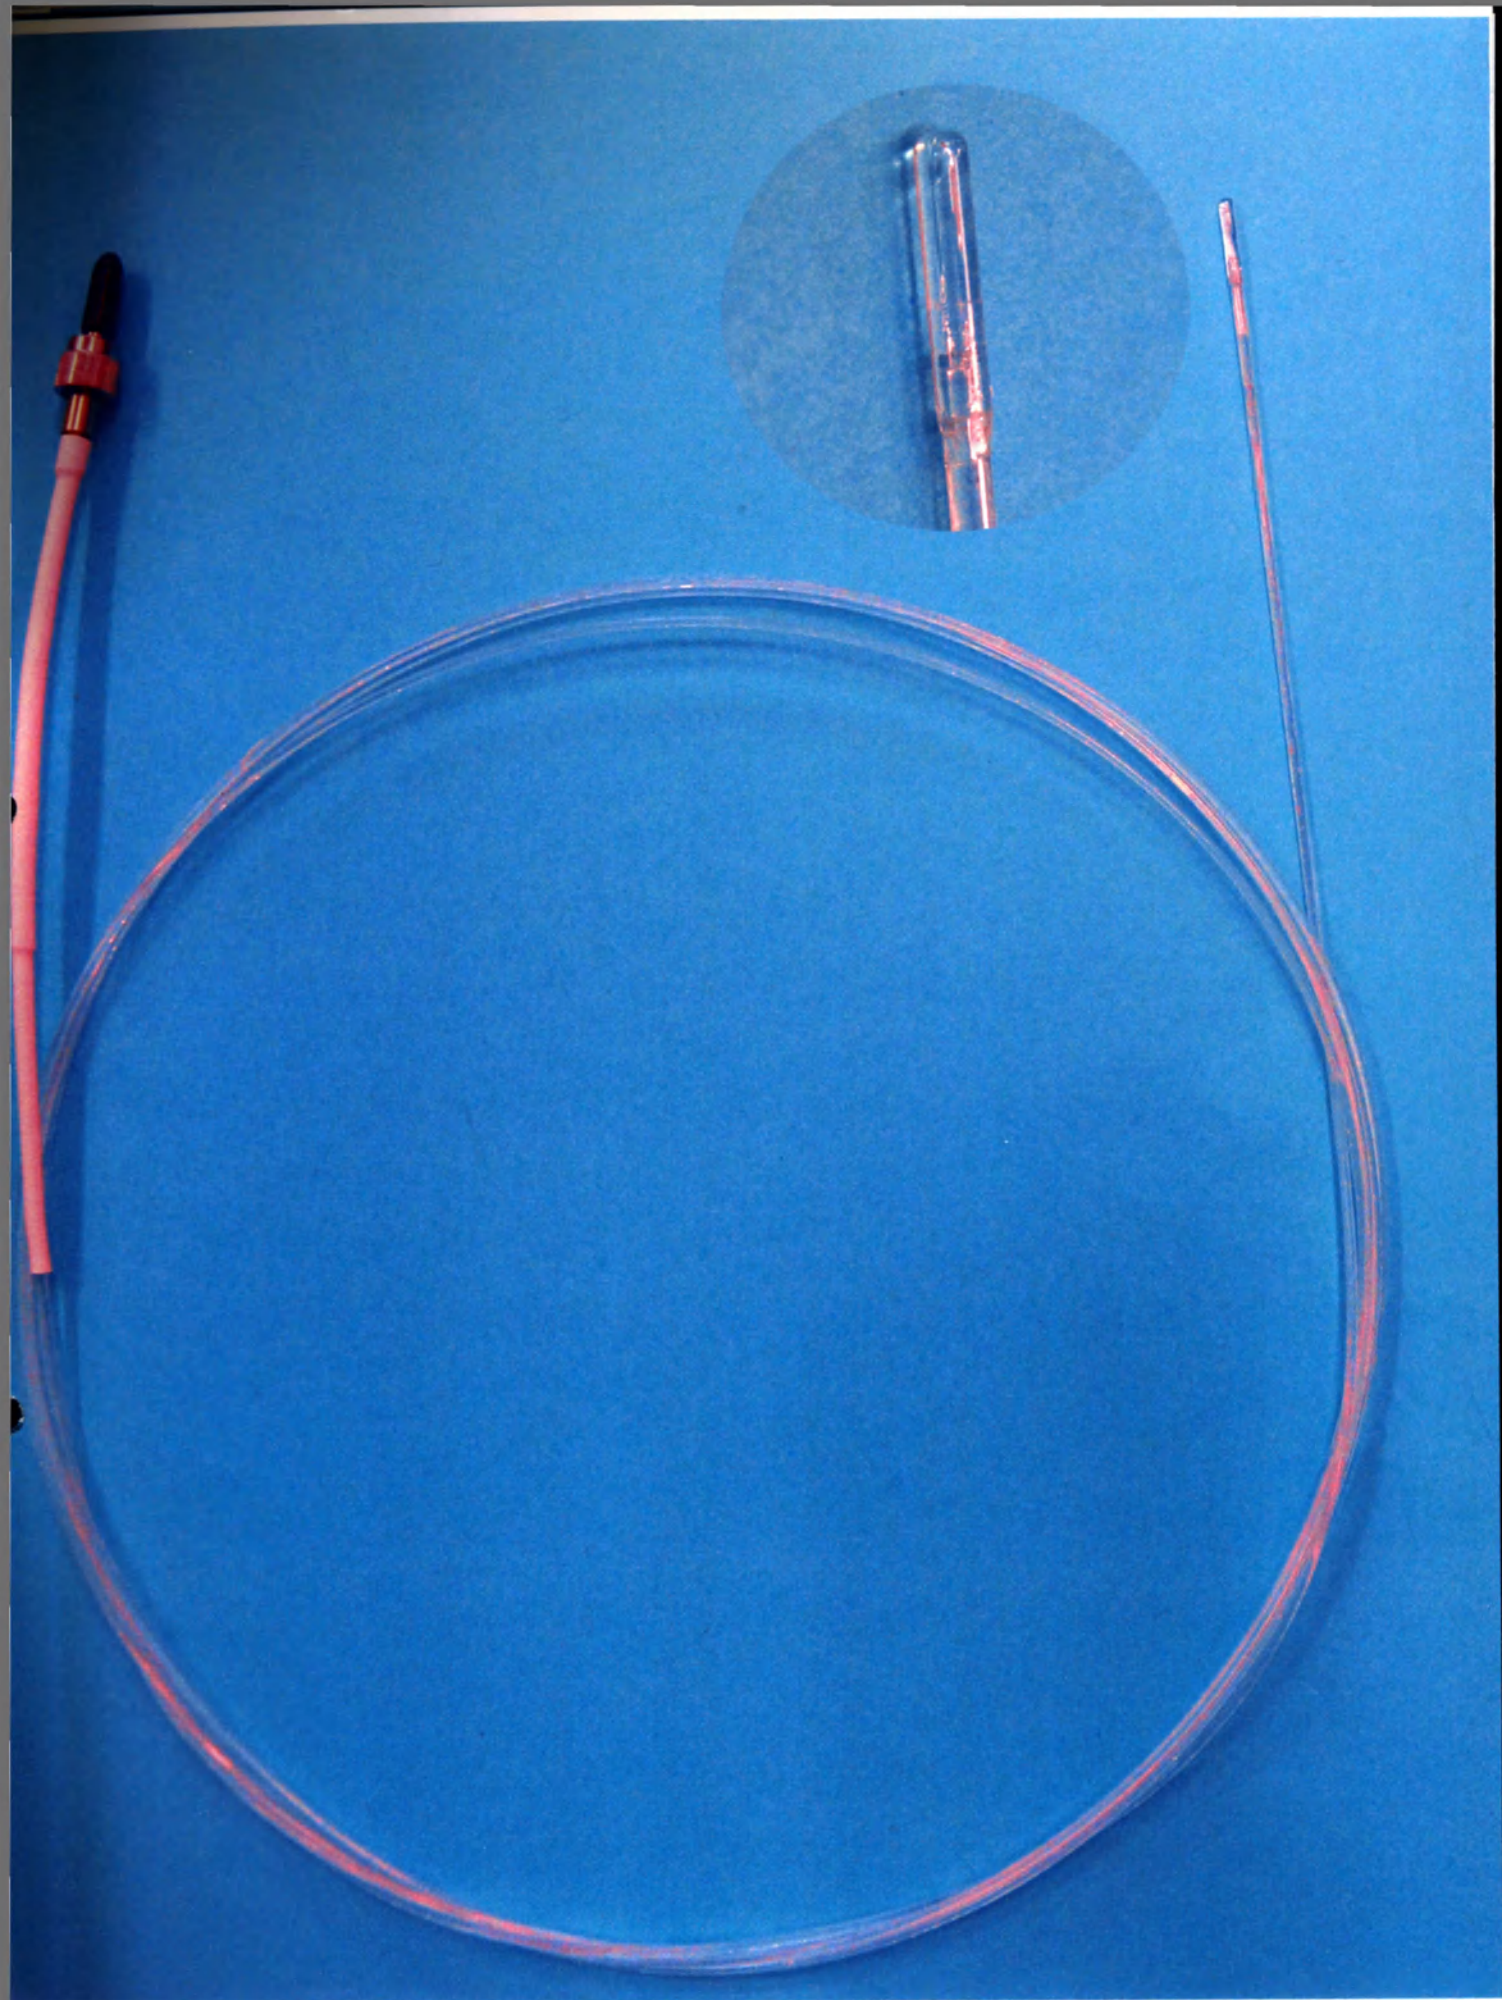


Световод с боковым выходом излучения

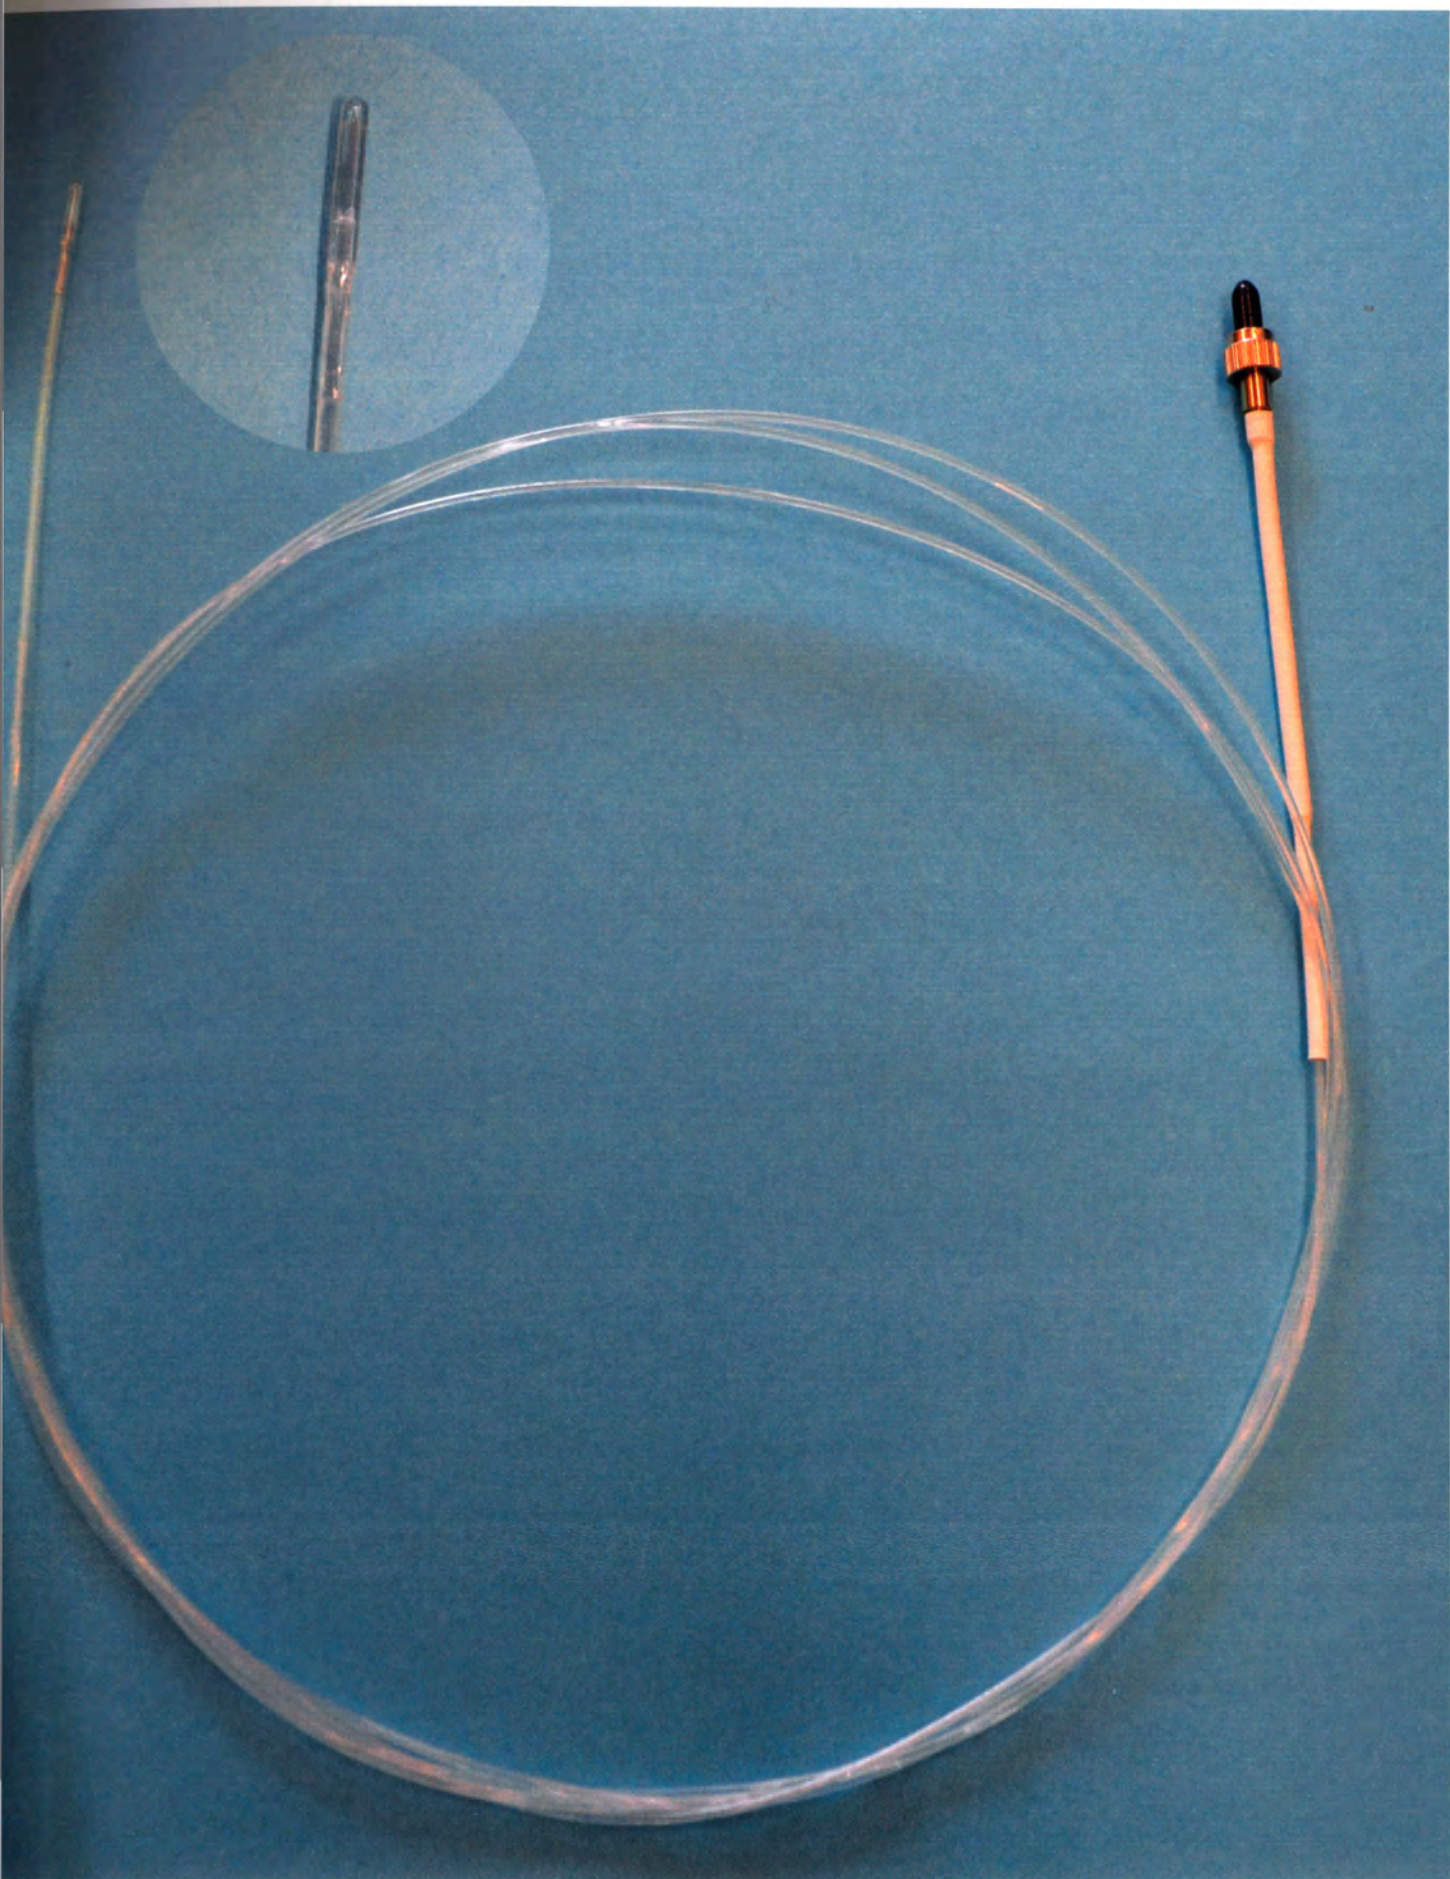

Световод с кольцевой диаграммой рессеяния

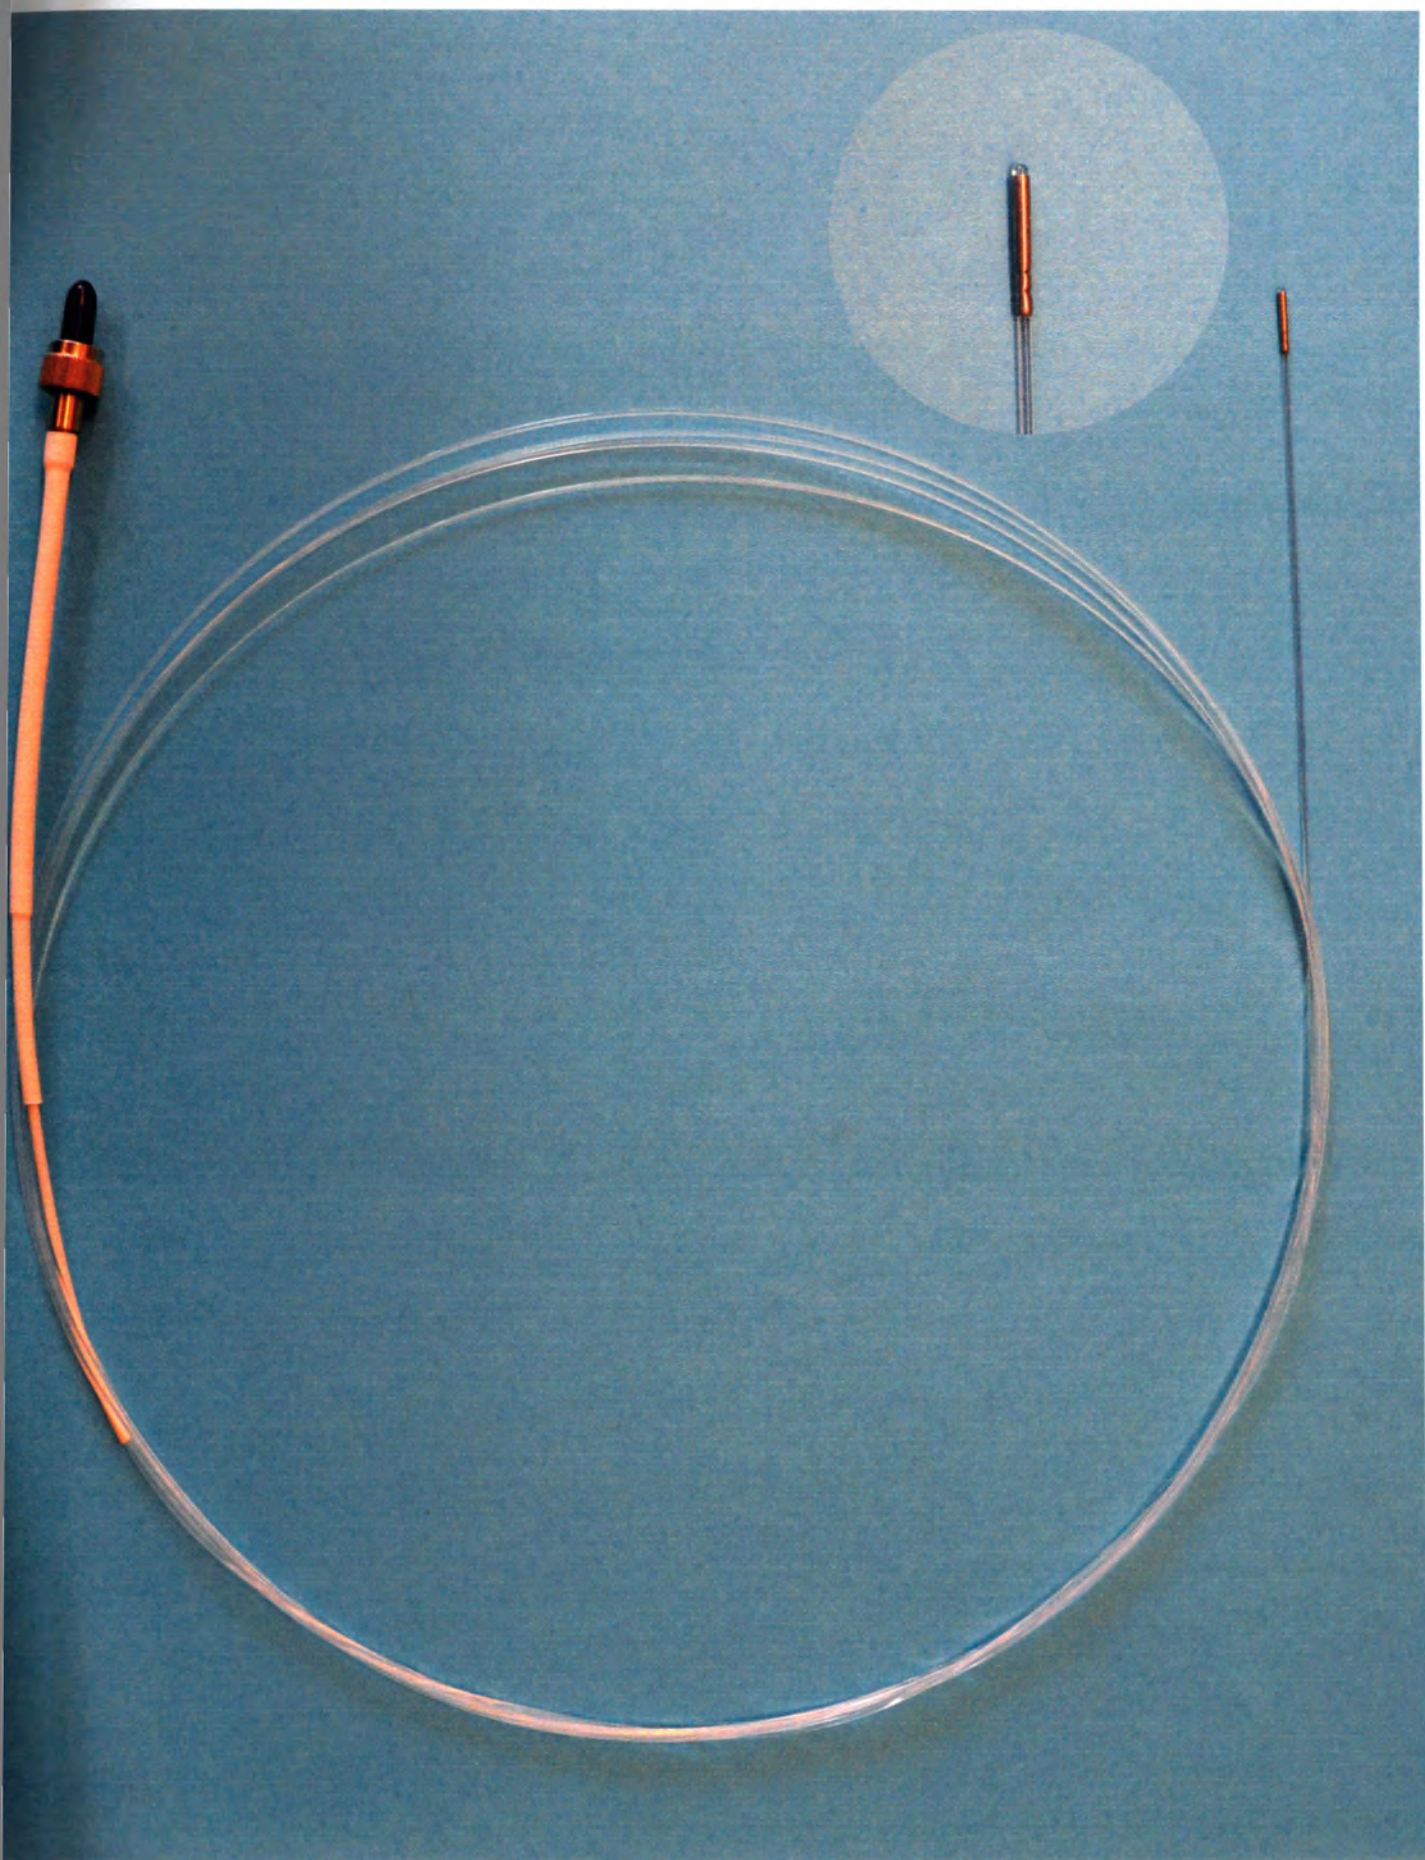


Световод с микролинзой

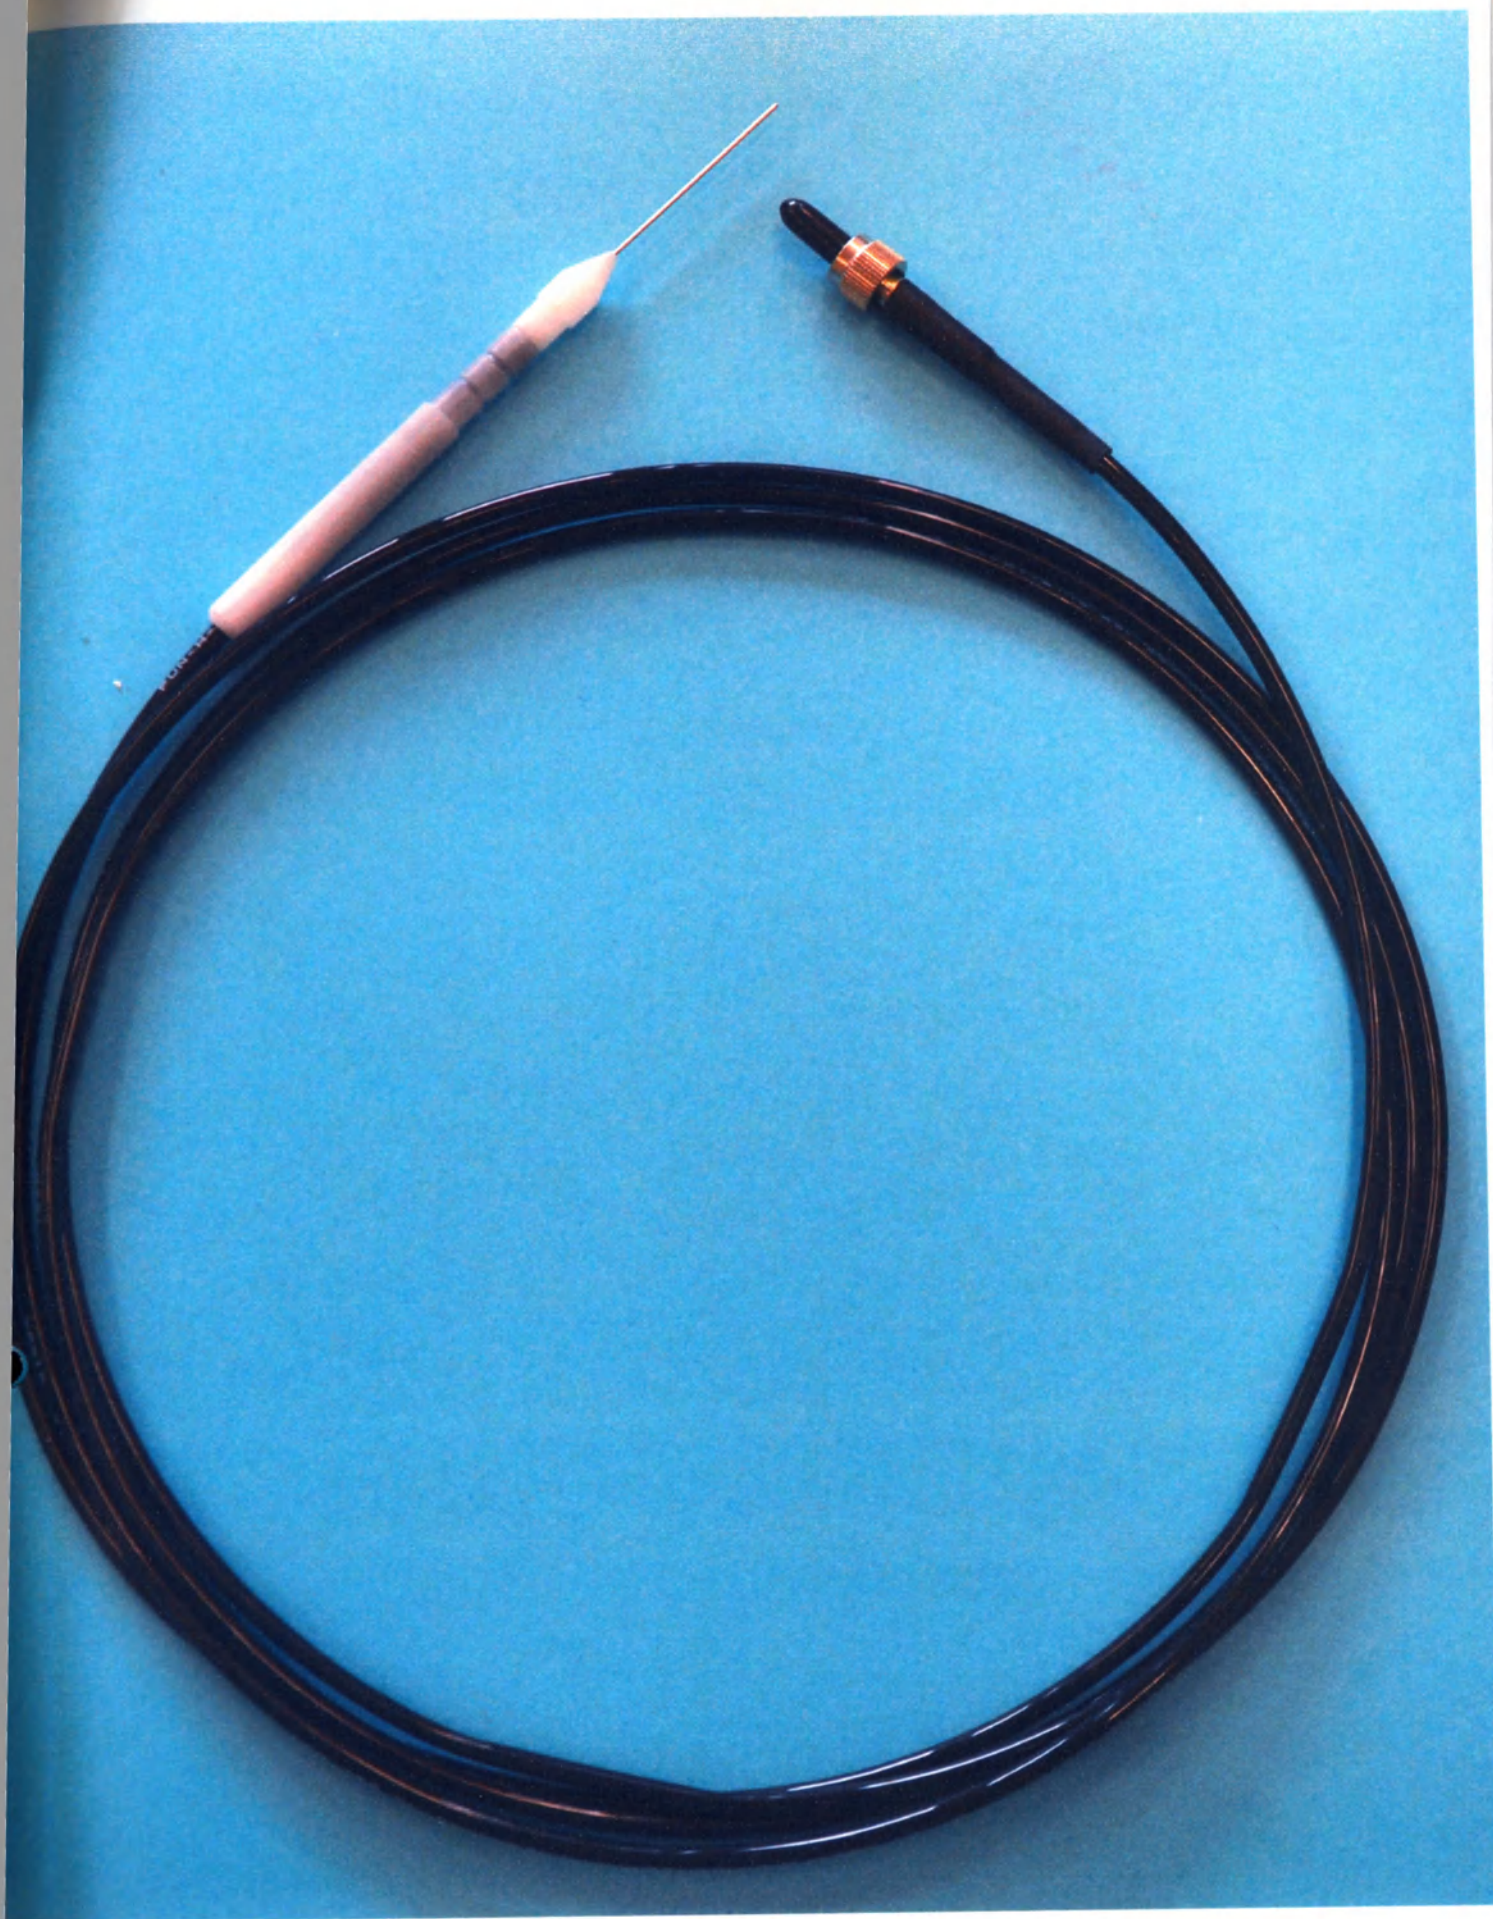

Световод-эндозонд

Световод-эндоскоп с боковым выходом излучения



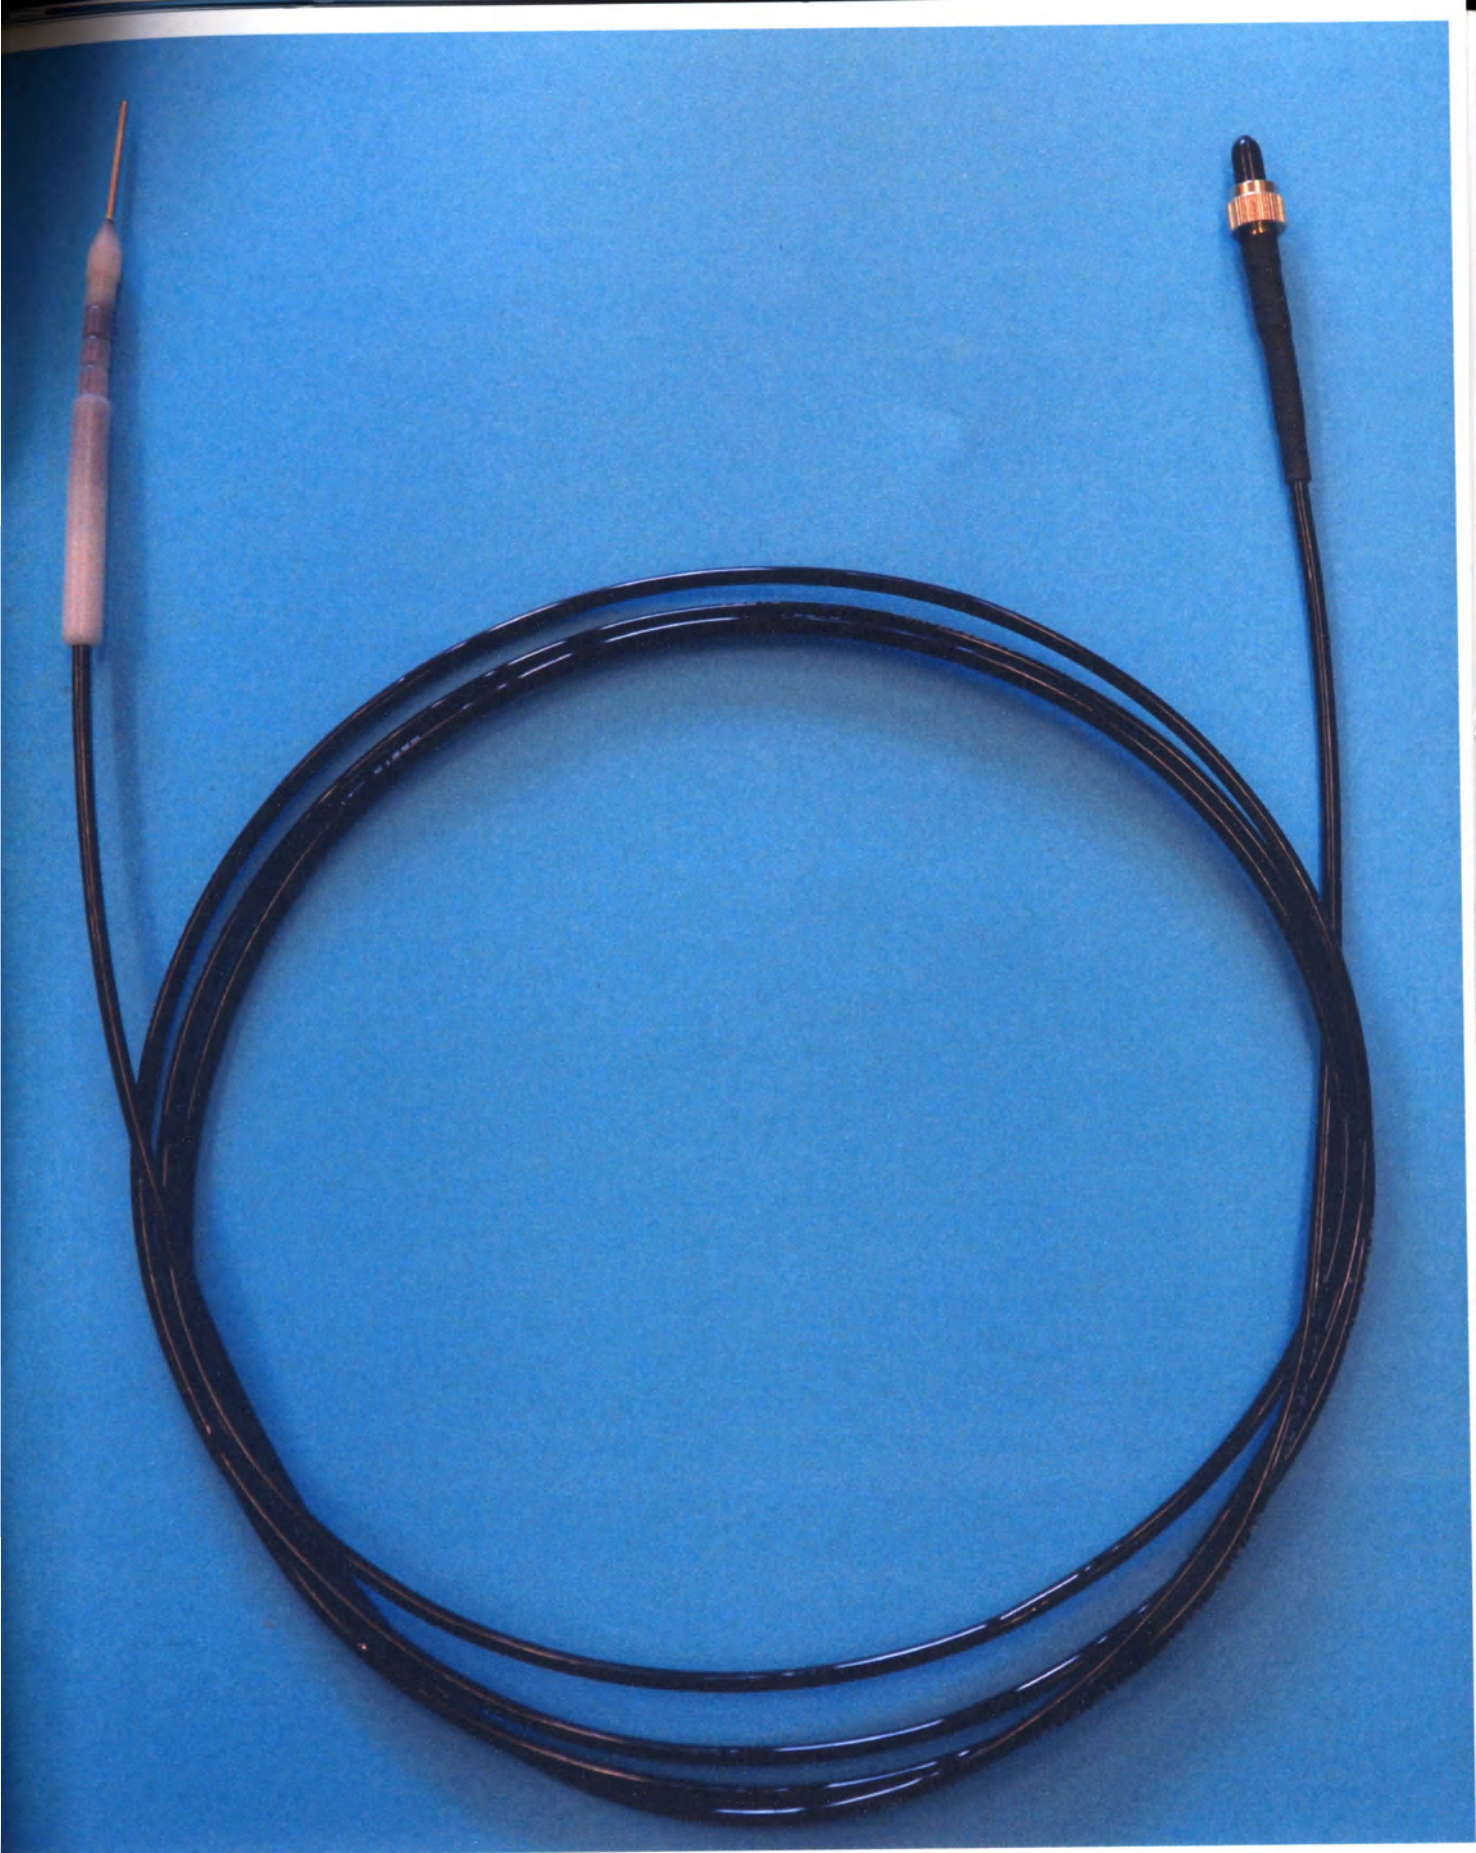


Световод трансклеральный



Световод с коническим окончанием

Световод с линзой для облучения биотканей

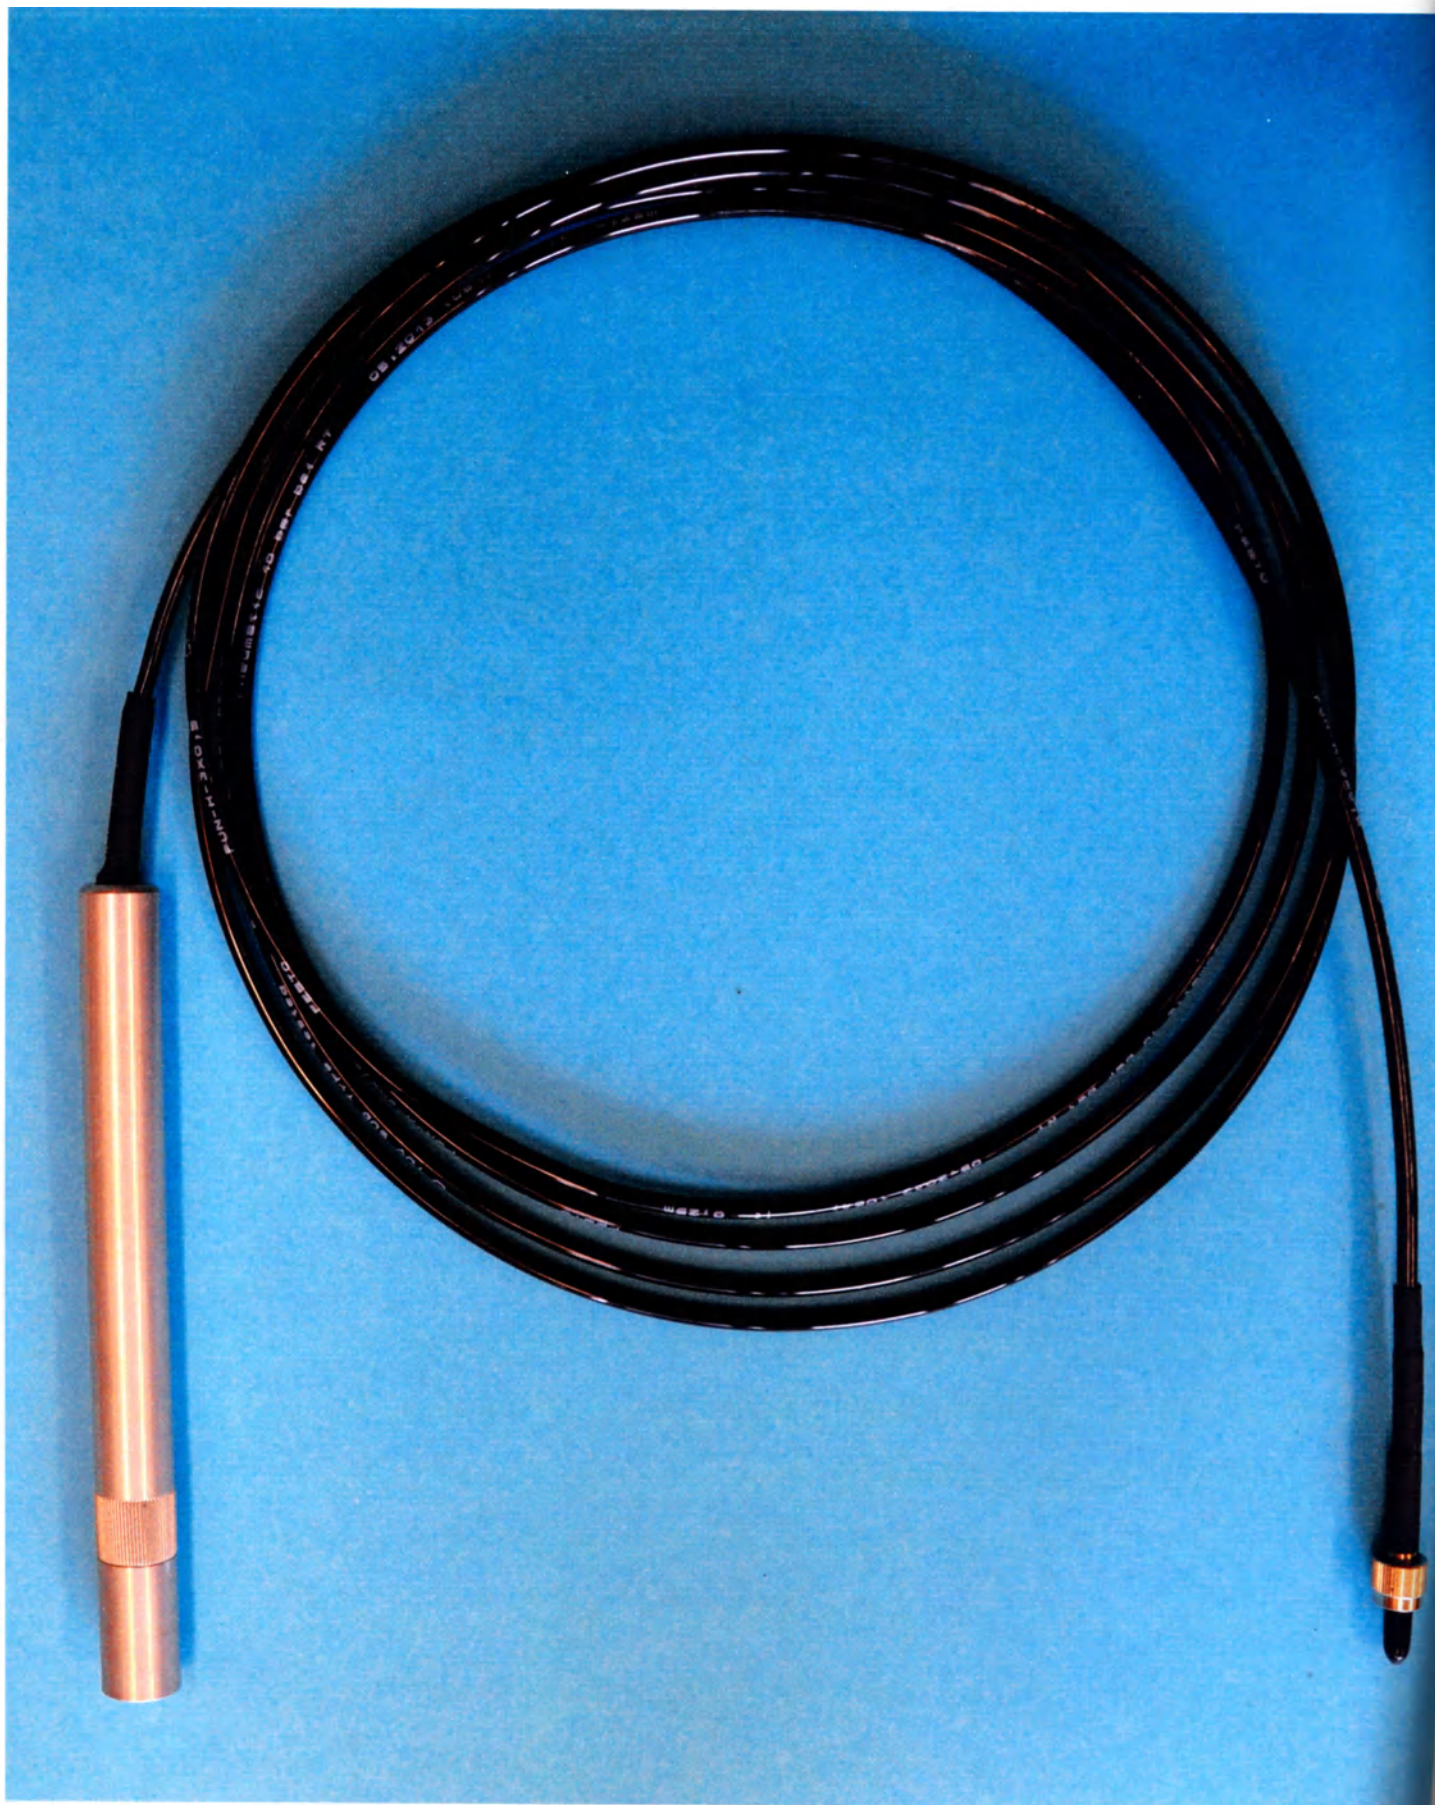



Световод с фокусирующей линзой



ПОЛИРОНИК

общество с ограниченной ответственностью
119991 ГСП-1 г. Москва, Ул. Вавилова, д. 38
т. (499) 132-6056 т/ф (499) 503-87-74 E-mail: polironik@nsc.gpi.ru
www.polironik.ru

**«СВЕТОВОД ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ «СИЛМА-01»
ТУ 9444-007-17515211-2015**



Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Световод с диффузионного типа

Габаритные размеры (длина x диаметр, мм) 3000x9

НЕСТЕРИЛЬНО

Дата изготовления « 08 » июля 2015г.

Партия № 1

Срок годности до « 08 » июля 2020г.

Срок эксплуатации: в течении 2 лет с начала эксплуатации.

УТИЛИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

Световоды, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными законодательством Российской Федерации (СанПиН 2.1.7.2790).

Неиспользованные Световоды (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов), или с истекшим сроком хранения (годности) должны быть утилизированы в соответствии с порядком утилизации твердых бытовых отходов, установленным законодательством Российской Федерации.

Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150

"СВЕТОВОД ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ «СИЛМА-01».
Пример индивидуальной упаковки: индивидуальная упаковка выполнена
из пленки полиэтиленовой по ГОСТ 10354"



"ПОЛИРОНИК"
общество с ограниченной ответственностью
119991 ГСП-1 г. Москва, Ул. Вавилова, Д.38
т. (499) 132-6056 т/ф (499) 503-87-74 E-mail: polironik@nsc-gsp.ru
www.polironik.ru

СВЕТОВОД ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ «СИЛМА-01»
ТУ 9444-007-17515211-2015



Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Световод с прямым выходом излучения

Габаритные размеры (длина x диаметр, мм) 3000x9

НЕСТЕРИЛЬНО

Дата изготовления « 08 » июля 2015г.

Партия № 1

Срок годности до « 08 » июля 2020г.

Срок эксплуатации: в течении 2 лет с начала эксплуатации.

УТИЛИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

Световоды, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными законодательством Российской Федерации (СанПиН 2.1.7.2790).

Неиспользованные Световоды (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов), или с истекшим сроком хранения (годности) должны быть утилизированы в соответствии с порядком утилизации твердых бытовых отходов, установленным законодательством Российской Федерации.

Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150

«СВЕТОВОД ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ «СИЛМА-01».
Пример индивидуальной упаковки: индивидуальная упаковка выполнена из материала упаковочного комбинированного медицинского стрерилизационного «Dispodent», производства Sigma Medical Supplies Corp., Taiwan («Сигма Медикал Санплайз Корп., Тайвань»).



"ПОЛИРОНИК"

общество с ограниченной ответственностью
119991 ГСП-1 г.Москва, Ул.Вавилова, Д.38
т.(499)132-6056 т/ф (499) 503-87-74 E-mail: polironik@nsc.gpi.n
www.polironik.ru

СВЕТОВОД ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ «СИЛМА-01»
ТУ 9444-007-17515211-2015

Наименование	НД	Кол-во, шт.
Световод для лазерной медицинской аппаратуры «СИЛМА-01»:	ТУ 9444-007-17515211-2015	
1. Световод с прямым выходом излучения	ИПВО.944439.007-01	1
2. Световод диффузионного типа	ИПВО.944439.007-02	1



Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НЕСТЕРИЛЬНО

Дата изготовления « 08 » июля 2015г.

Партия № 1

Срок годности до « 08 » июля 2020г.

Срок эксплуатации: в течении 2 лет с начала эксплуатации.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование комплекта в упаковке завода-изготовителя может производиться всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования комплекта - по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

УТИЛИЗАЦИЯ

Световоды, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными законодательством Российской Федерации (СанПиН 2.1.7.2790).

Неиспользованные Световоды (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов), или с истекшим сроком хранения (годности) должны быть утилизированы в соответствии с порядком утилизации твердых бытовых отходов, установленным законодательством Российской Федерации.

"СВЕТОВОД ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ «СИЛМА-01».
Пример потребительской упаковки"

