

Руководитель группы регистрации  
ООО «Сименс Здравоохранение»

«29 сентября» 2021 г.  
Н.А. Горшкова



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор контрольных материалов для определения витамина D на анализаторах  
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total Quality Control (Atellica IM  
VitD QC))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

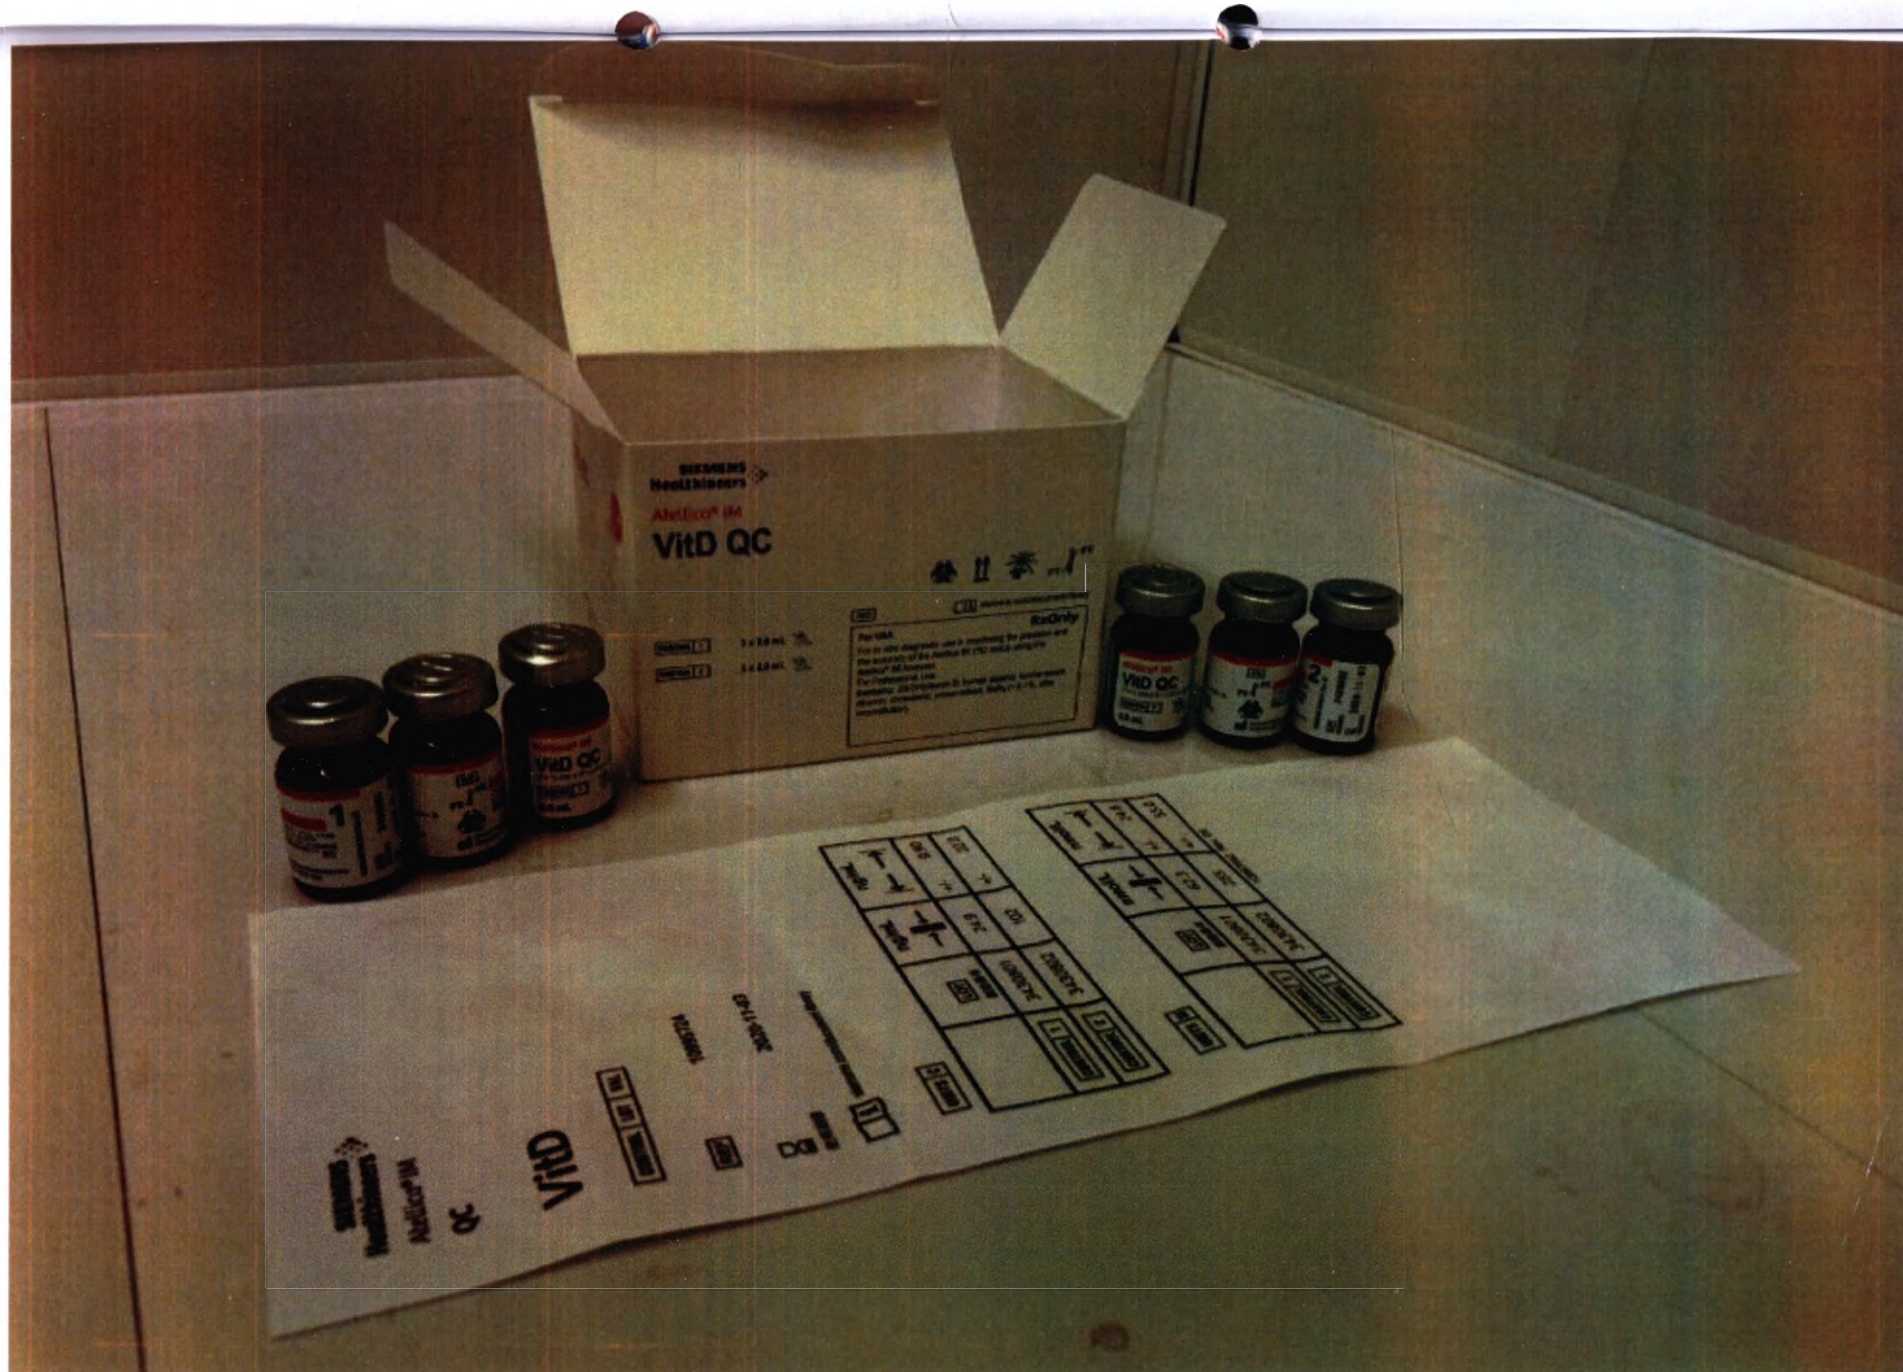


Рисунок 1. Набор контрольных материалов для определения витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total Quality Control (Atellica IM VitD QC)). Общий вид



Рисунок 2. Набор контрольных материалов для определения витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total Quality Control (Atellica IM VitD QC)): Контрольный материал 1-го уровня Atellica IM VitD QC CONTROL 1, 2,0 мл

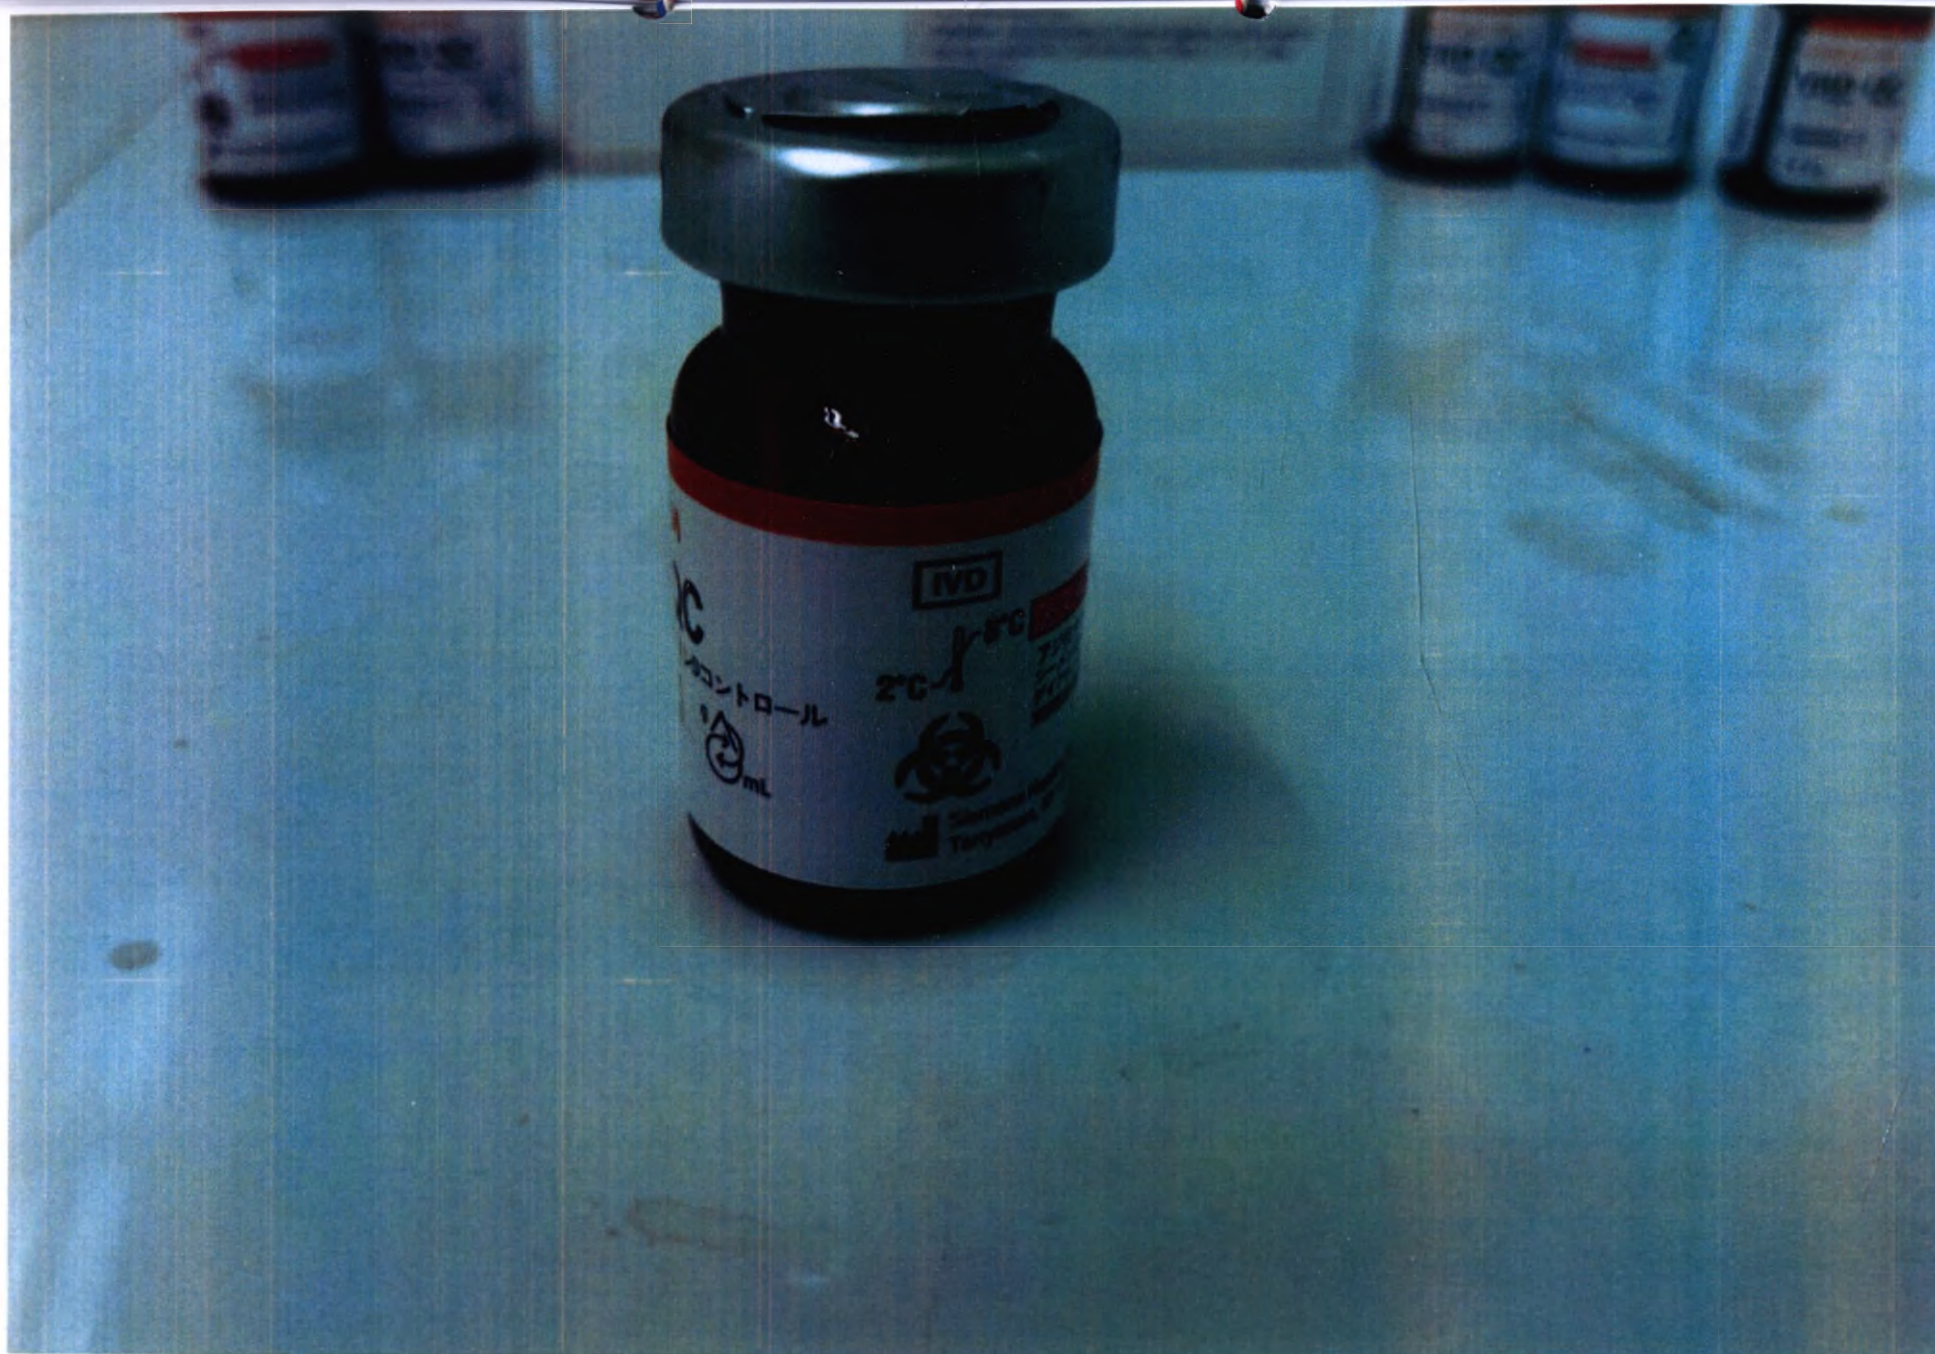


Рисунок 3. Набор контрольных материалов для определения витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total Quality Control

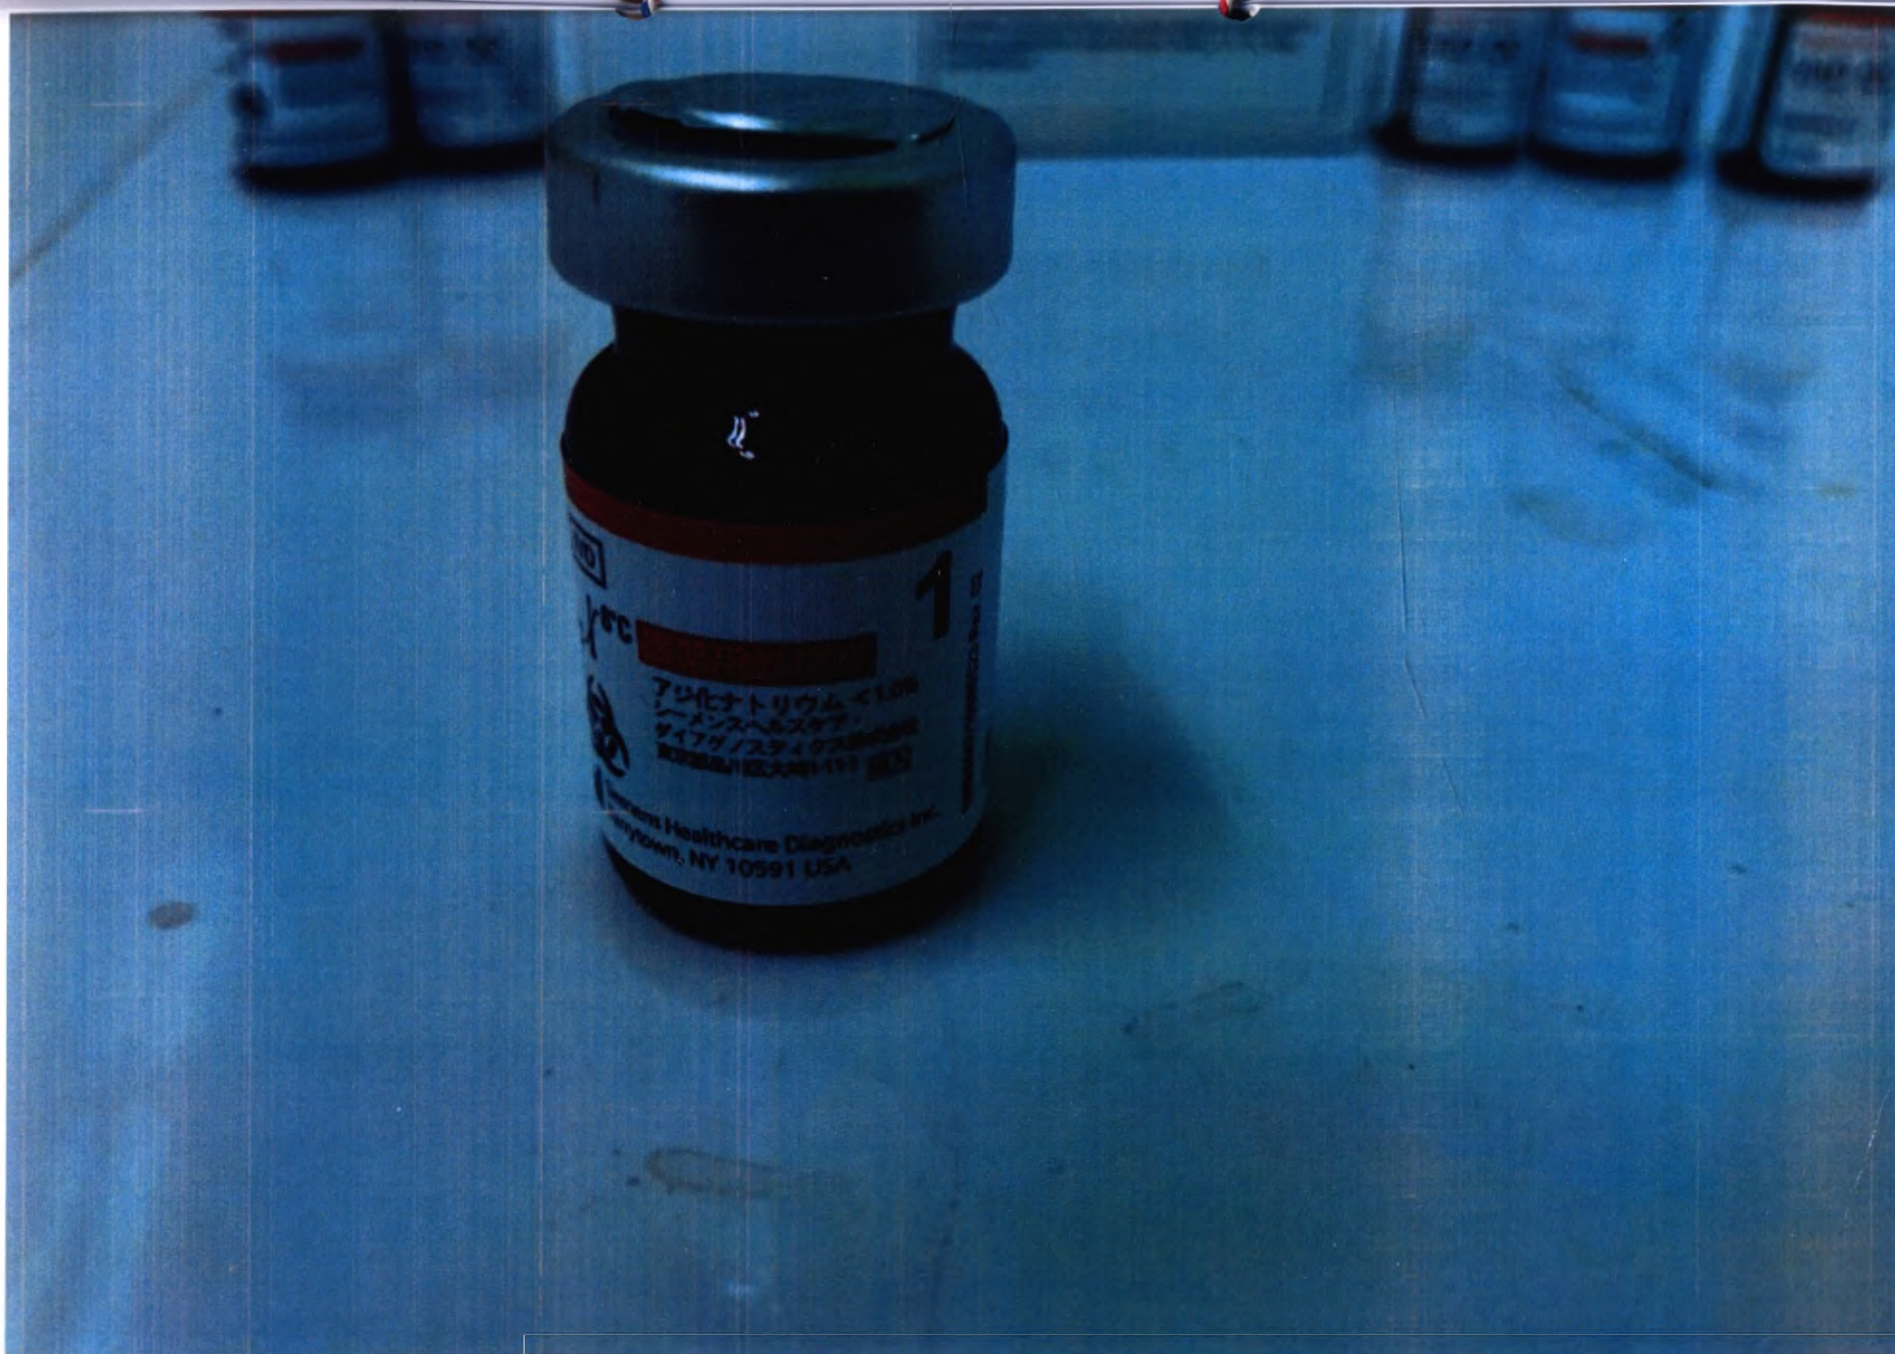


Рисунок 4. Набор контрольных материалов для определения витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total Quality Control (Atellica IM VitD QC)): Контрольный материал 1-го уровня Atellica IM VitD QC CONTROL 1, 2,0 мл

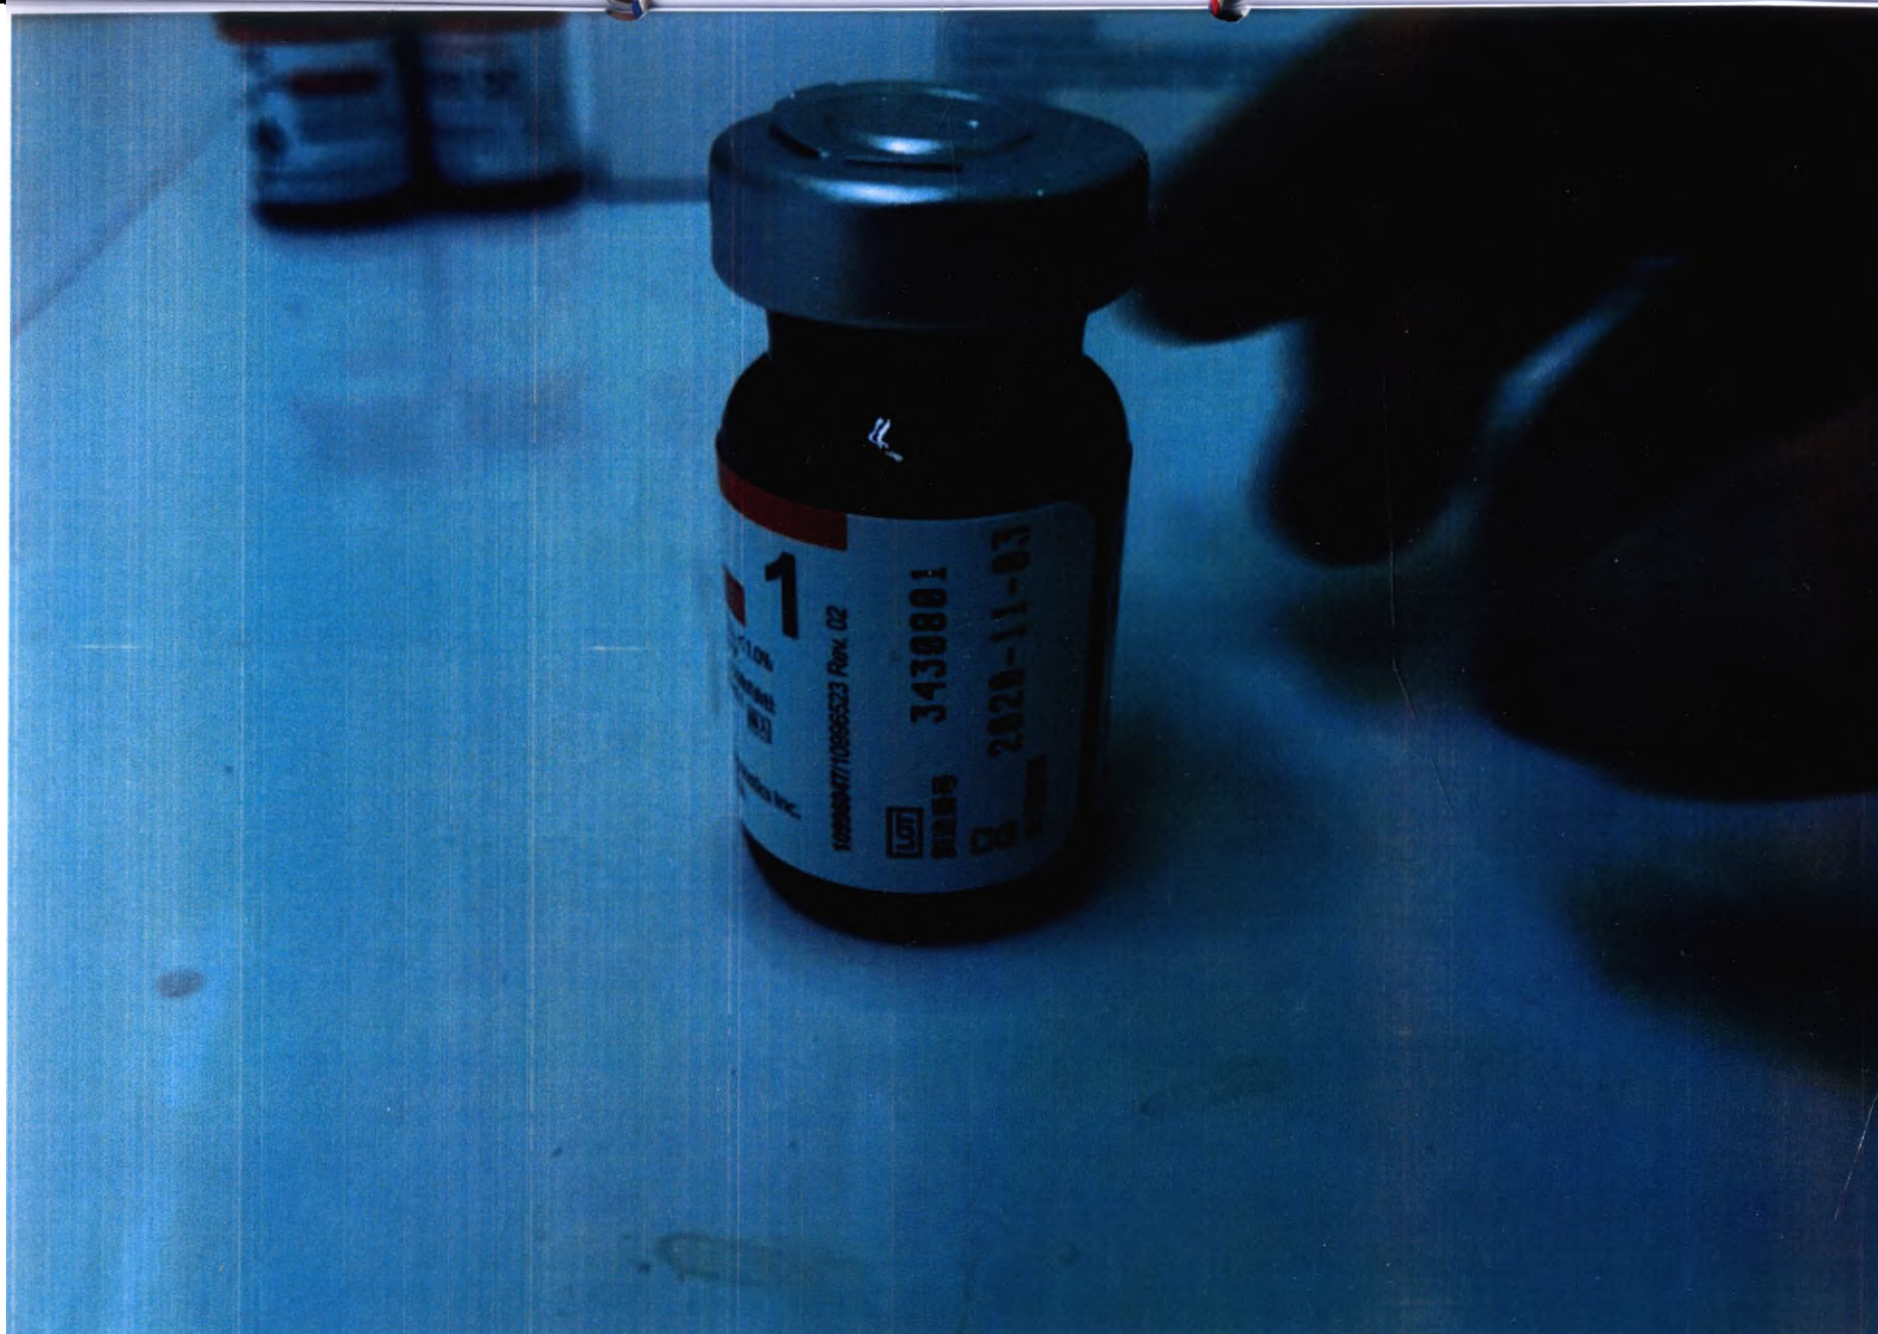



Рисунок 5. Набор контрольных материалов для определения витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total Quality Control (Atellica IM VitD QC)): Контрольный материал 1-го уровня Atellica IM VitD QC CONTROL 1, 2,0 мл



Рисунок 6. Набор контрольных материалов для определения витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total Quality Control (Atellica IM VitD QC)). Контрольный материал 2-го уровня Atellica IM VitD QC CONTROL 2, 2,0 мл



Рисунок 7. Набор контрольных материалов для определения витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total Quality Control (Atellica IM VitD QC)). Иммунохимический материал 2-го уровня Atellica IM VitD QC CONTROL 2, 2,0 мл

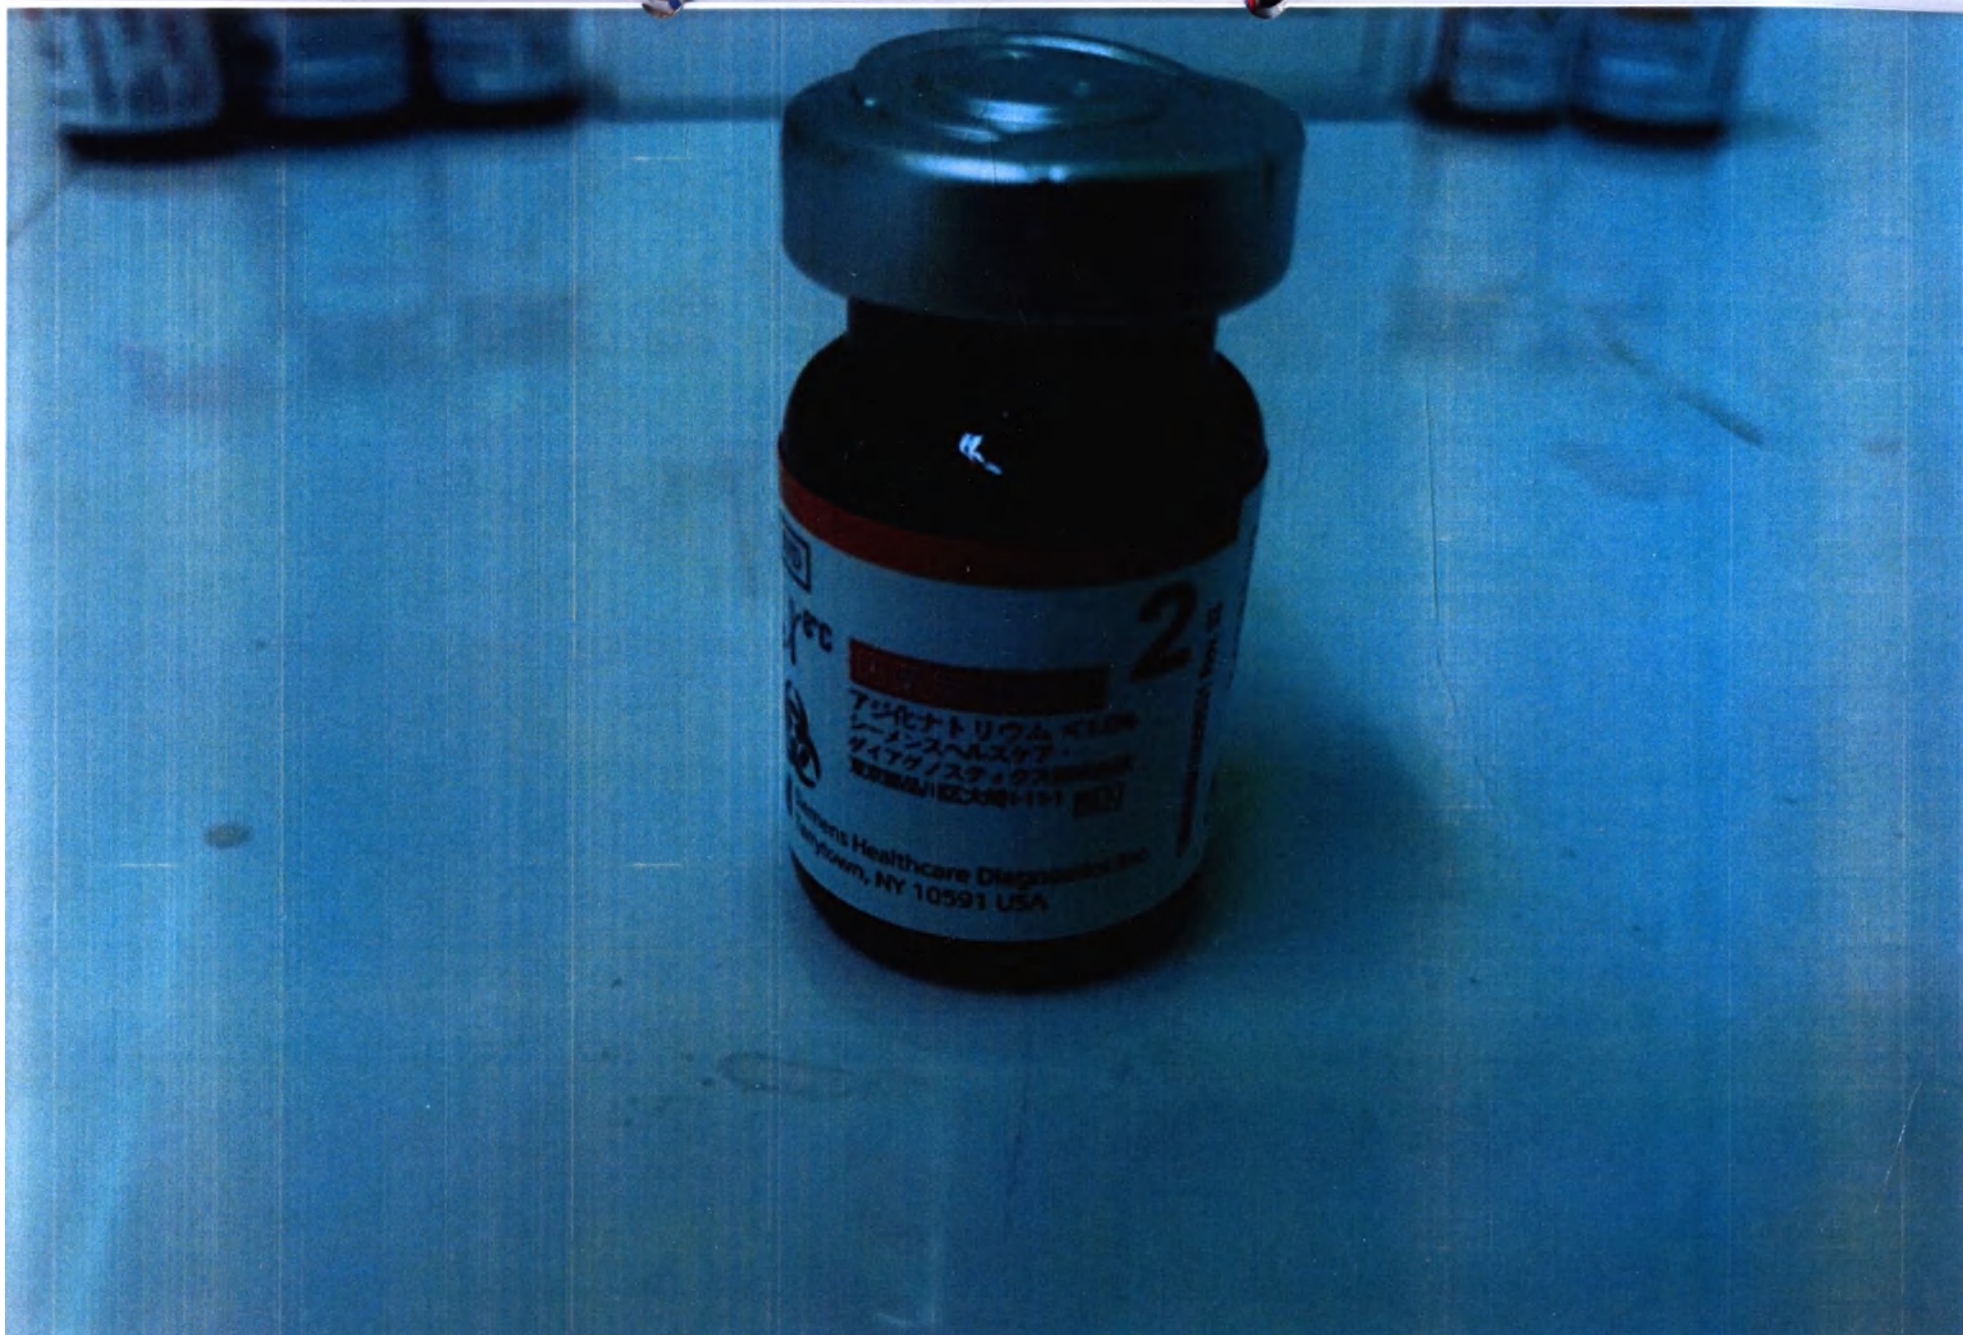

**Рисунок 8. Набор контрольных материалов для определения витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total Quality Control (Atellica IM VitD QC)): Контрольный материал 2-го уровня Atellica IM VitD QC CONTROL 2, 2,0 мл**

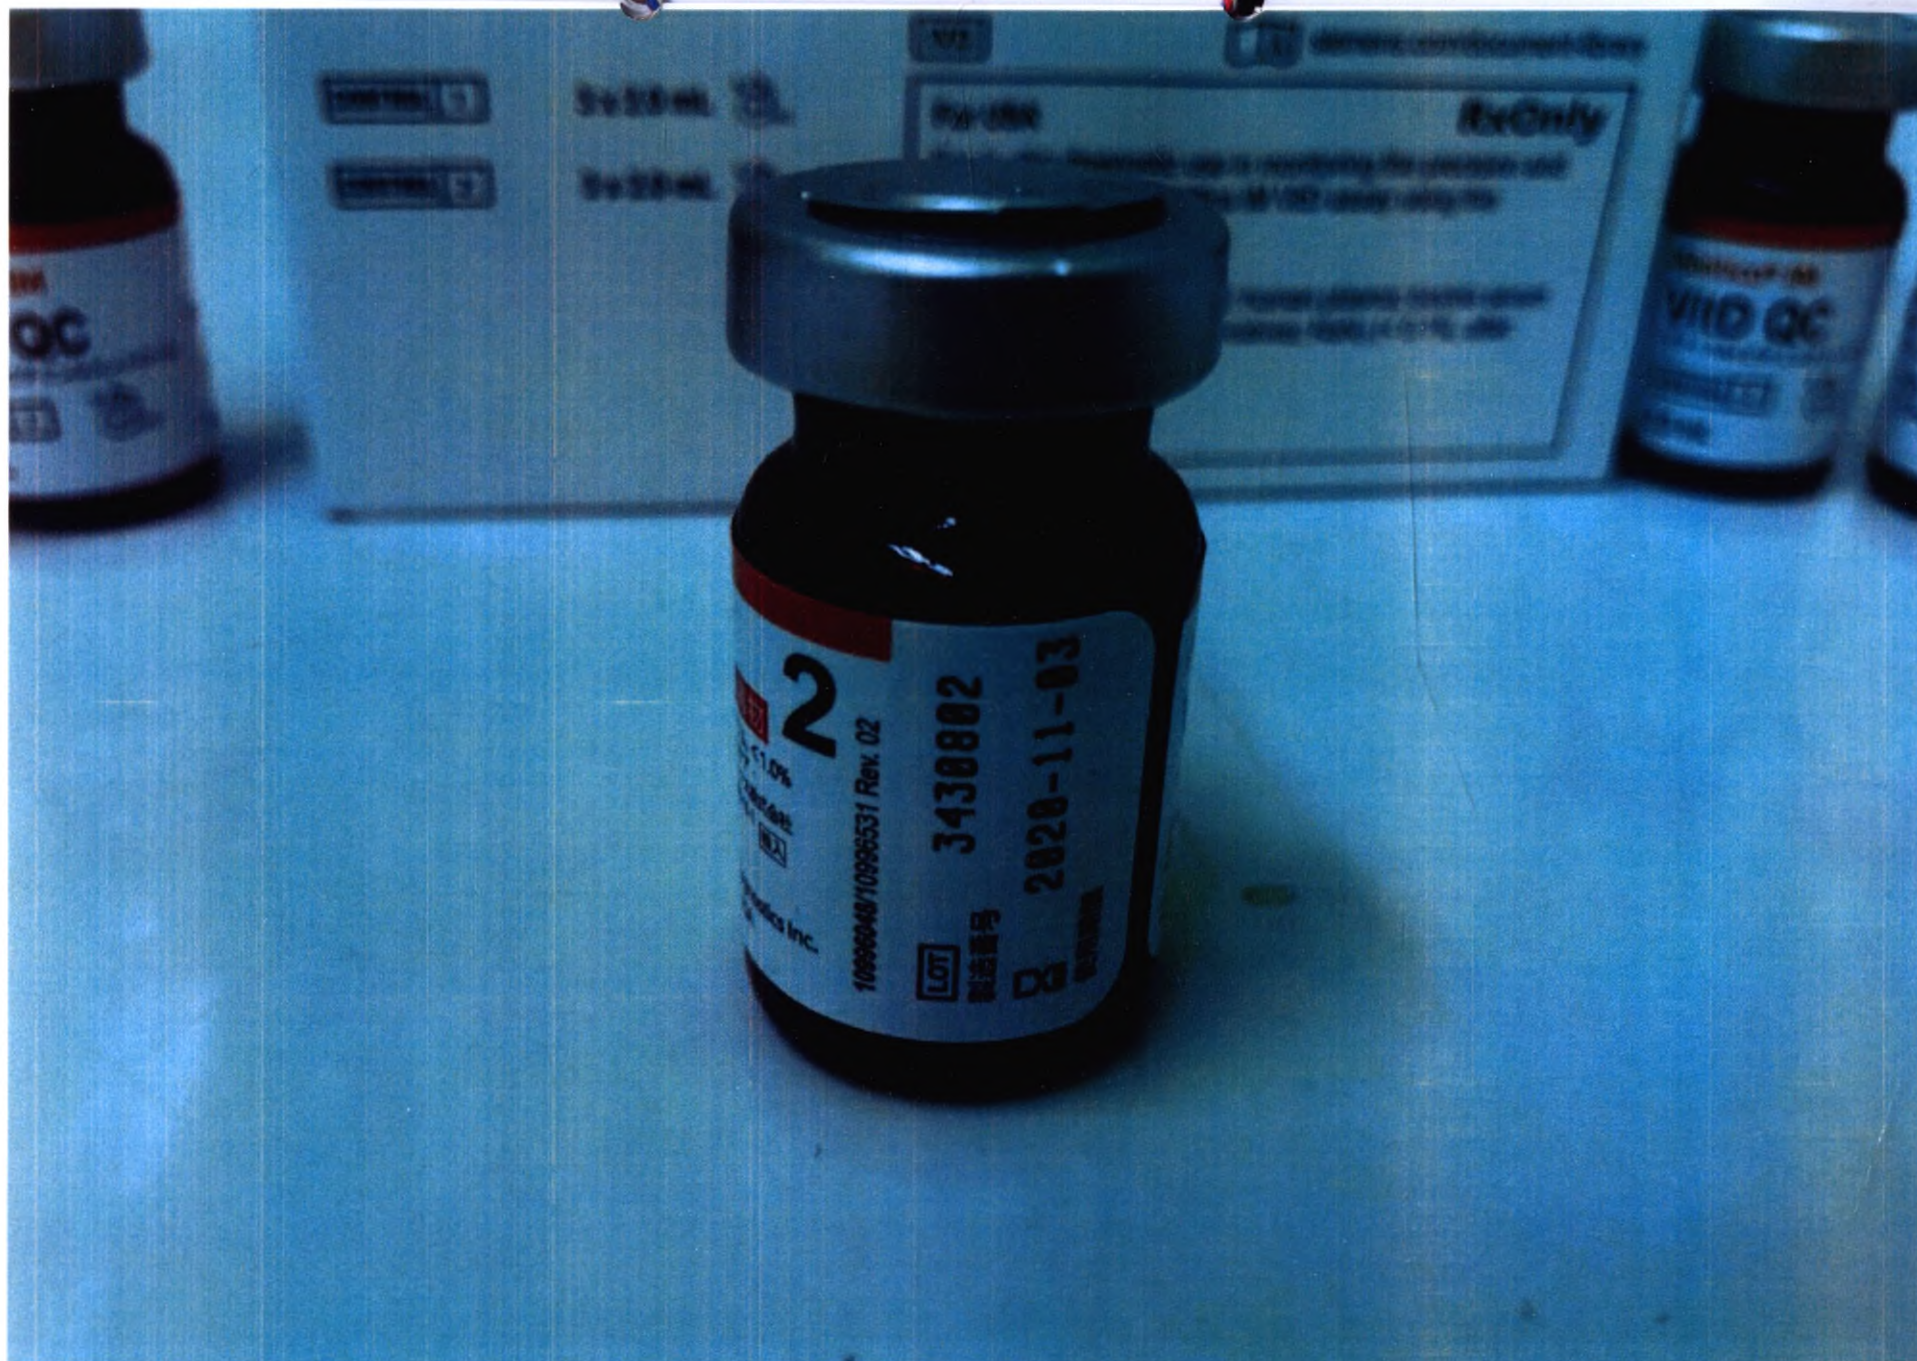


Рисунок 9. Набор контрольных материалов для определения витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total Quality Control

SIEMENS  
Healthcare  
Atellica® IM  
QC

VitD

CONTROL LOT VAL

REF

10995724

EXP

2020-11-03

LOT

10995724

10995724

UNITS C

|           | LOT     | ng/mL | ng/mL |
|-----------|---------|-------|-------|
| CONTROL 1 | 3430801 | 24.9  | 9.90  |
| CONTROL 2 | 3430802 | 102   | 22.0  |

UNITS D

|           | LOT     | nmol/L | nmol/L |
|-----------|---------|--------|--------|
| CONTROL 1 | 3430801 | 62.3   | 24.8   |
| CONTROL 2 | 3430802 | 255    | 55.0   |

10995724 Rev. 04

Рисунок 10. Набор контрольных материалов для определения витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total Quality Control (Atellica IM VitD QC)): Лист значений параметров серии контрольных материалов.

Всего прошито и пронумеровано  
11 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

