

Руководитель группы регистрации  
ООО «Сименс Здравоохранение»



Н.А. Горшкова  
«30/07/2021» 2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Дилуэнт для витамина D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total Diluent (Atellica IM VitD DIL))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикас Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США



Рисунок 1. Дилуэнт для витамина D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total Diluent (Atellica IM VitD DIL.)). Общий вид

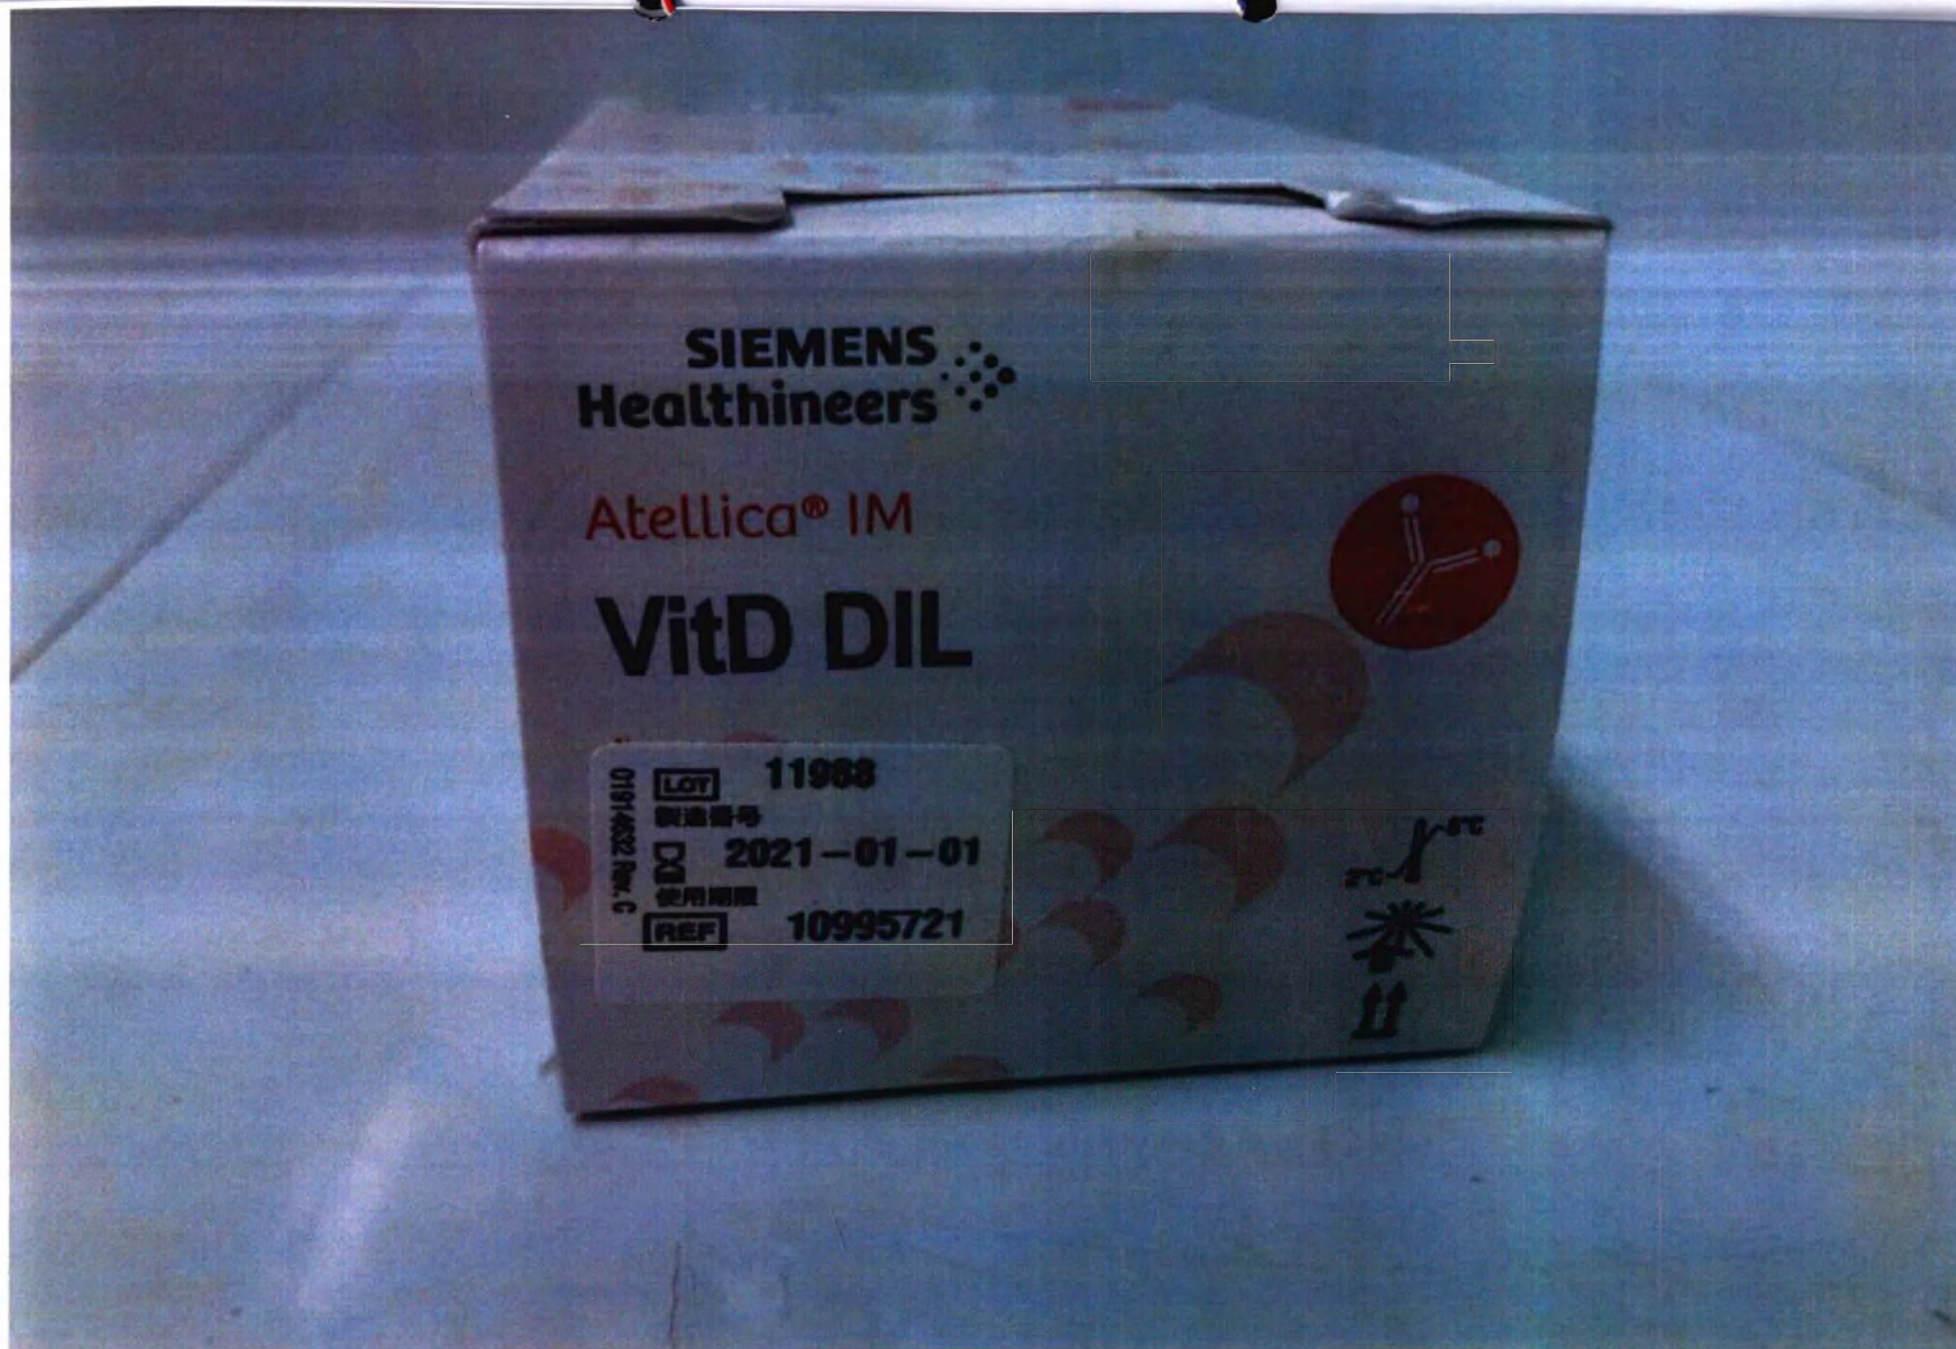


Рисунок 2. Дилуэнт для витамина D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total Diluent (Atellica IM VitD DIL)). Общий вид

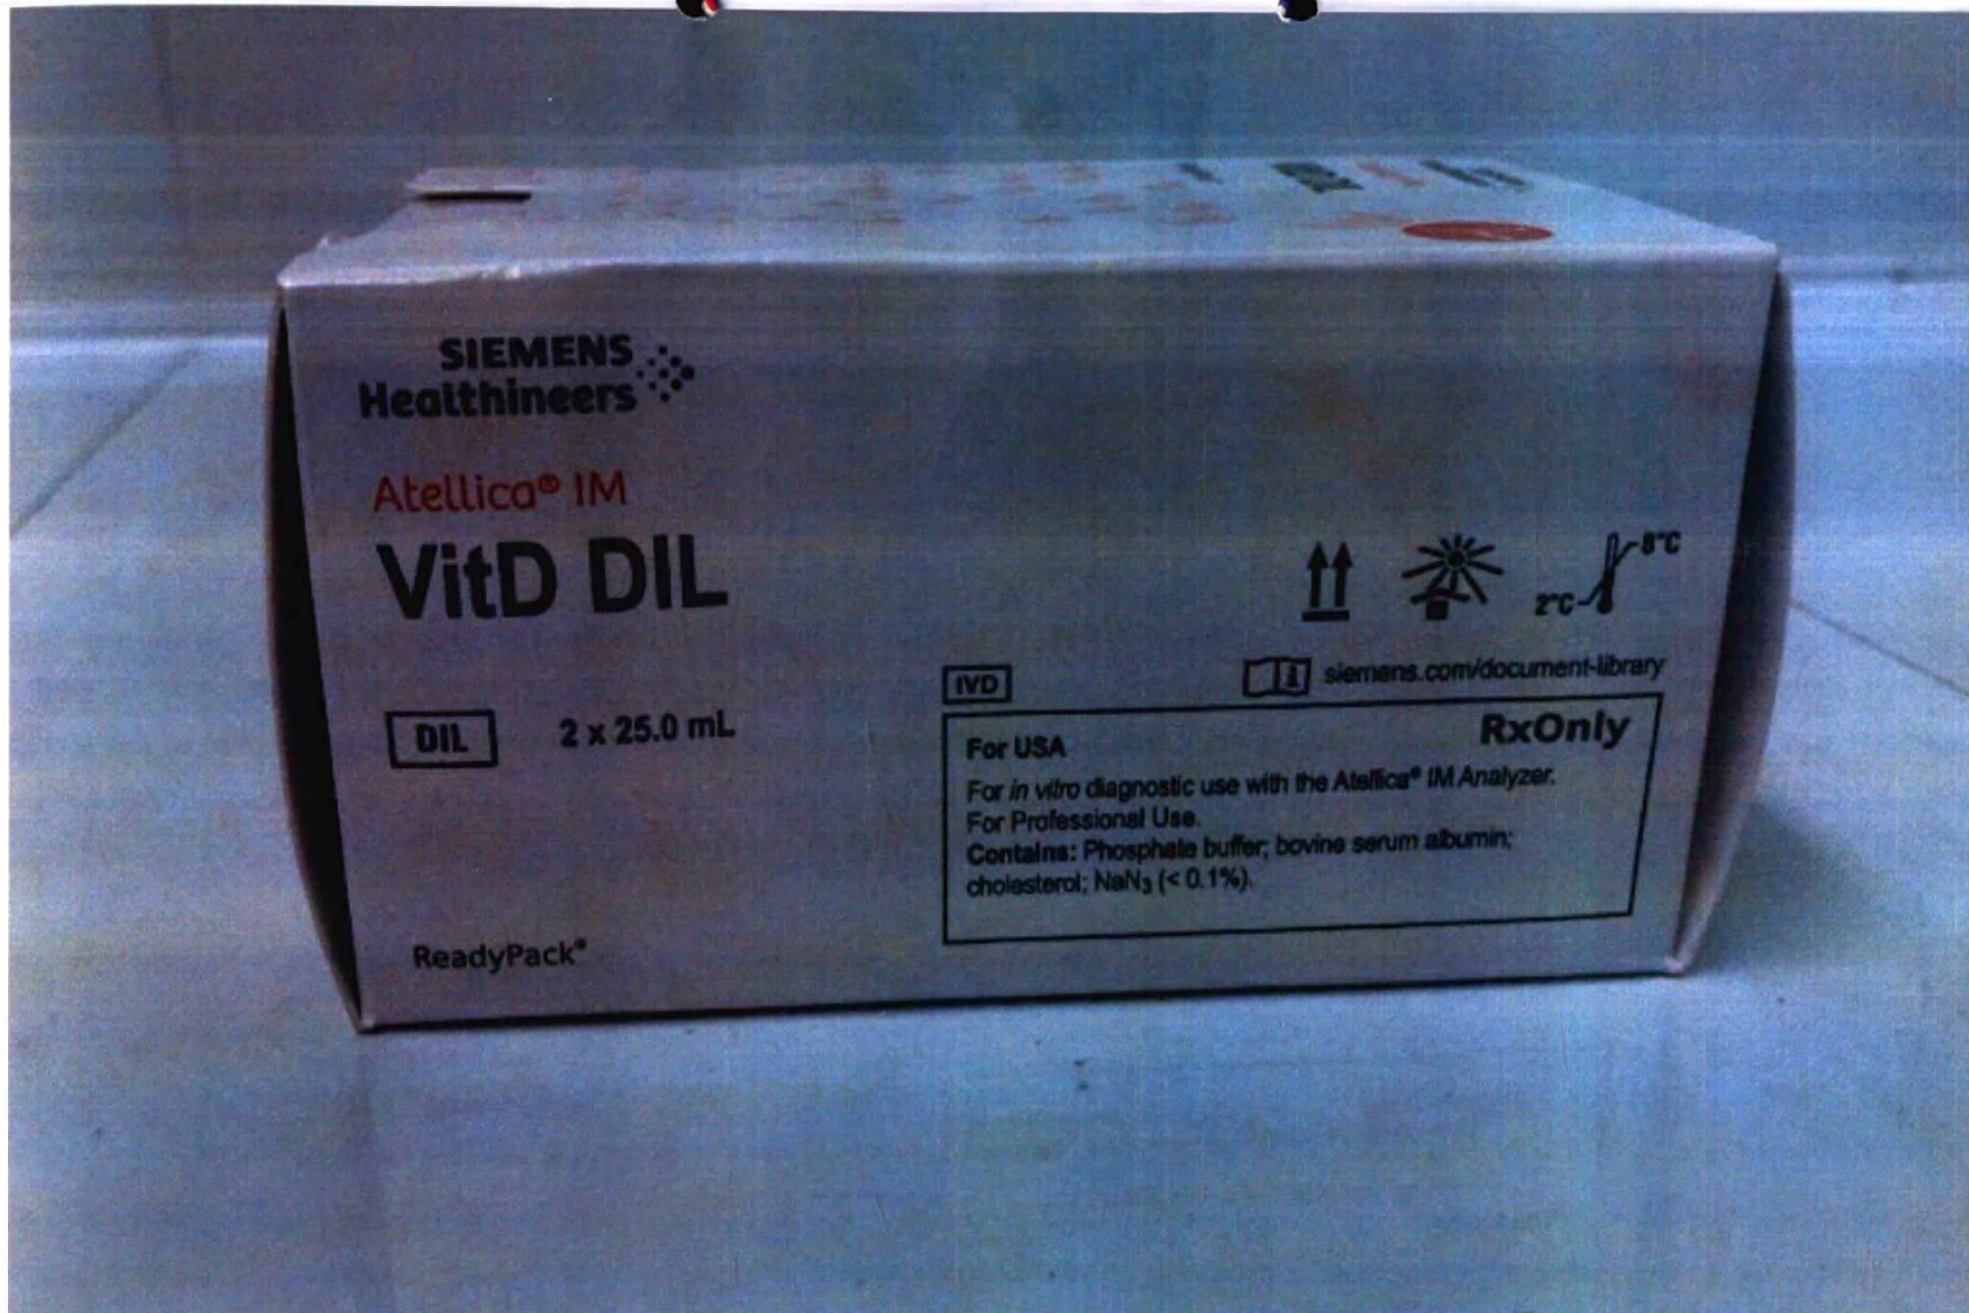


Рисунок 3. Дилуэнт для витамина D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total Diluent (Atellica IM VitD DIL)). Общий вид



Всего прошито и пронумеровано  
4 листа (ов).

ООО «Сиенс Здравоохранение»

