

Руководитель группы регистрации  
ООО «Сименс Здравоохранение»



Н.А. Горшкова  
31 мая 2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор контрольных материалов для определения интактного паратиреоидного гормона на  
анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Intact Parathyroid Hormone  
Quality Control (Atellica IM PTH QC))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикакс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

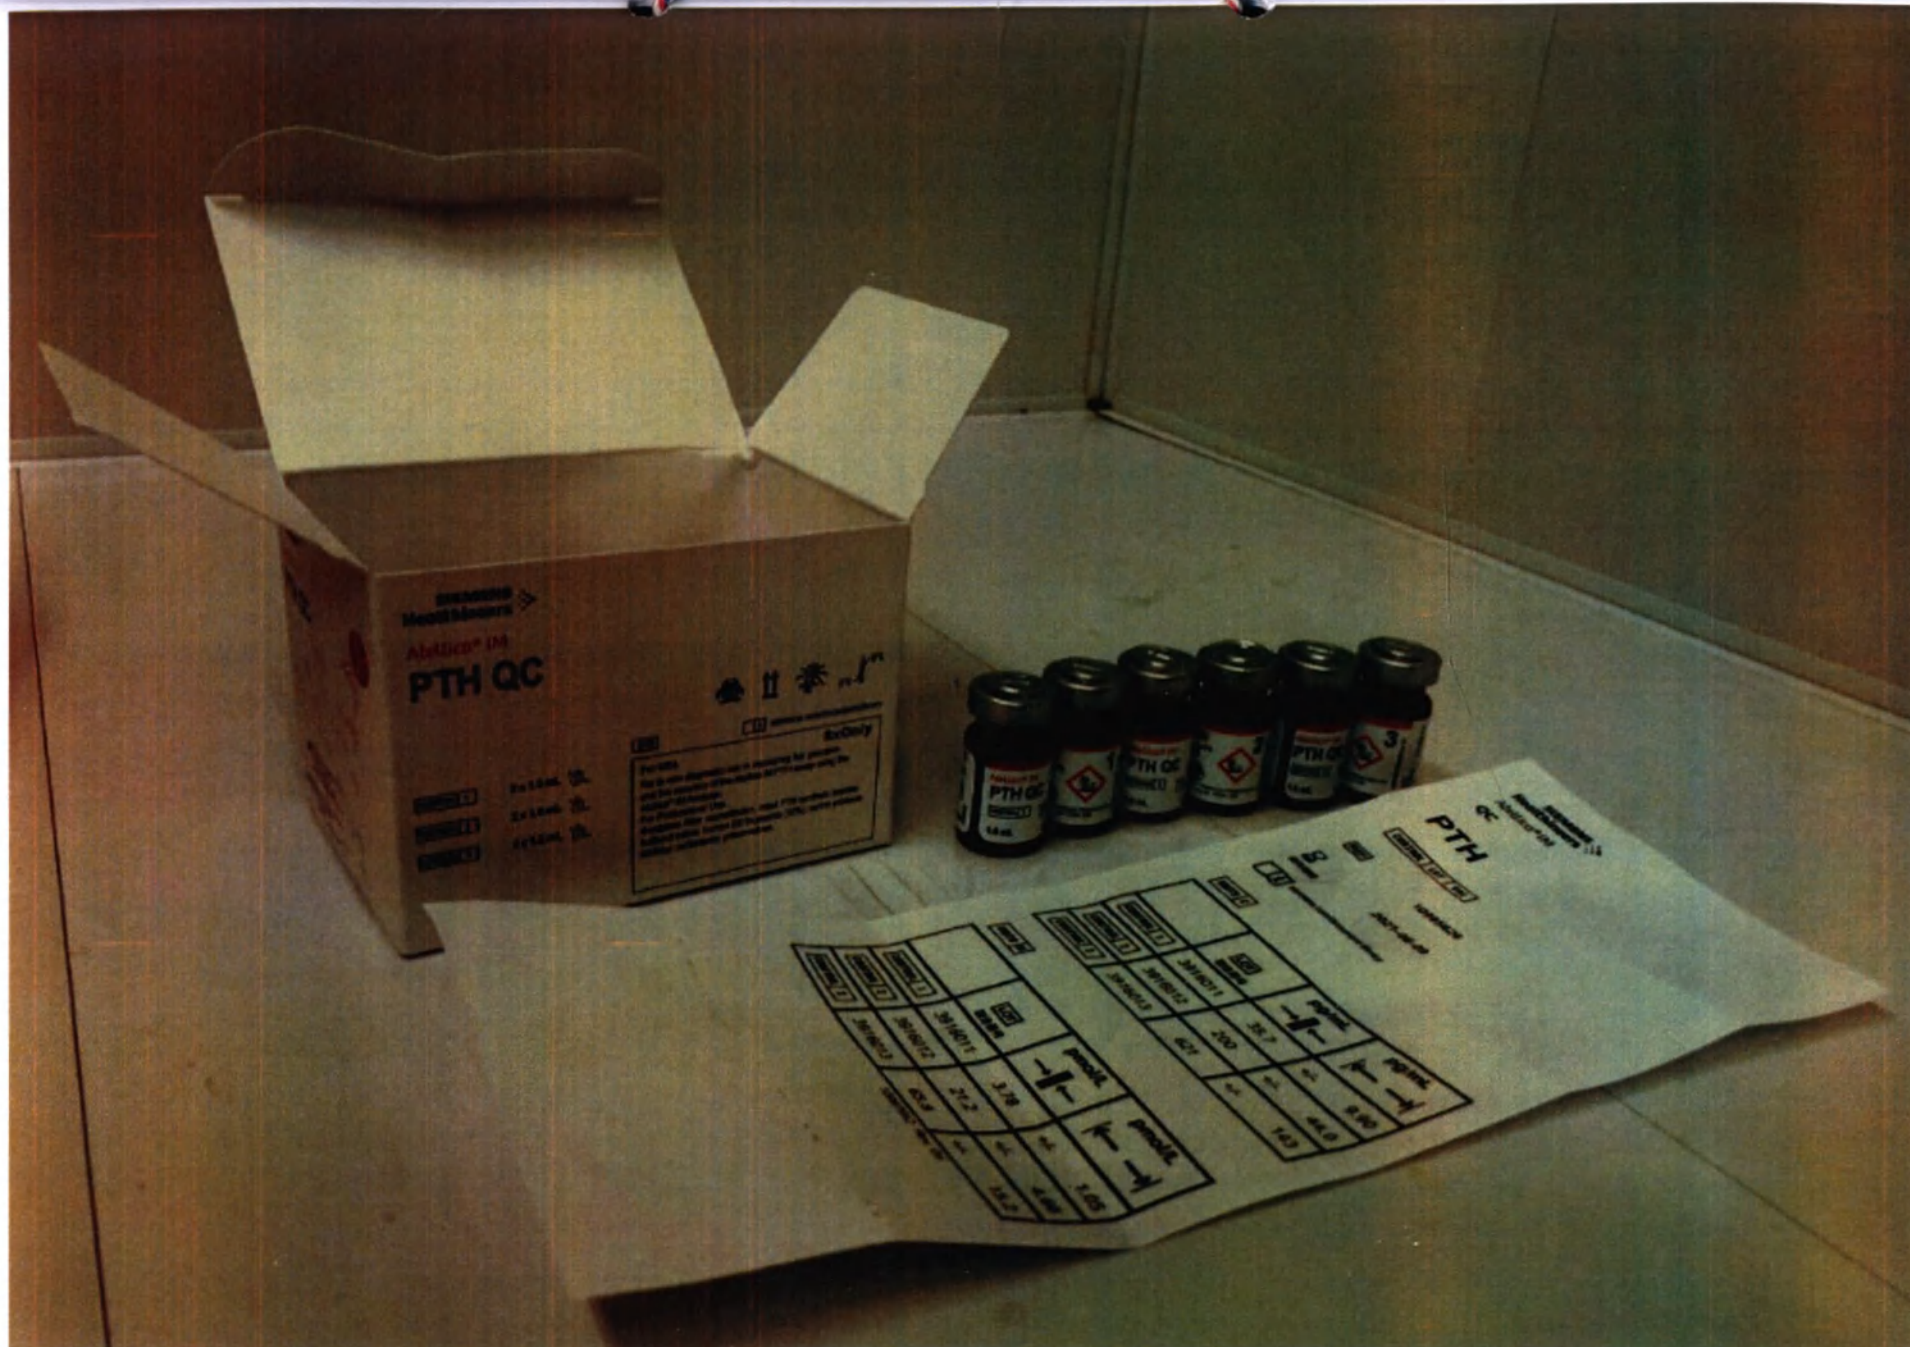


Рисунок 1. Набор контрольных материалов для определения интактного паратиреоидного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Intact Parathyroid Hormone Quality Control (Atellica IM PTH QC)). Общий вид.

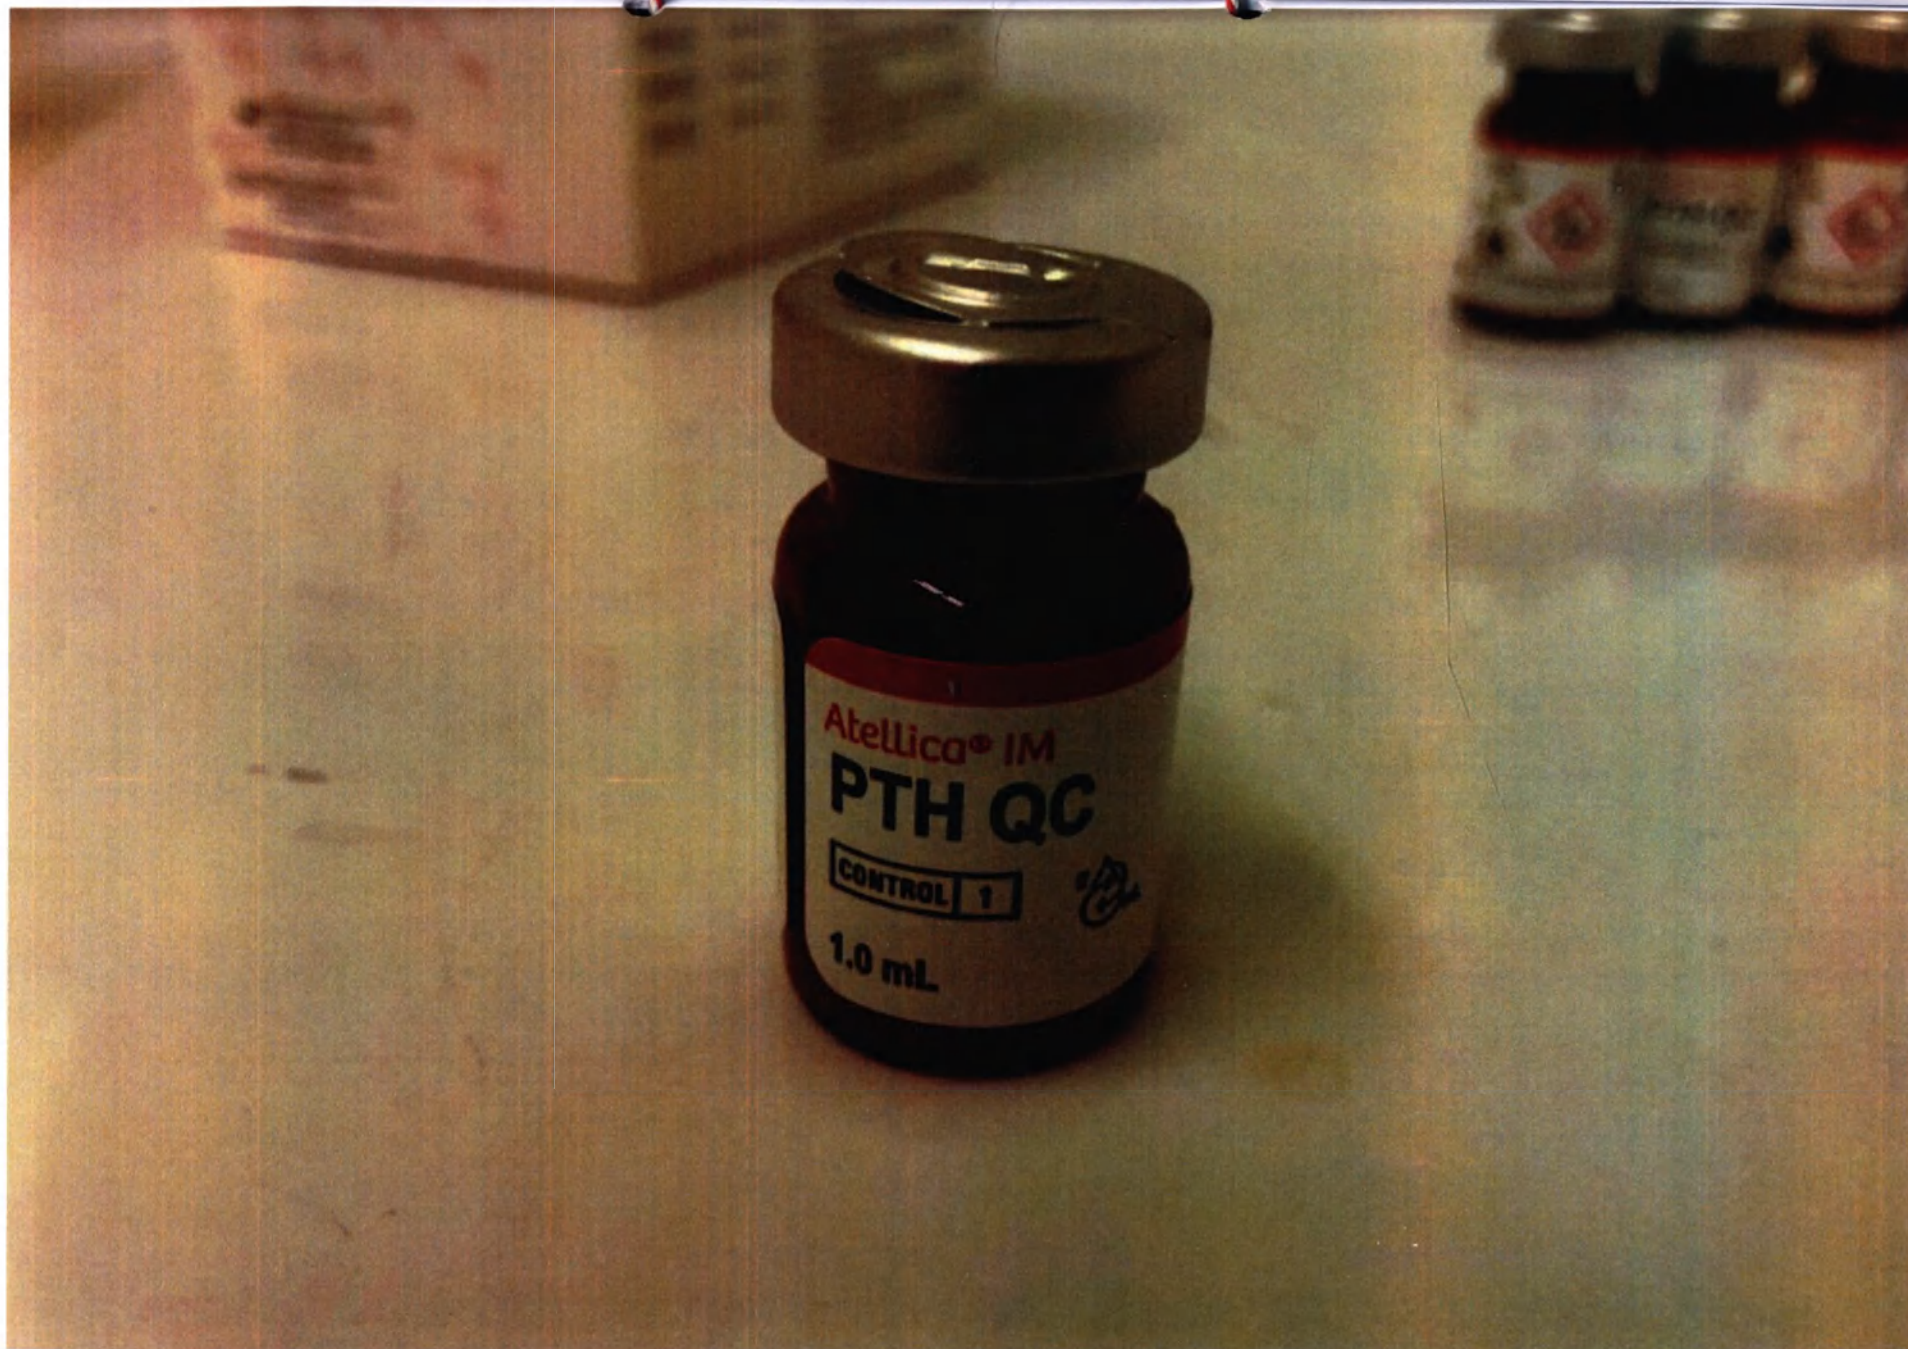


Рисунок 2. Набор контрольных материалов для определения интактного паратиреоидного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Intact Parathyroid Hormone Quality Control (Atellica IM PTH QC)): Контрольный материал 1-го уровня Atellica IM PTH QC CONTROL 1, 1,0 мл.

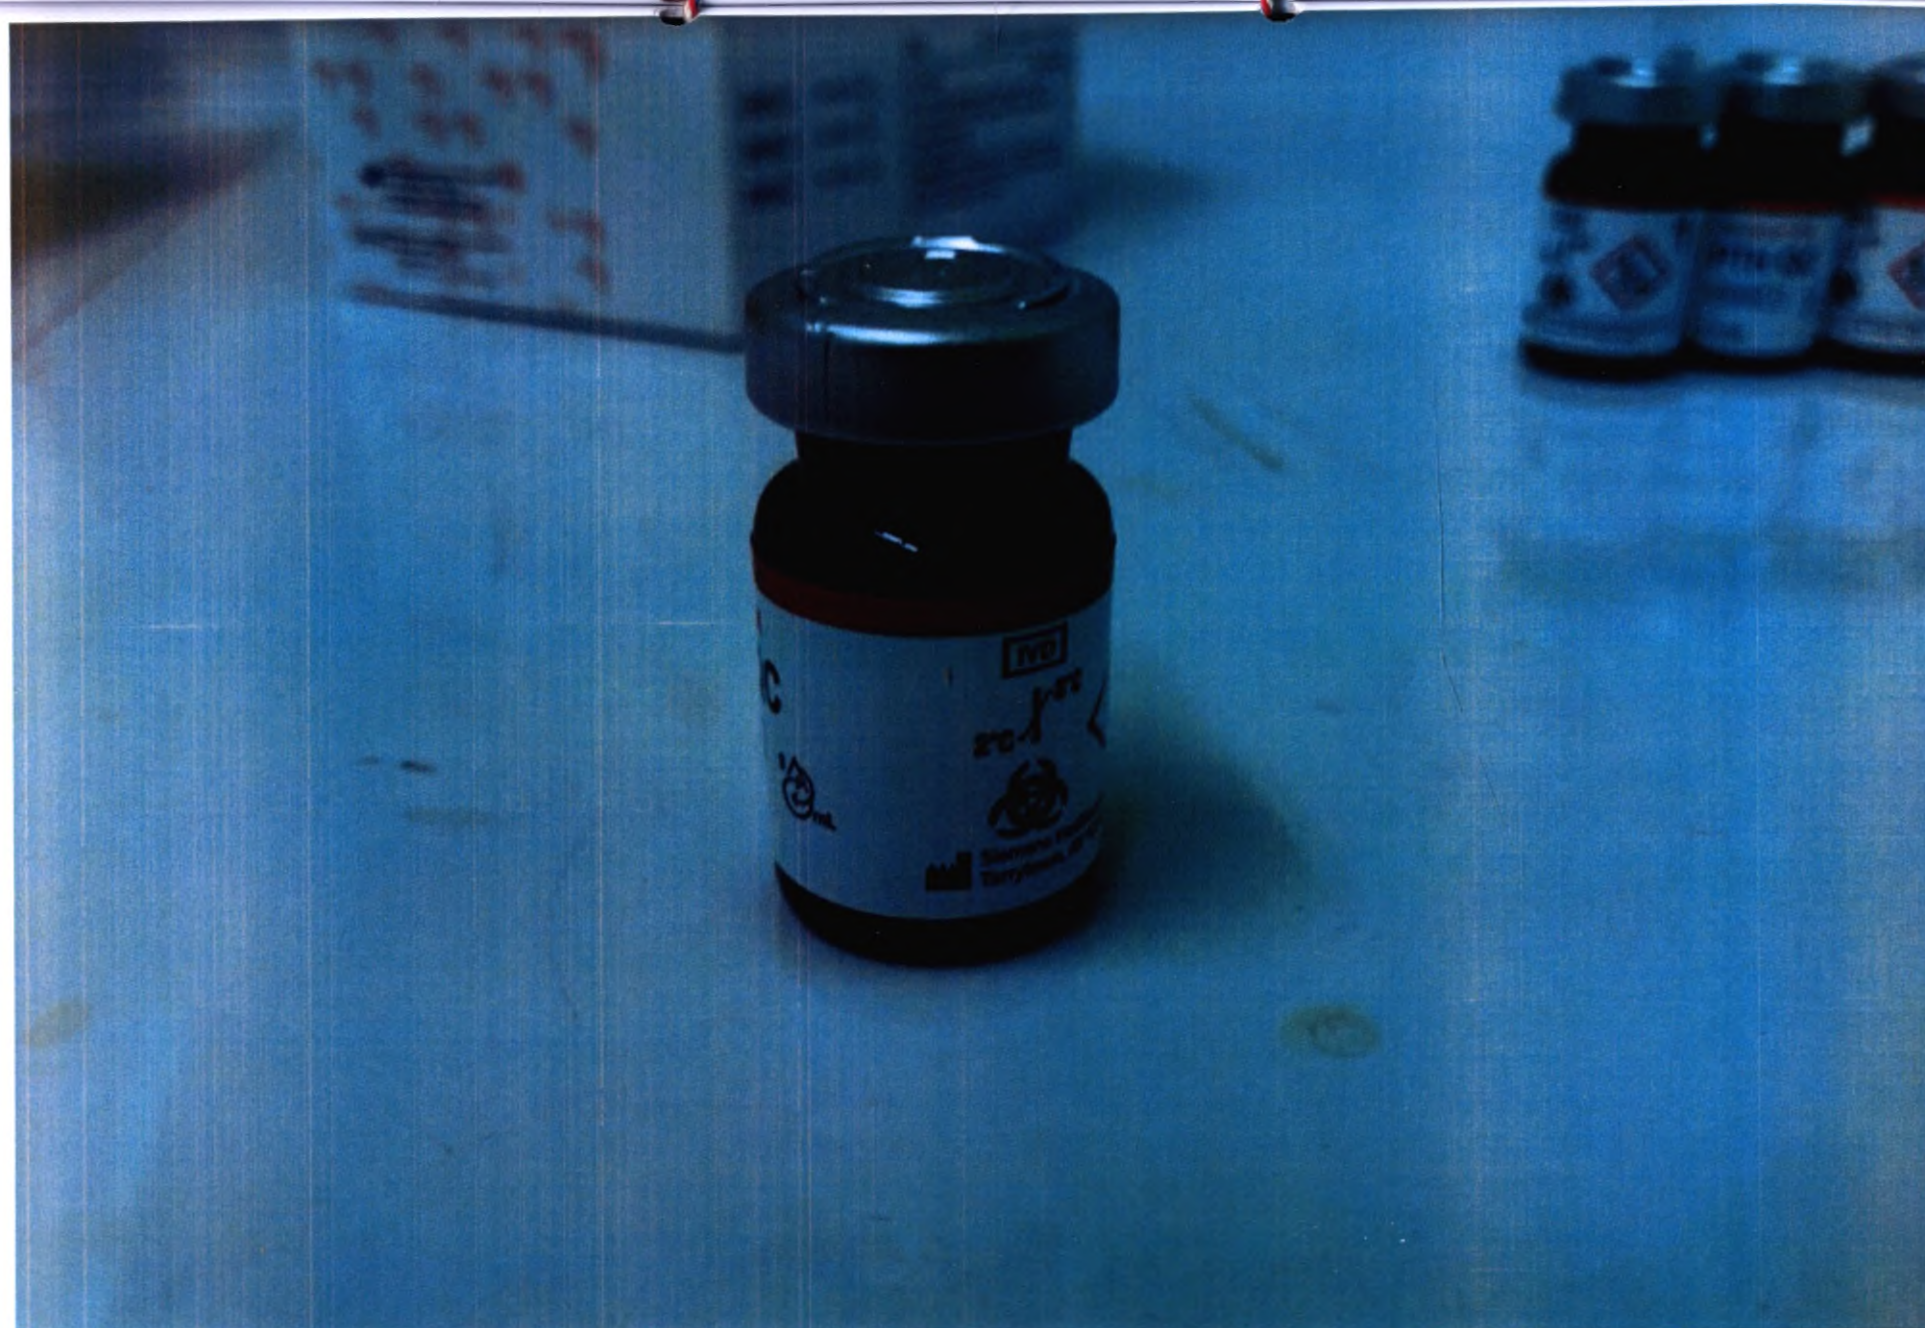


Рисунок 3. Набор контрольных материалов для определения интактного паратиреоидного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Intact Parathyroid Hormone Quality Control (Atellica IM PTH QC)): Контрольный материал 1-го уровня Atellica IM PTH QC CONTROL 1, 1,0 мл.

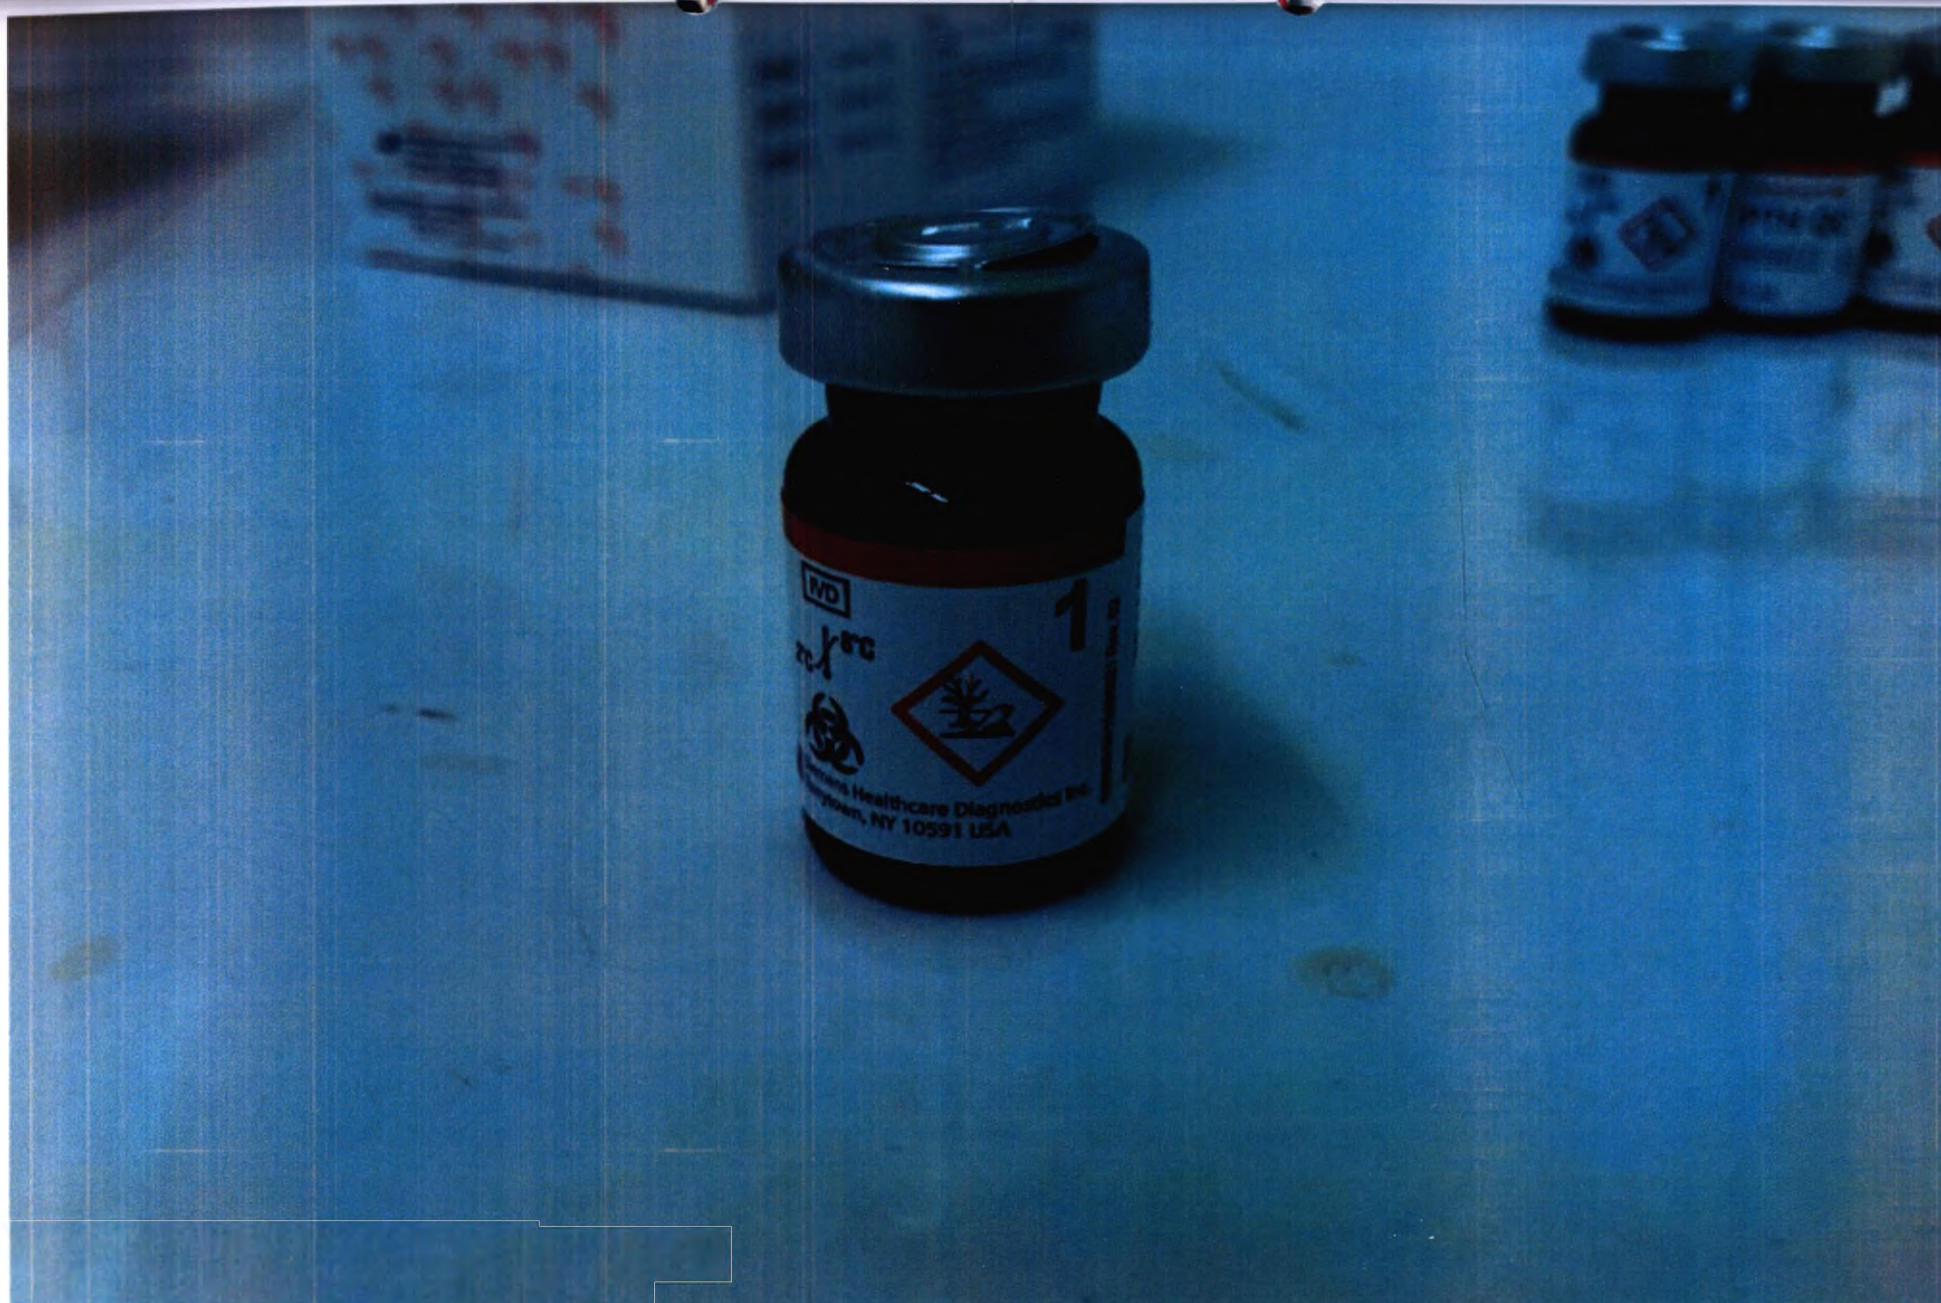


Рисунок 4. Набор контрольных материалов для определения интактного паратиреоидного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Intact Parathyroid Hormone Quality Control (Atellica IM PTH QC)): Контрольный материал 1-го уровня Atellica IM PTH QC CONTROL 1, 1,0 мл.

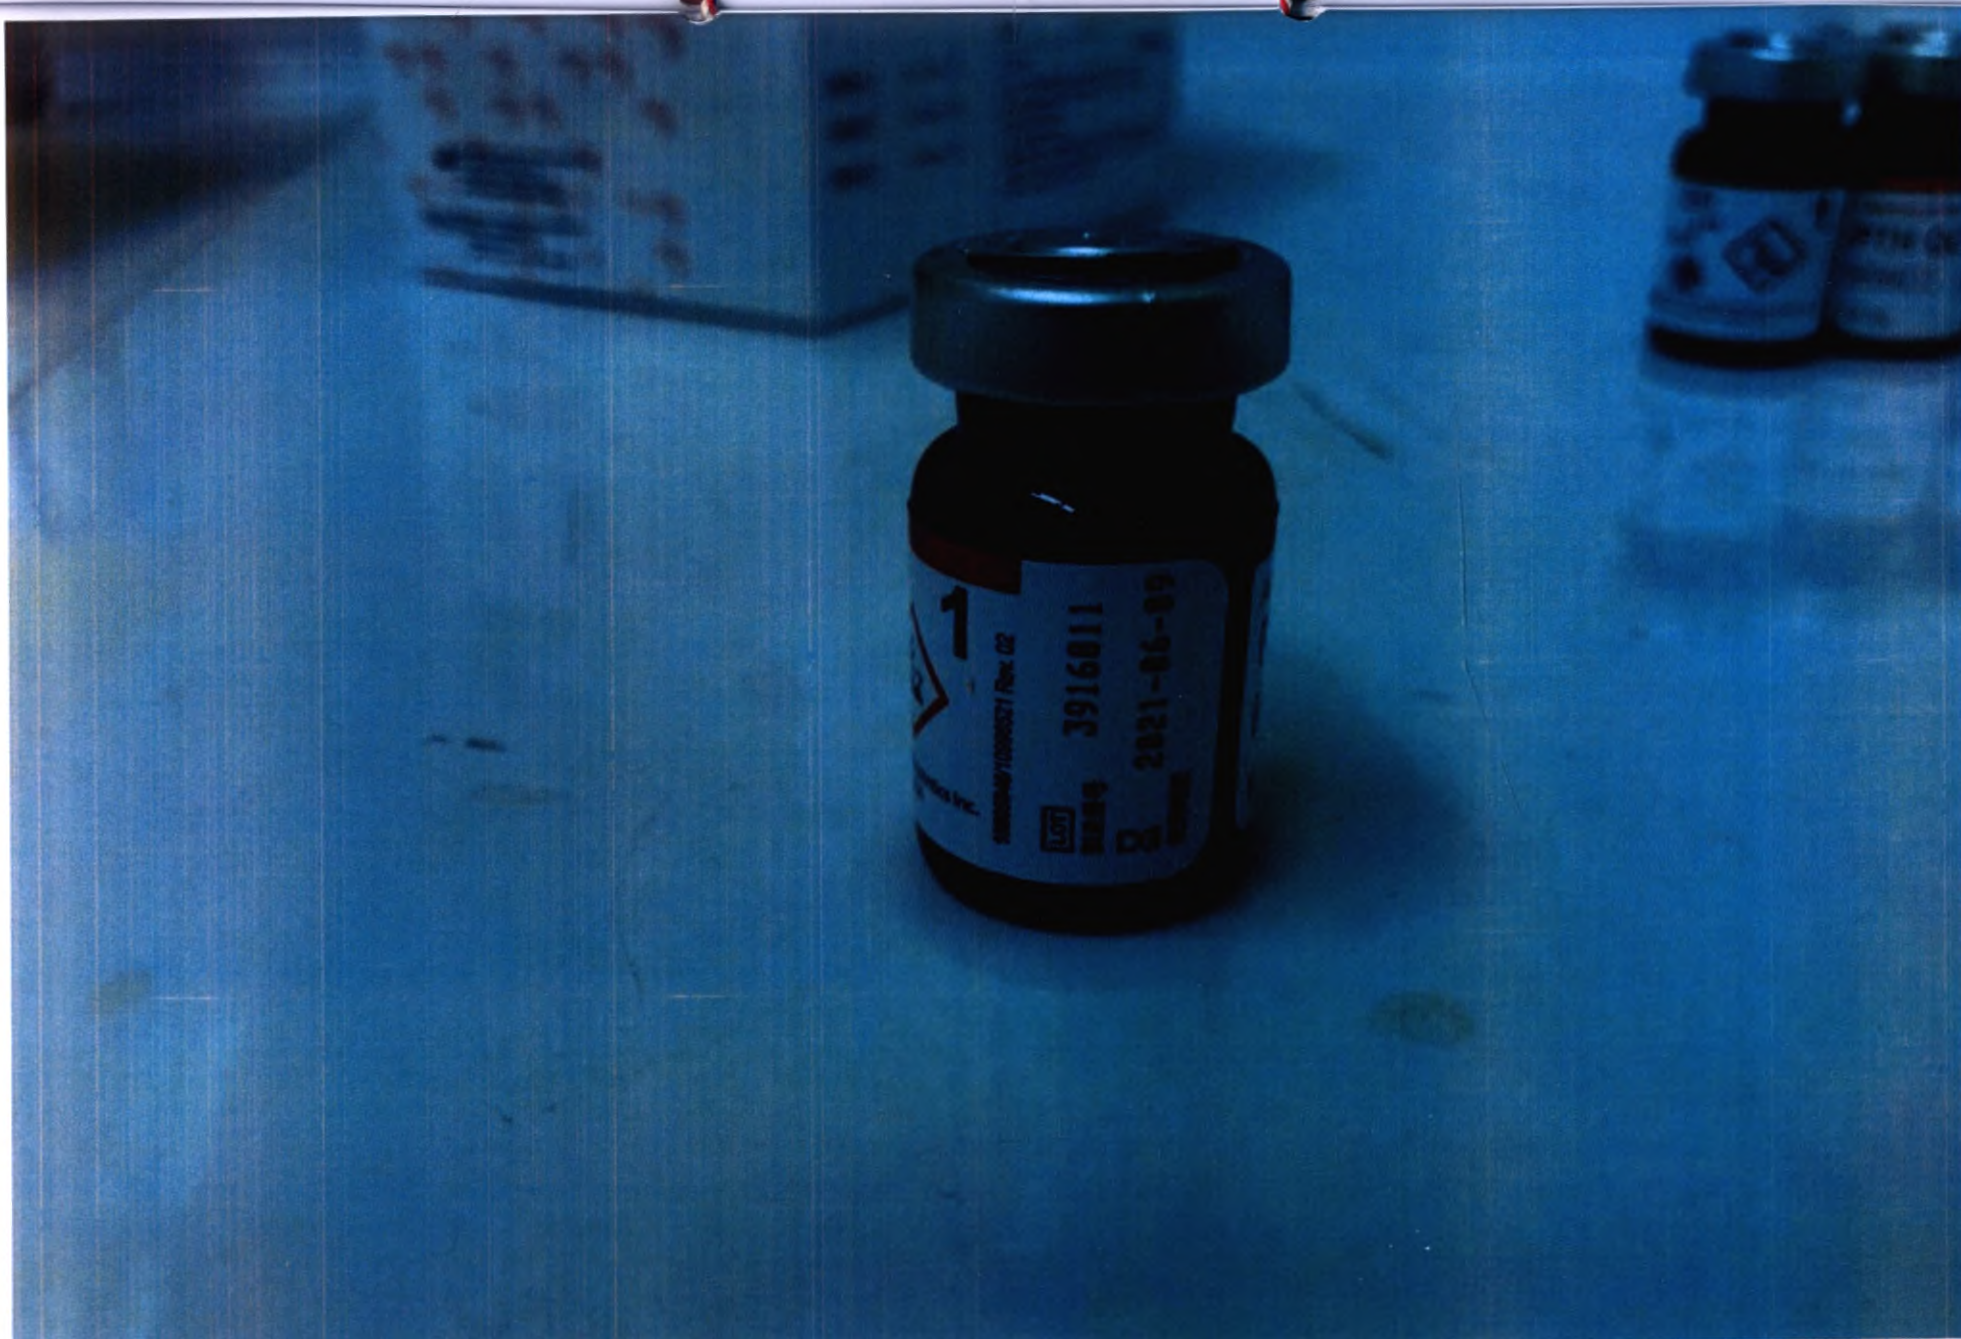


Рисунок 5. Набор контрольных материалов для определения интактного паратиреоидного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Intact Parathyroid Hormone Quality Control (Atellica IM PTH QC)): Контрольный материал 1-го уровня Atellica IM PTH QC CONTROL 1, 1,0 мл.

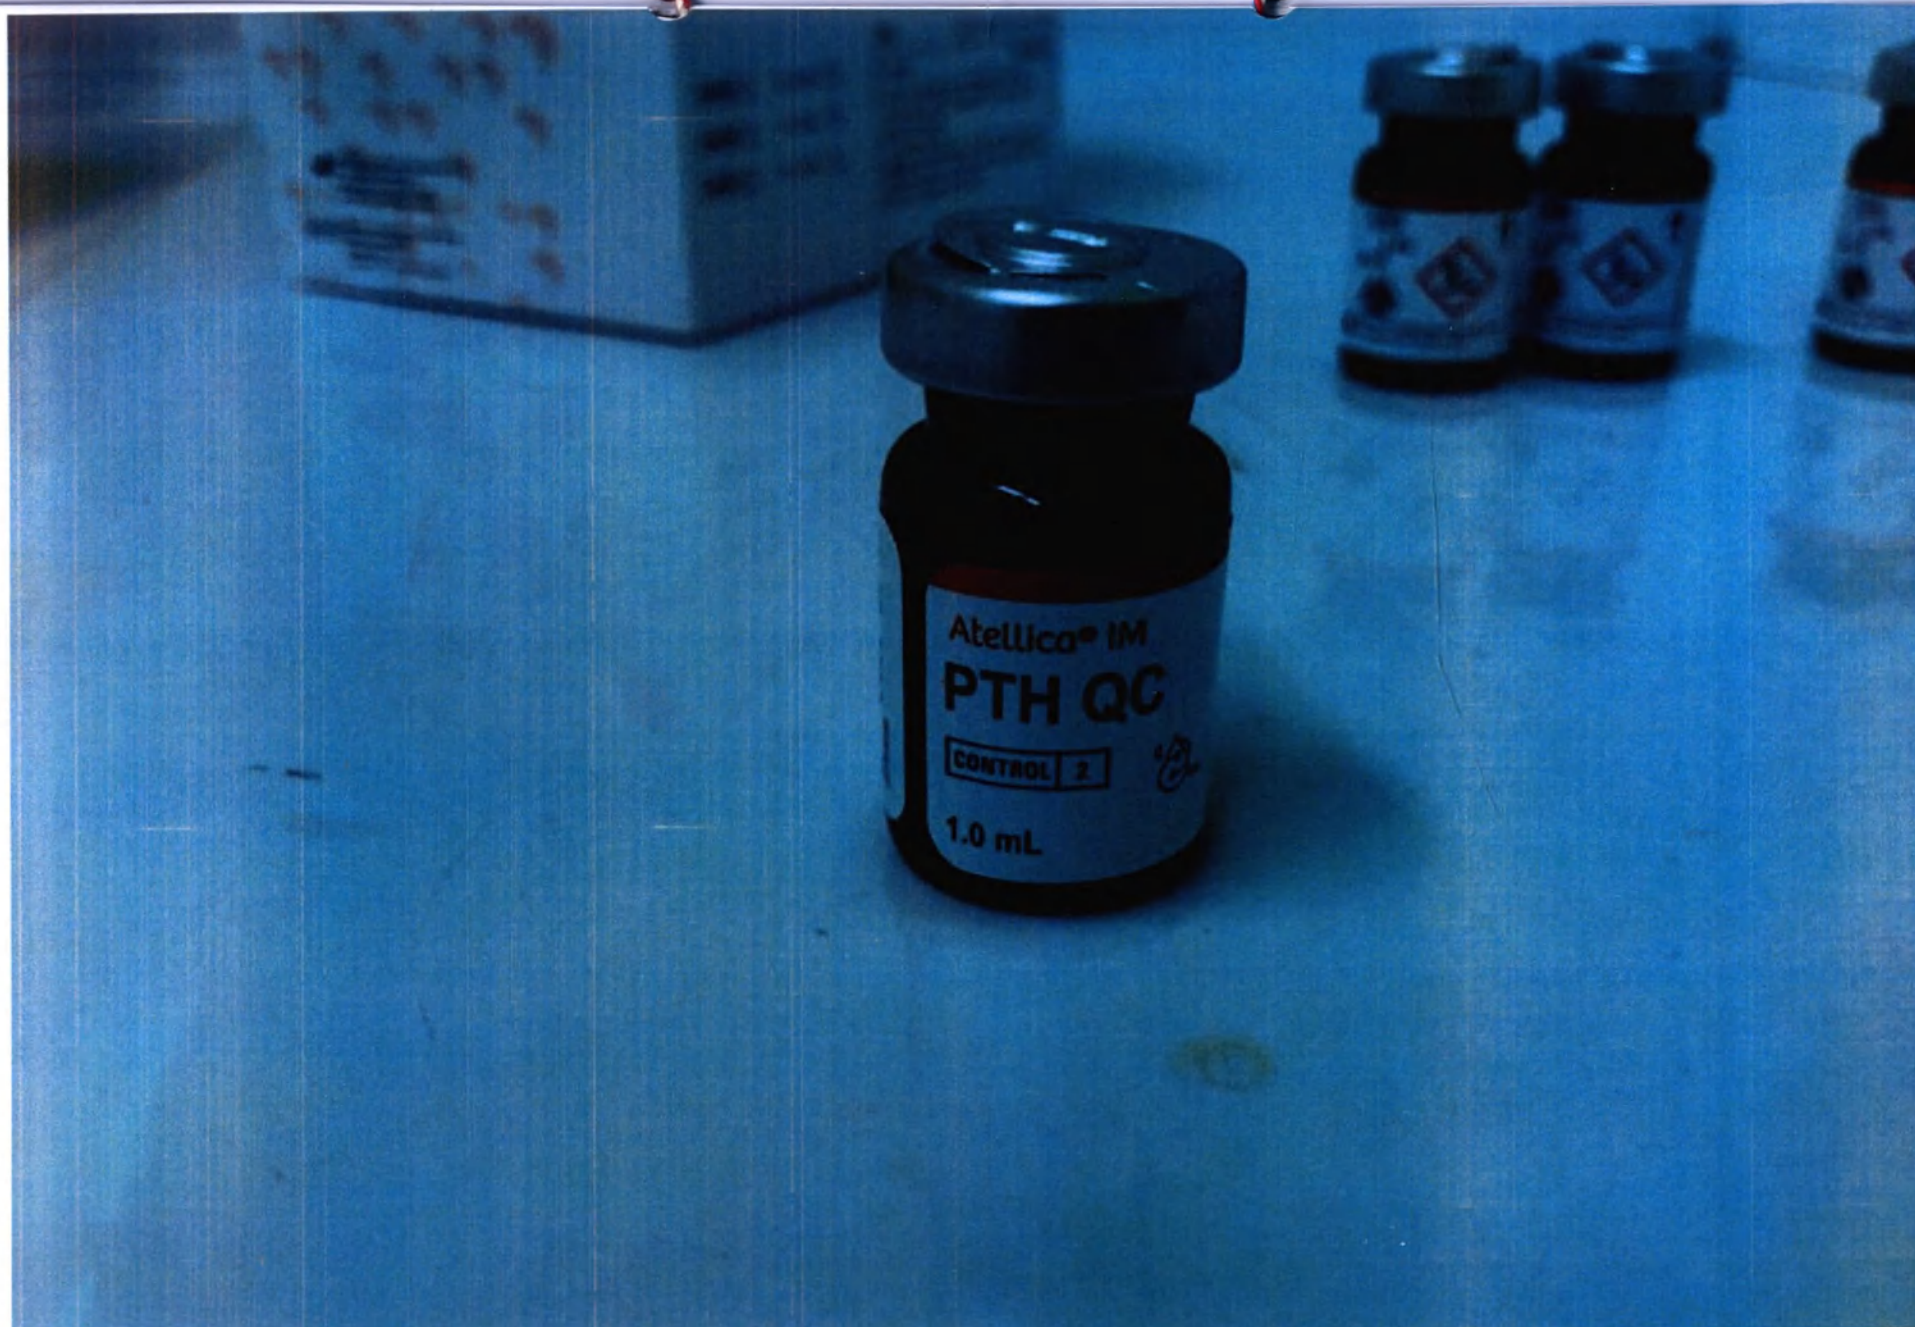


Рисунок 6. Набор контрольных материалов для определения интактного паратиреоидного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Intact Parathyroid Hormone Quality Control (Atellica IM PTH QC)): Контрольный материал 2-го уровня Atellica IM PTH QC CONTROL 2, 1,0 мл.

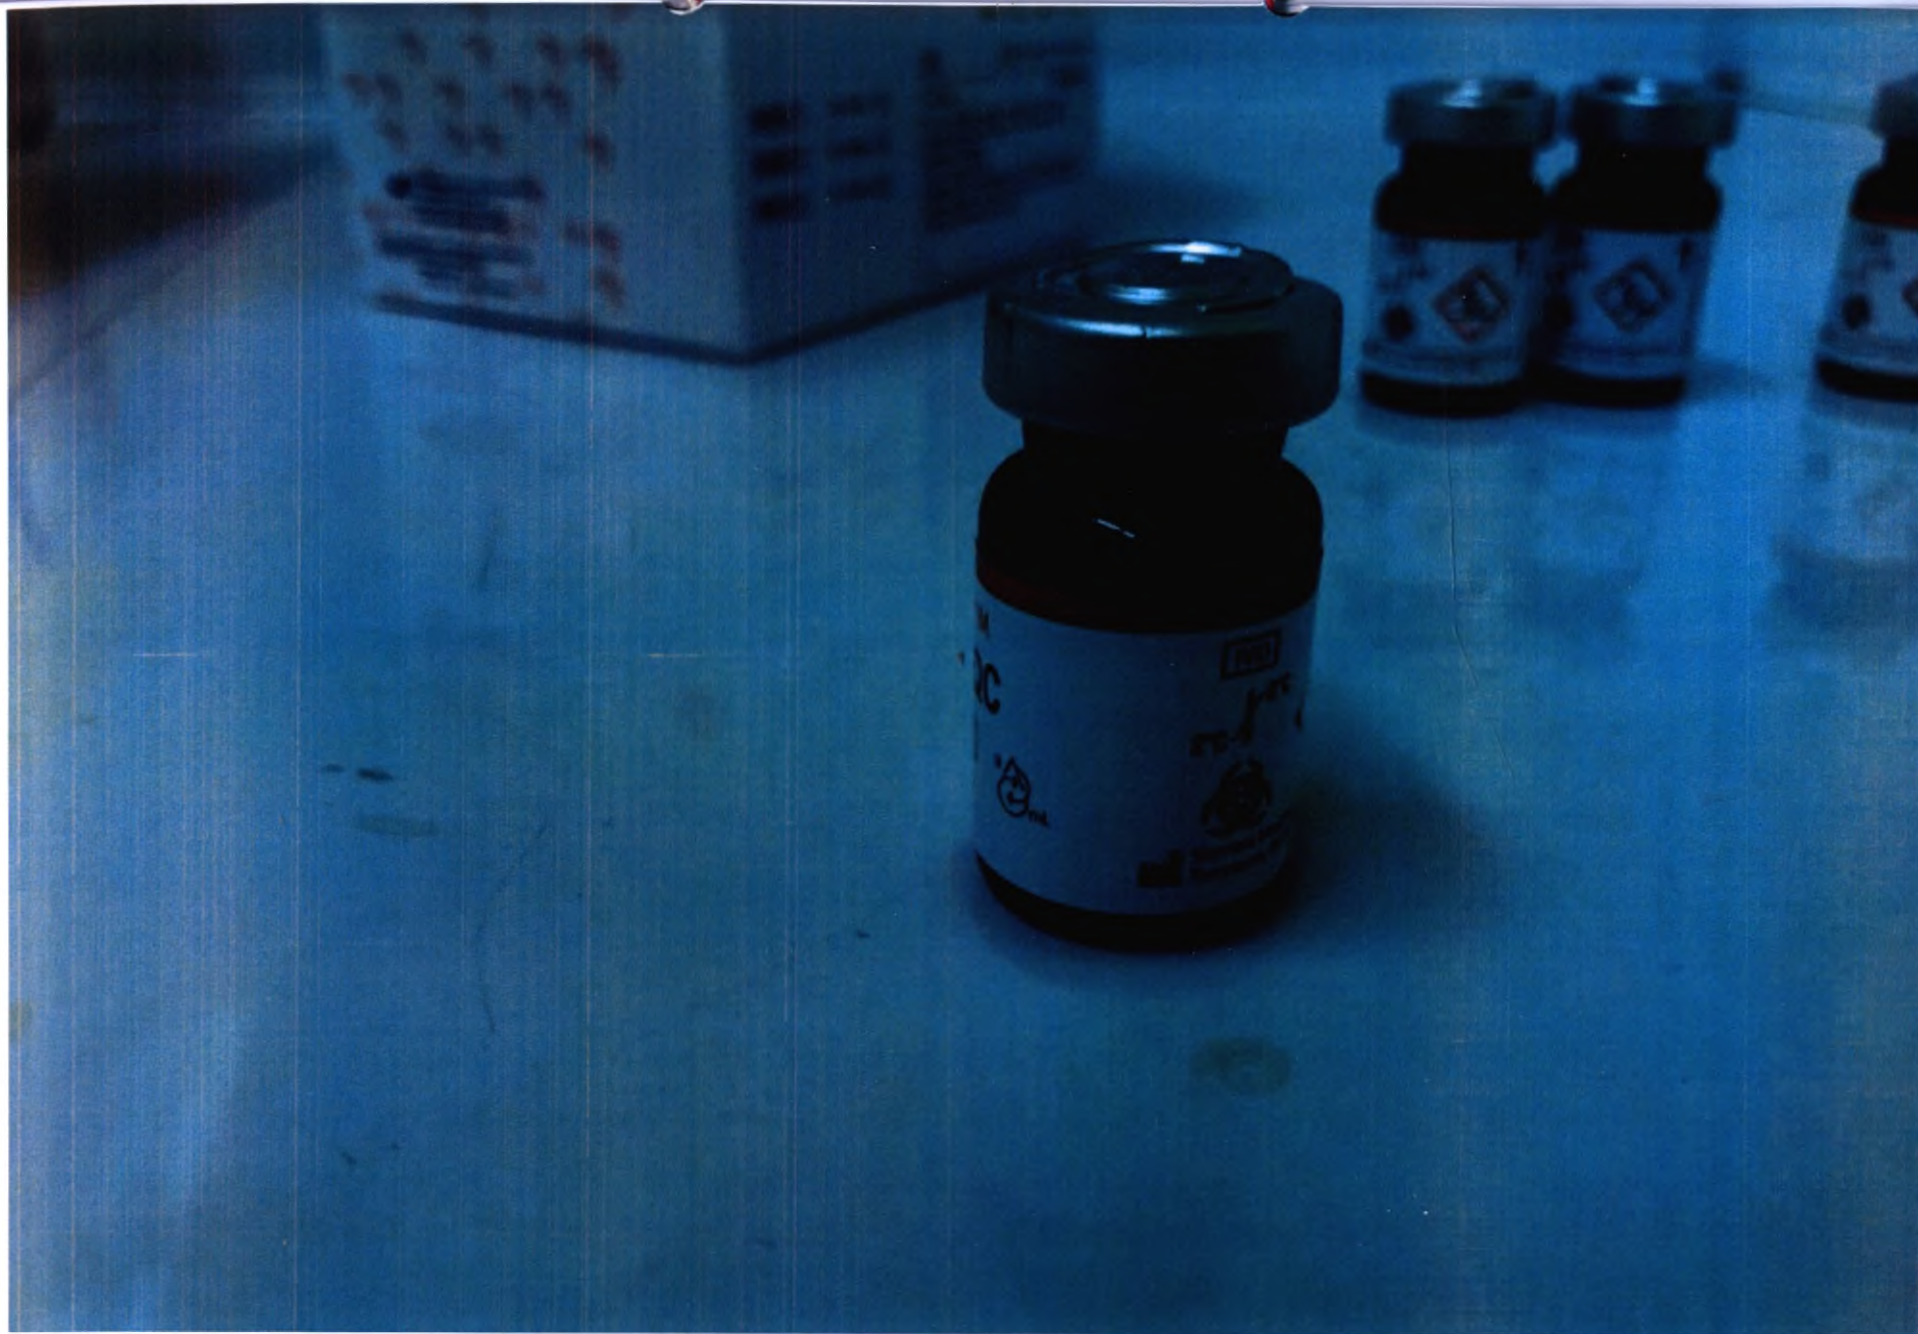


Рисунок 7. Набор контрольных материалов для определения интактного паратиреоидного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Intact Parathyroid Hormone Quality Control (Atellica IM PTH QC)): Контрольный материал 2-го уровня Atellica IM PTH QC CONTROL 2, 1,0 мл.

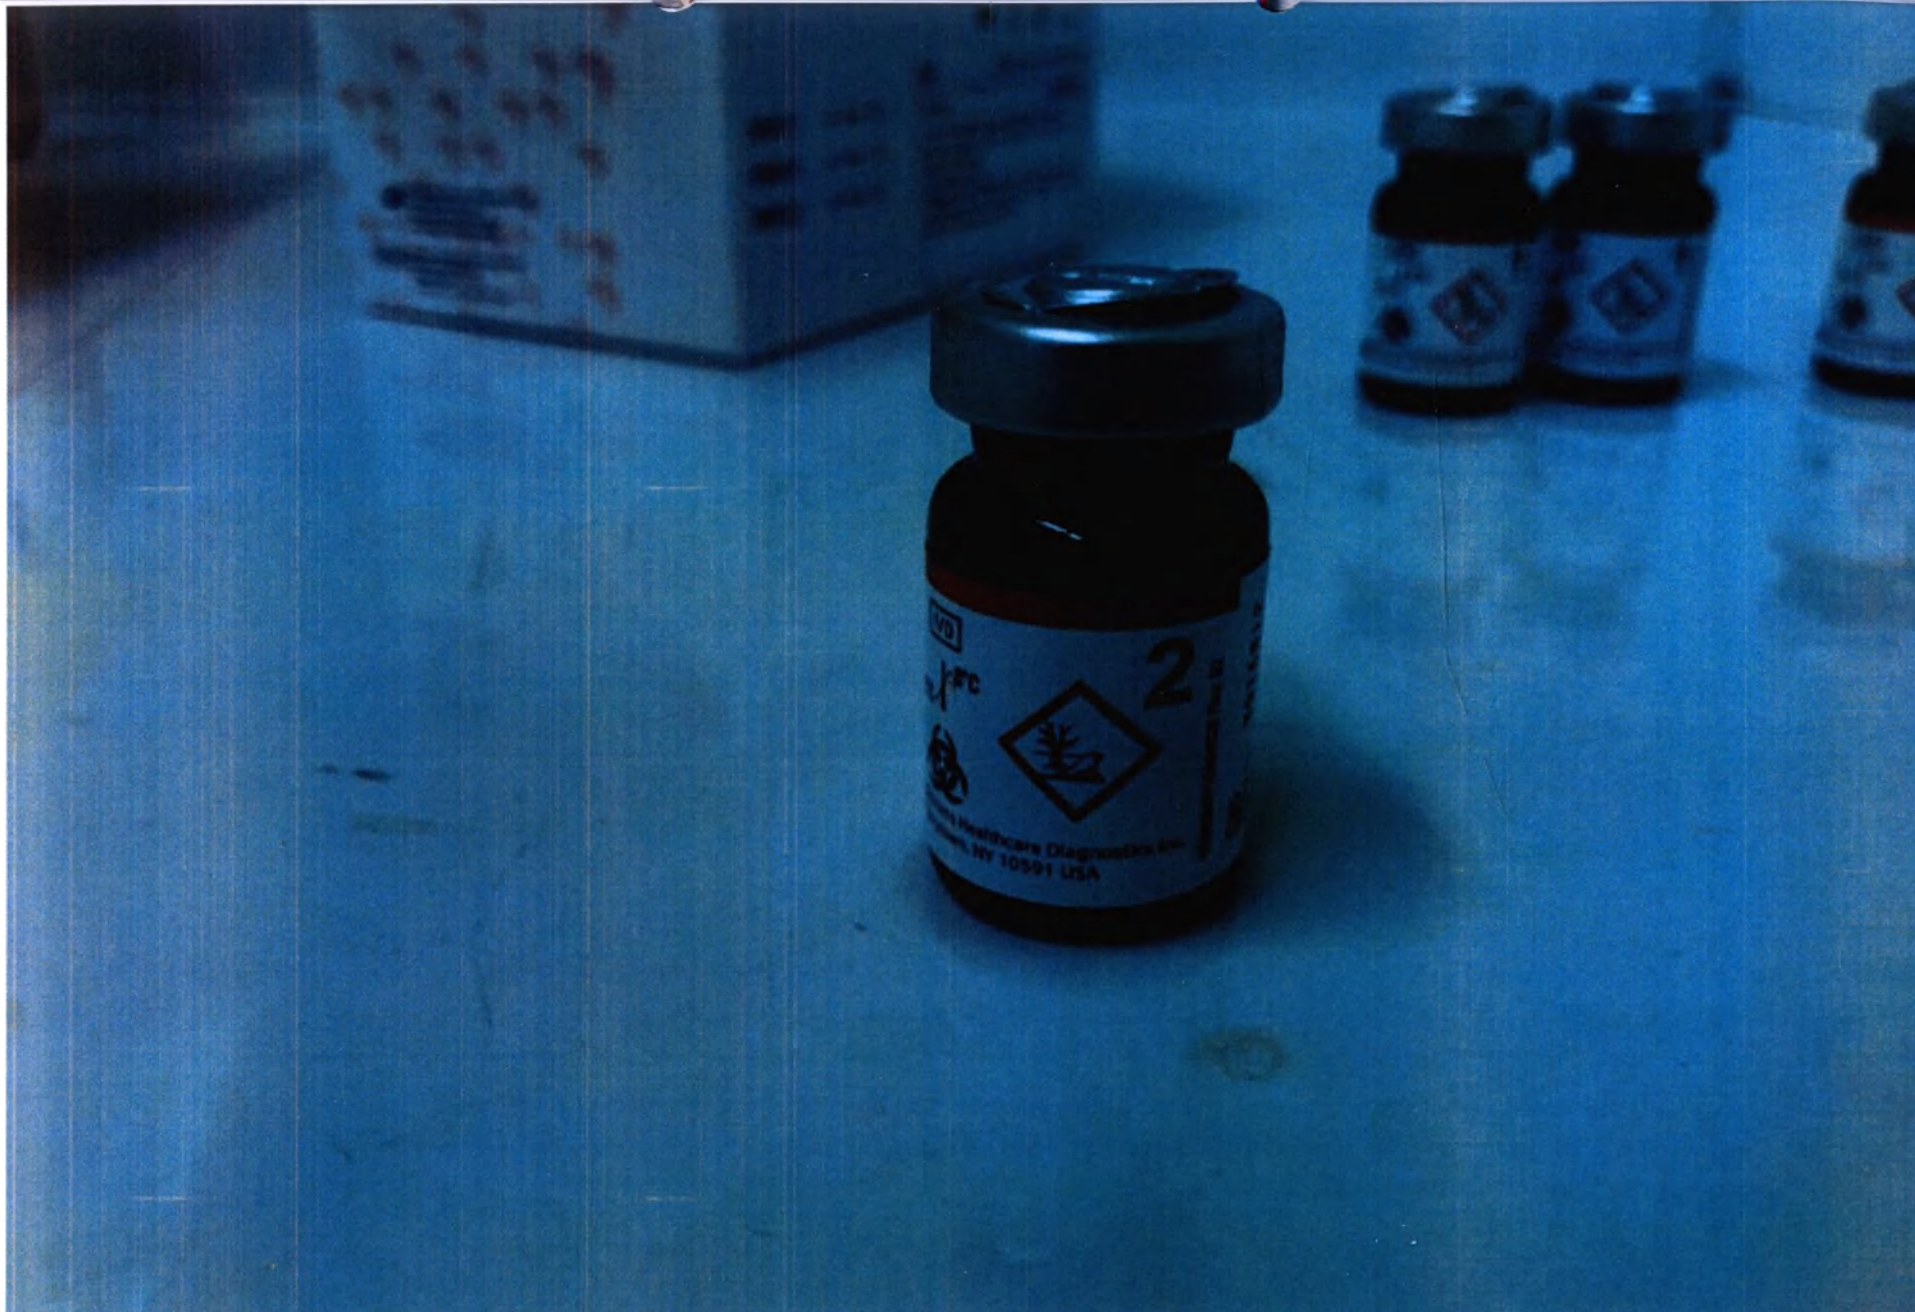


Рисунок 8. Набор контрольных материалов для определения интактного паратиреоидного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Intact Parathyroid Hormone Quality Control (Atellica IM PTH QC)): Контрольный материал 2-го уровня Atellica IM PTH QC CONTROL 2, 1,0.

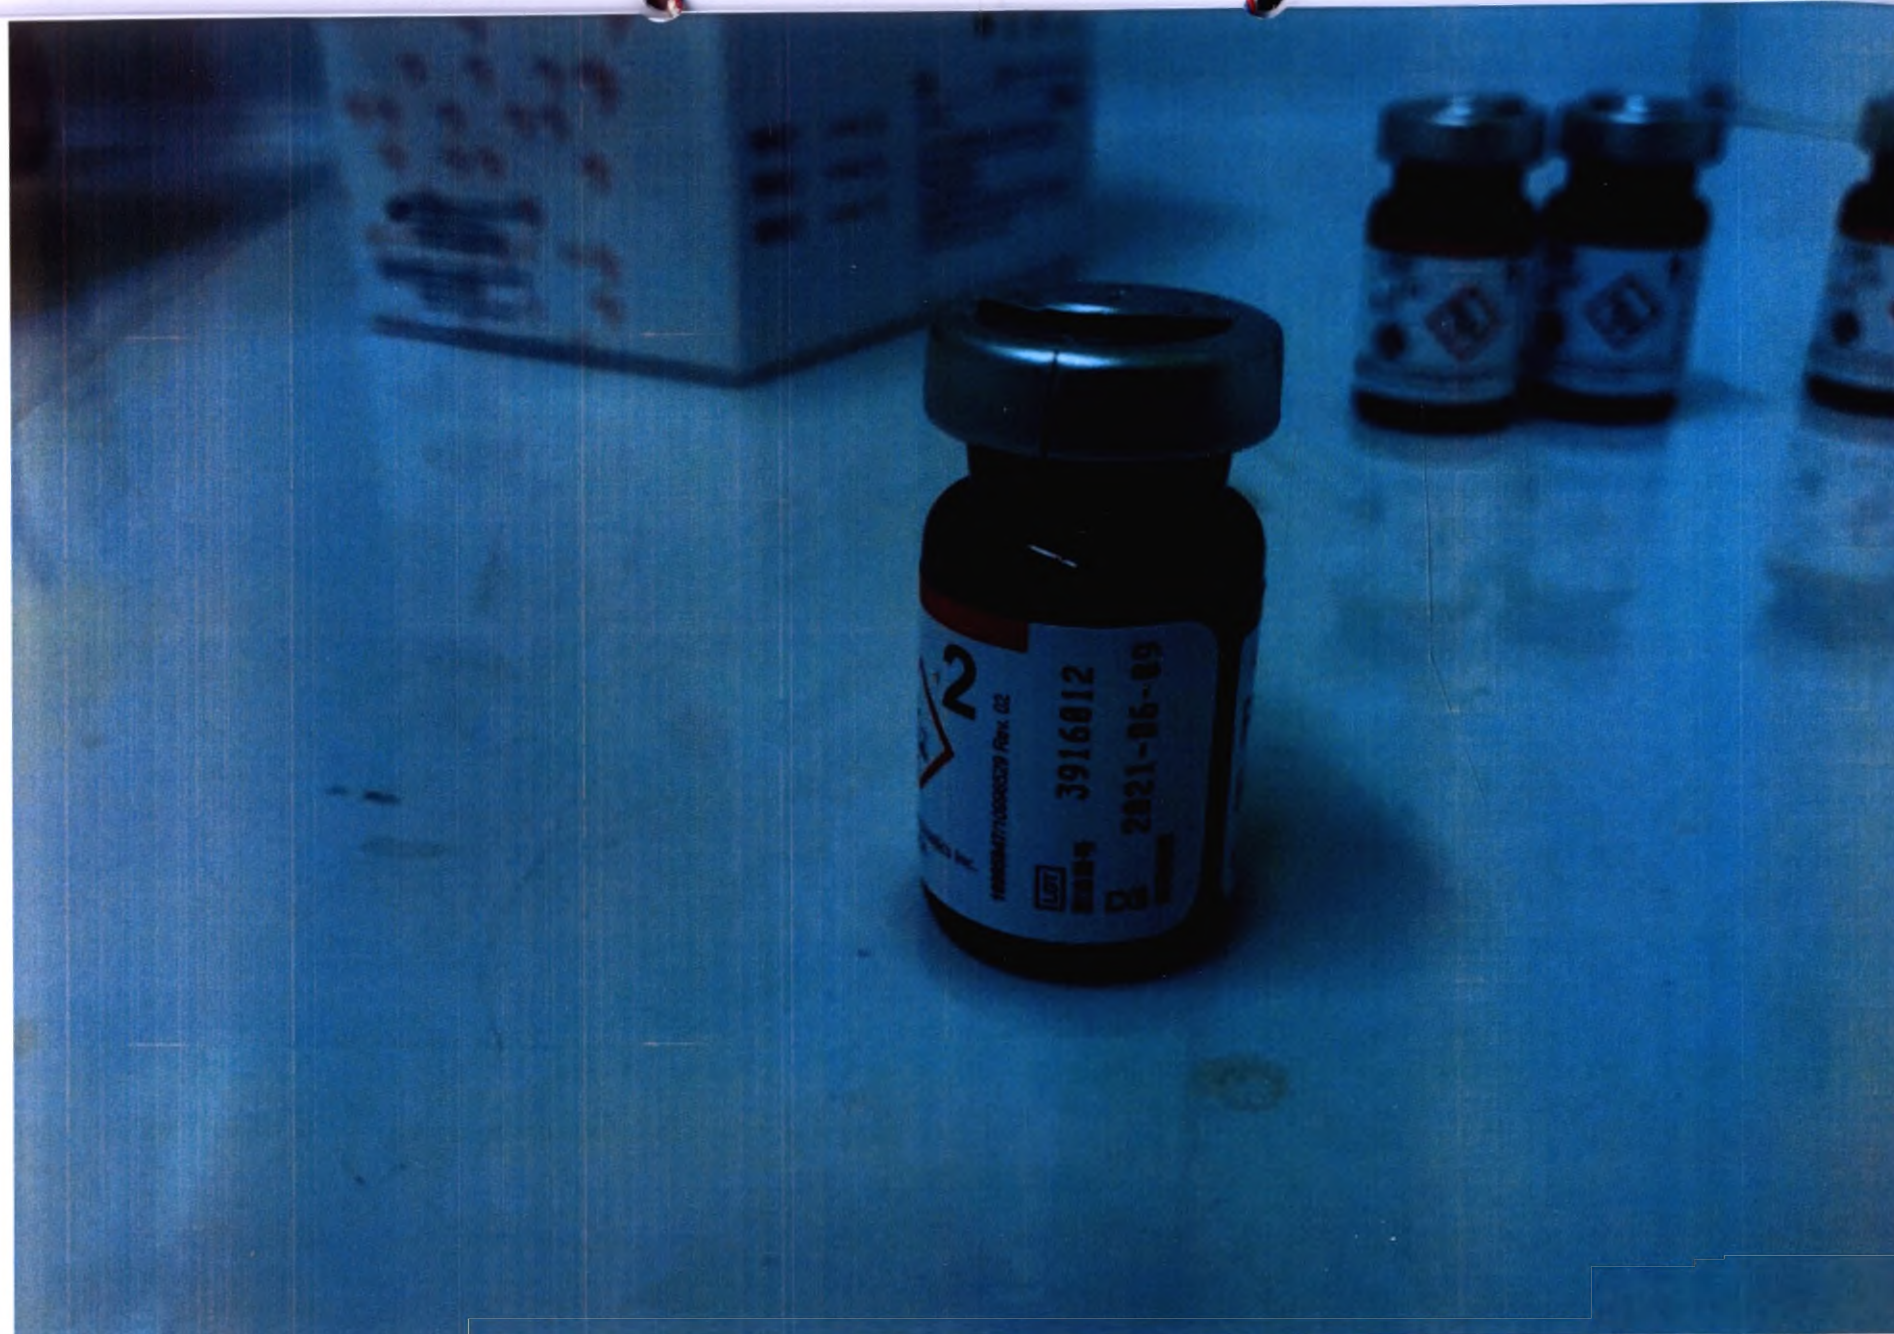


Рисунок 9. Набор контрольных материалов для определения интактного паратиреоидного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Intact Parathyroid Hormone Quality Control (Atellica IM PTH QC)): Контрольный материал 2-го уровня Atellica IM PTH QC CONTROL 2, 1,0.

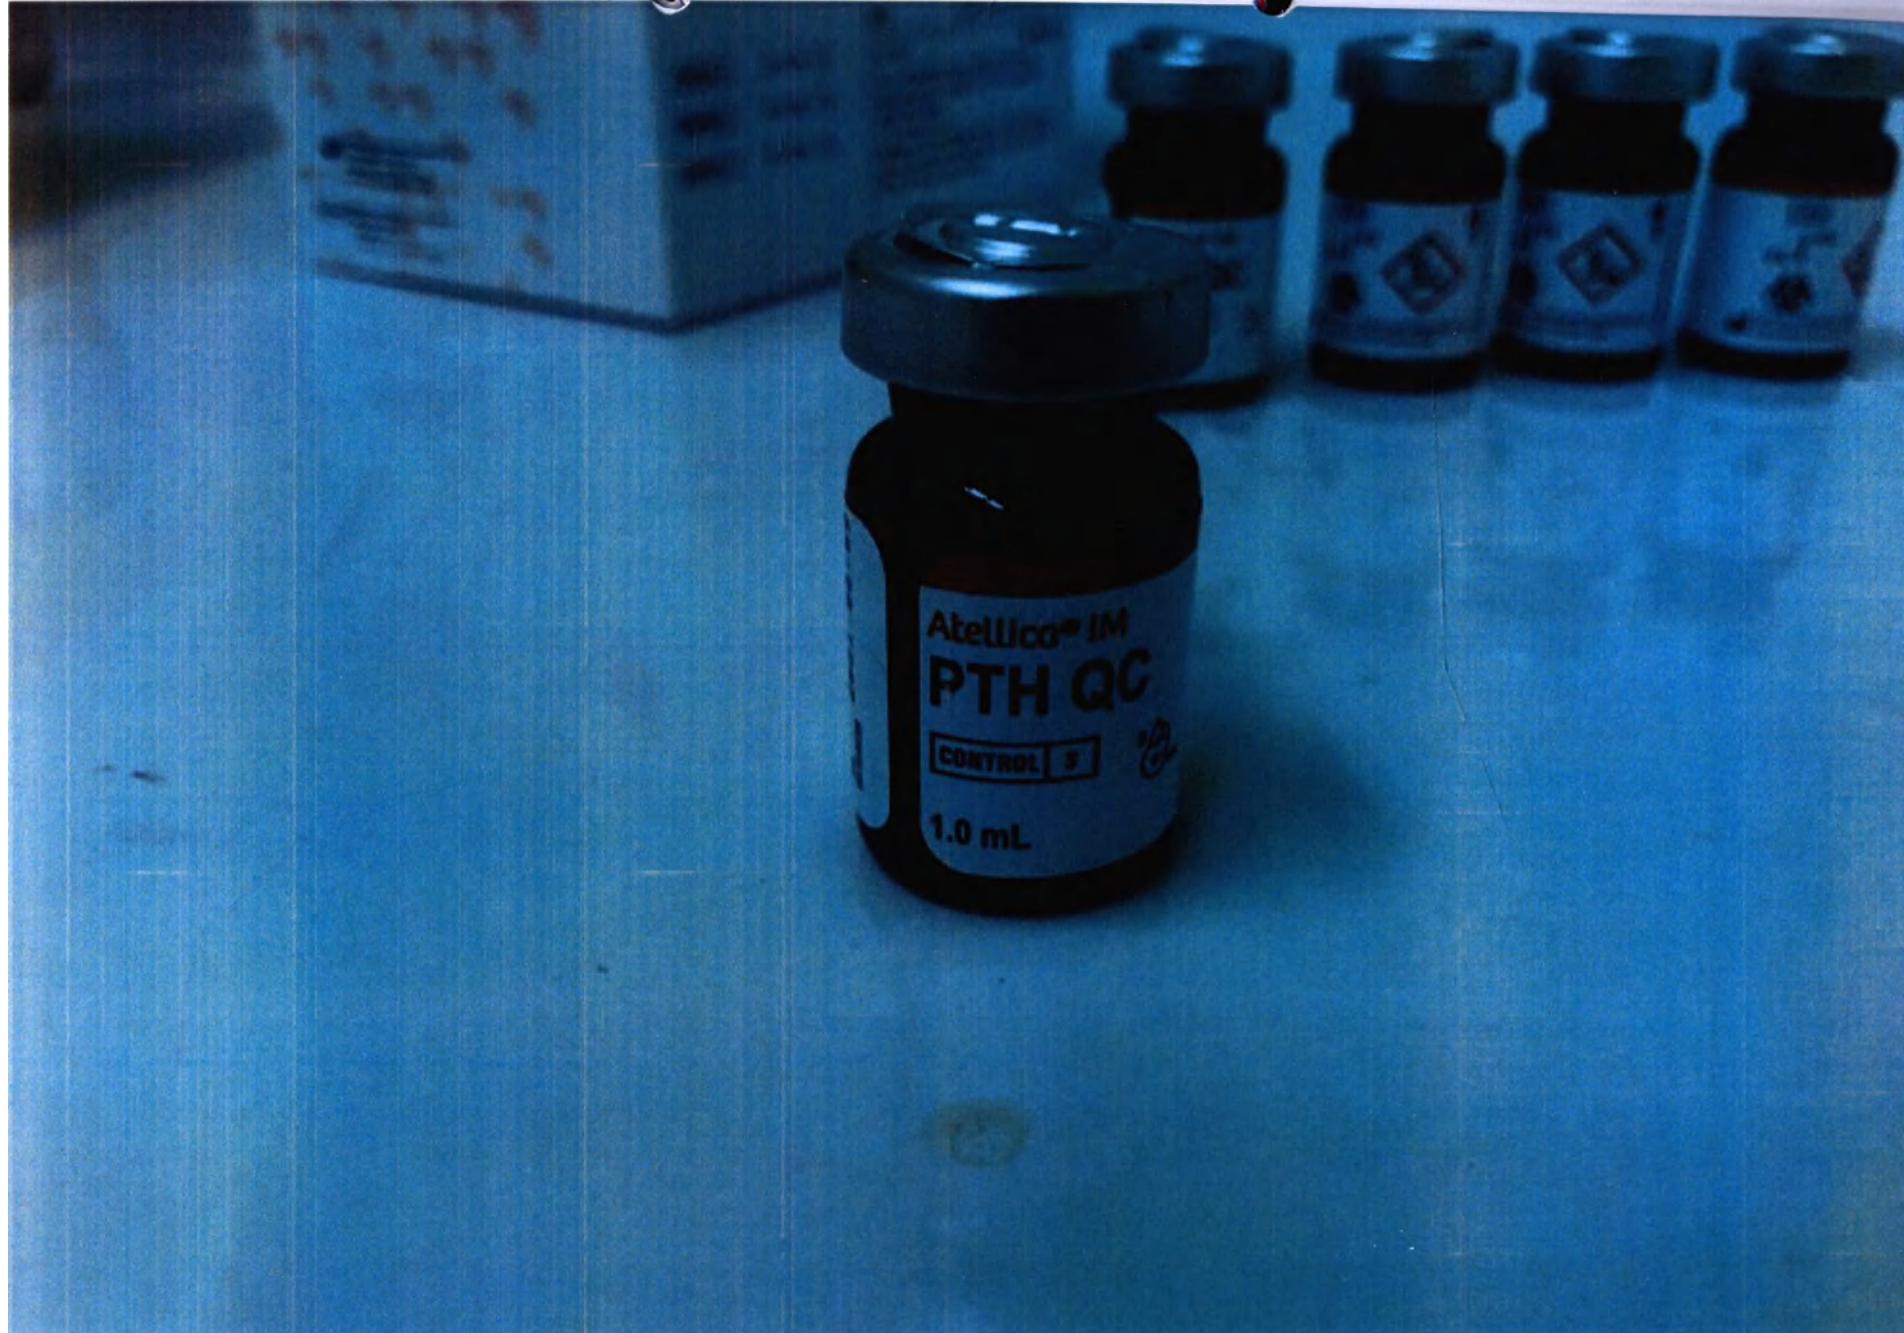


Рисунок 10. Набор контрольных материалов для определения интактного паратиреоидного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Intact Parathyroid Hormone Quality Control (Atellica IM PTH QC)): Контрольный материал 3-го уровня Atellica IM PTH QC CONTROL 3, 1,0 мл.

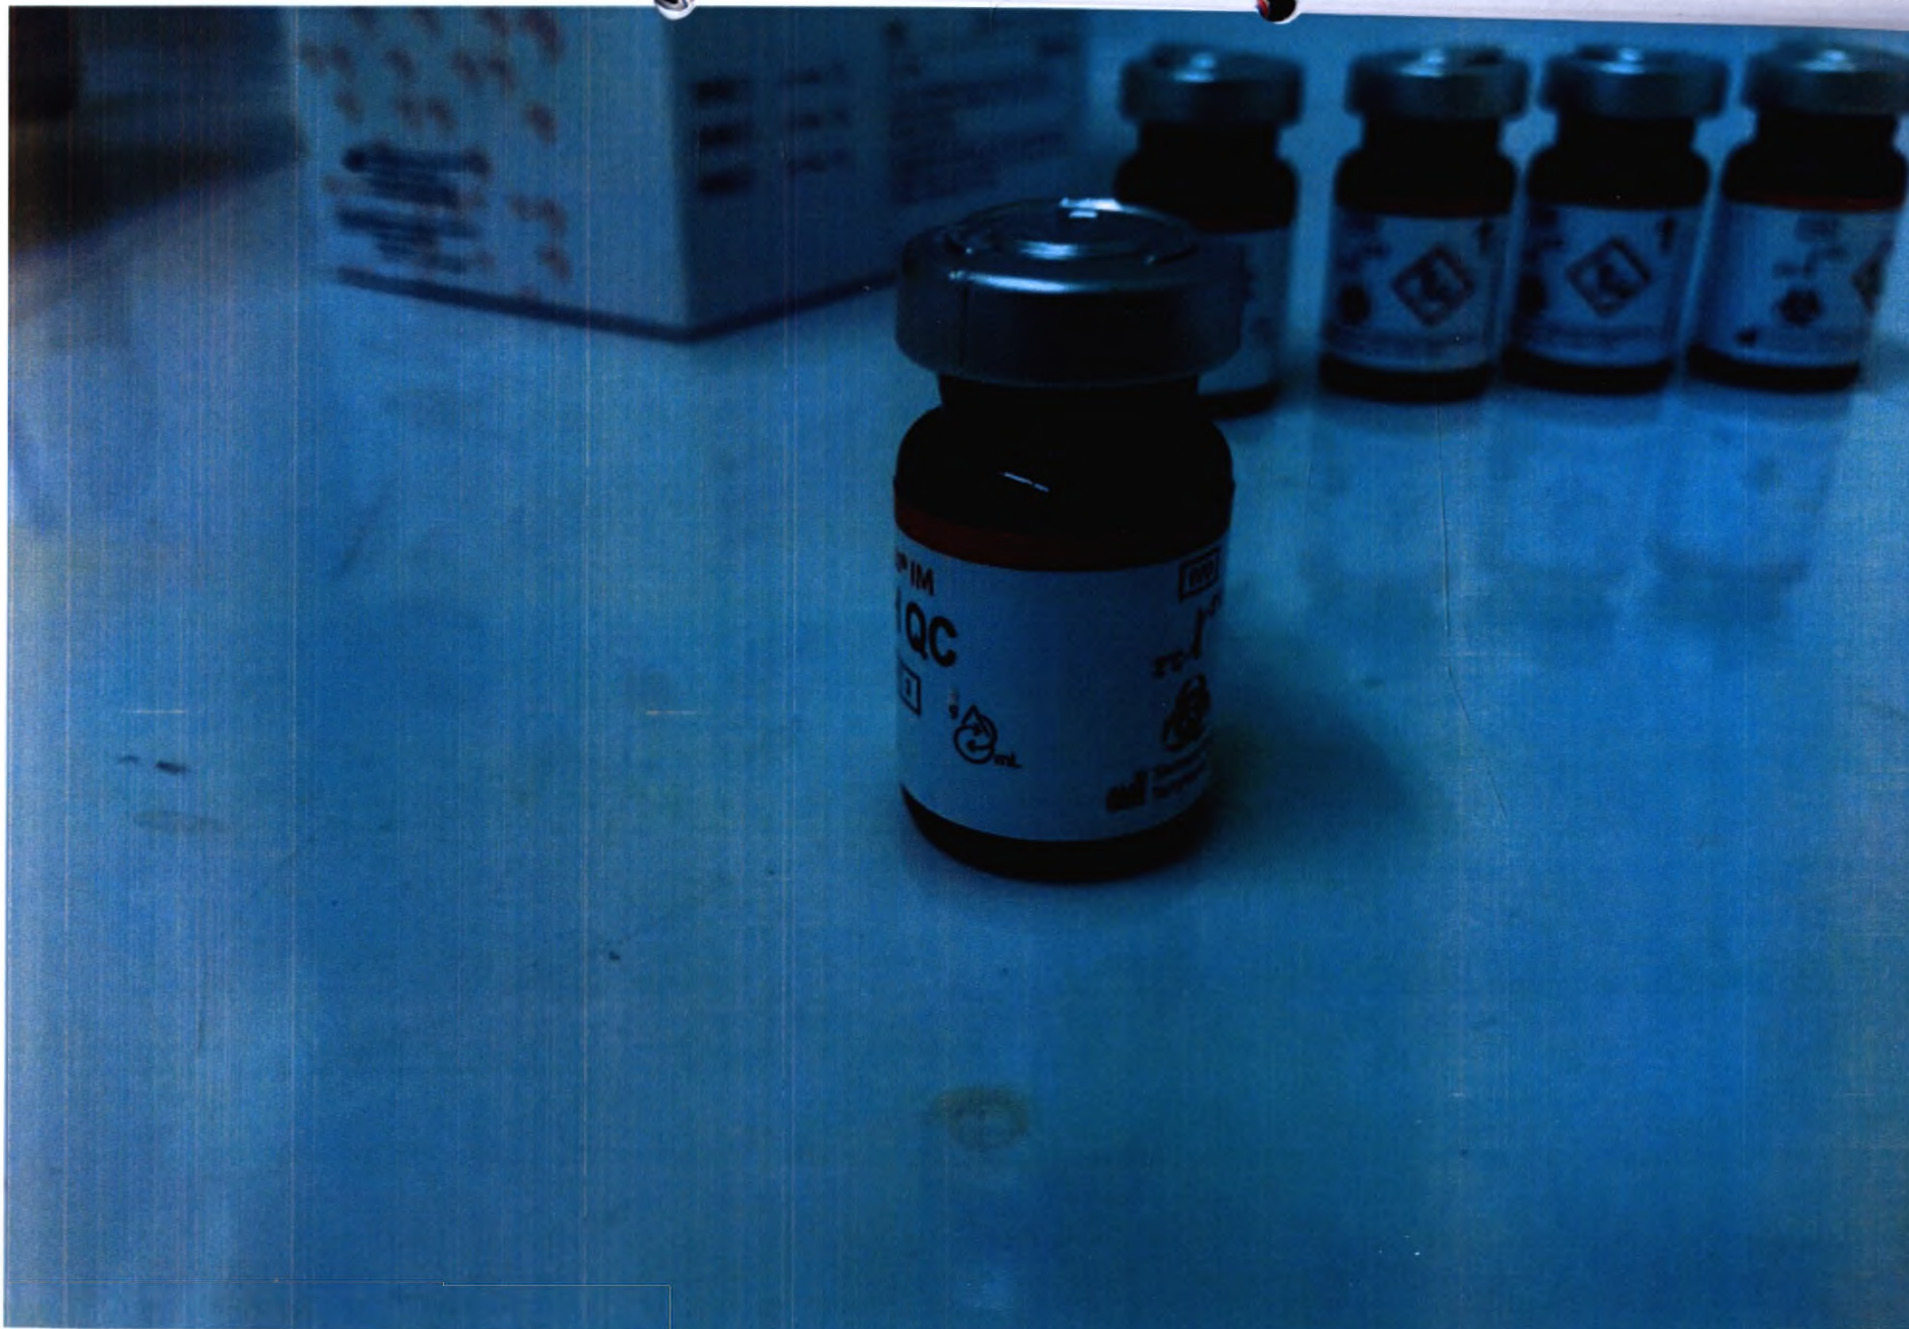
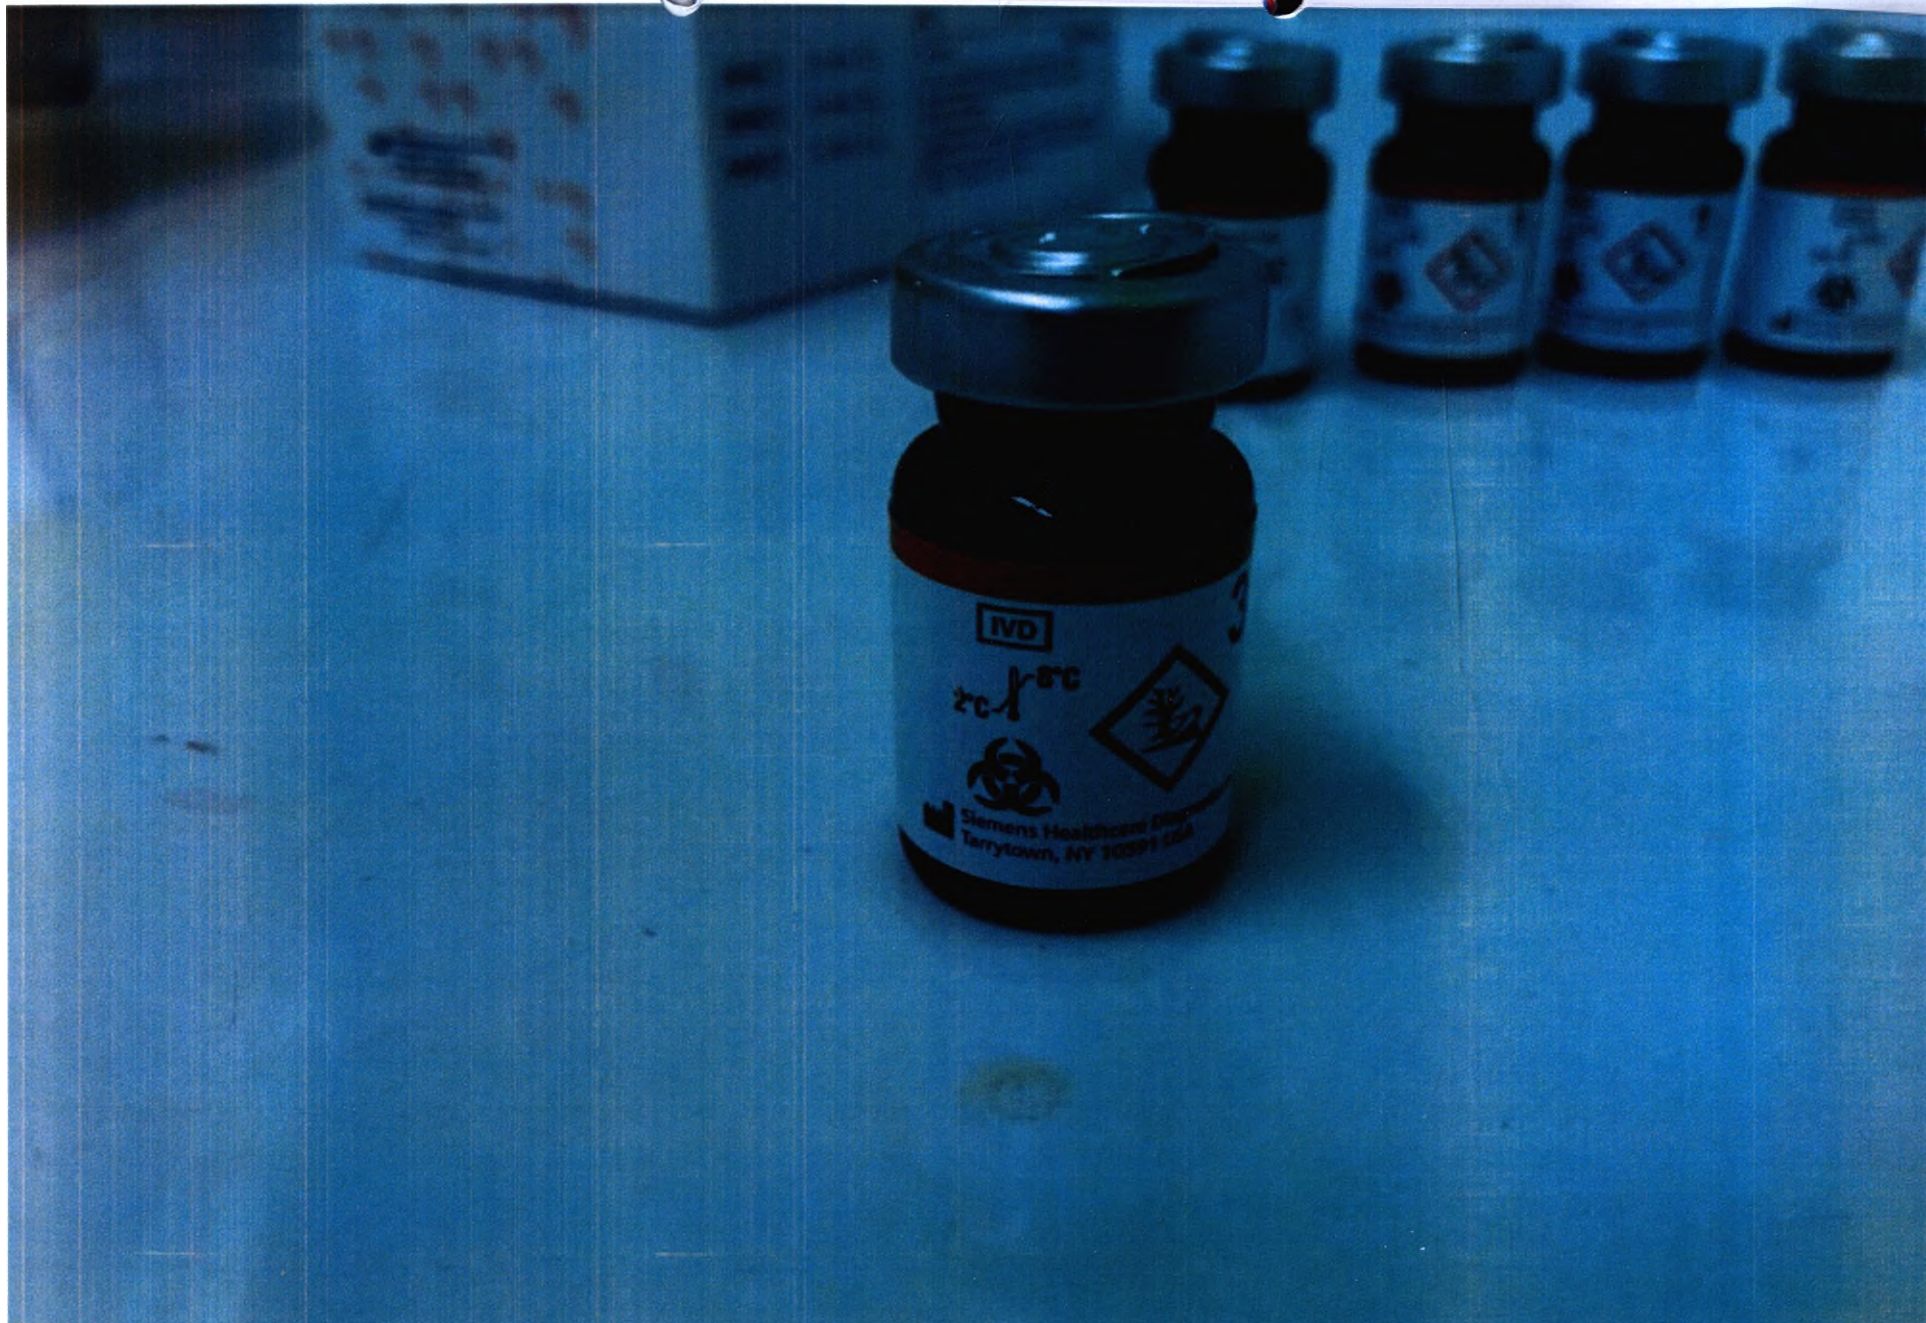


Рисунок 11. Набор контрольных материалов для определения интактного паратиреоидного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Intact Parathyroid Hormone Quality Control (Atellica IM PTH QC)): Контрольный материал 3-го уровня Atellica IM PTH QC CONTROL 3, 1,0 мл.



**Рисунок 12. Набор контрольных материалов для определения интактного паратиреоидного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Intact Parathyroid Hormone Quality Control (Atellica IM PTH QC)): Контрольный материал 3-го уровня Atellica IM PTH QC CONTROL 3, 1,0 мл.**

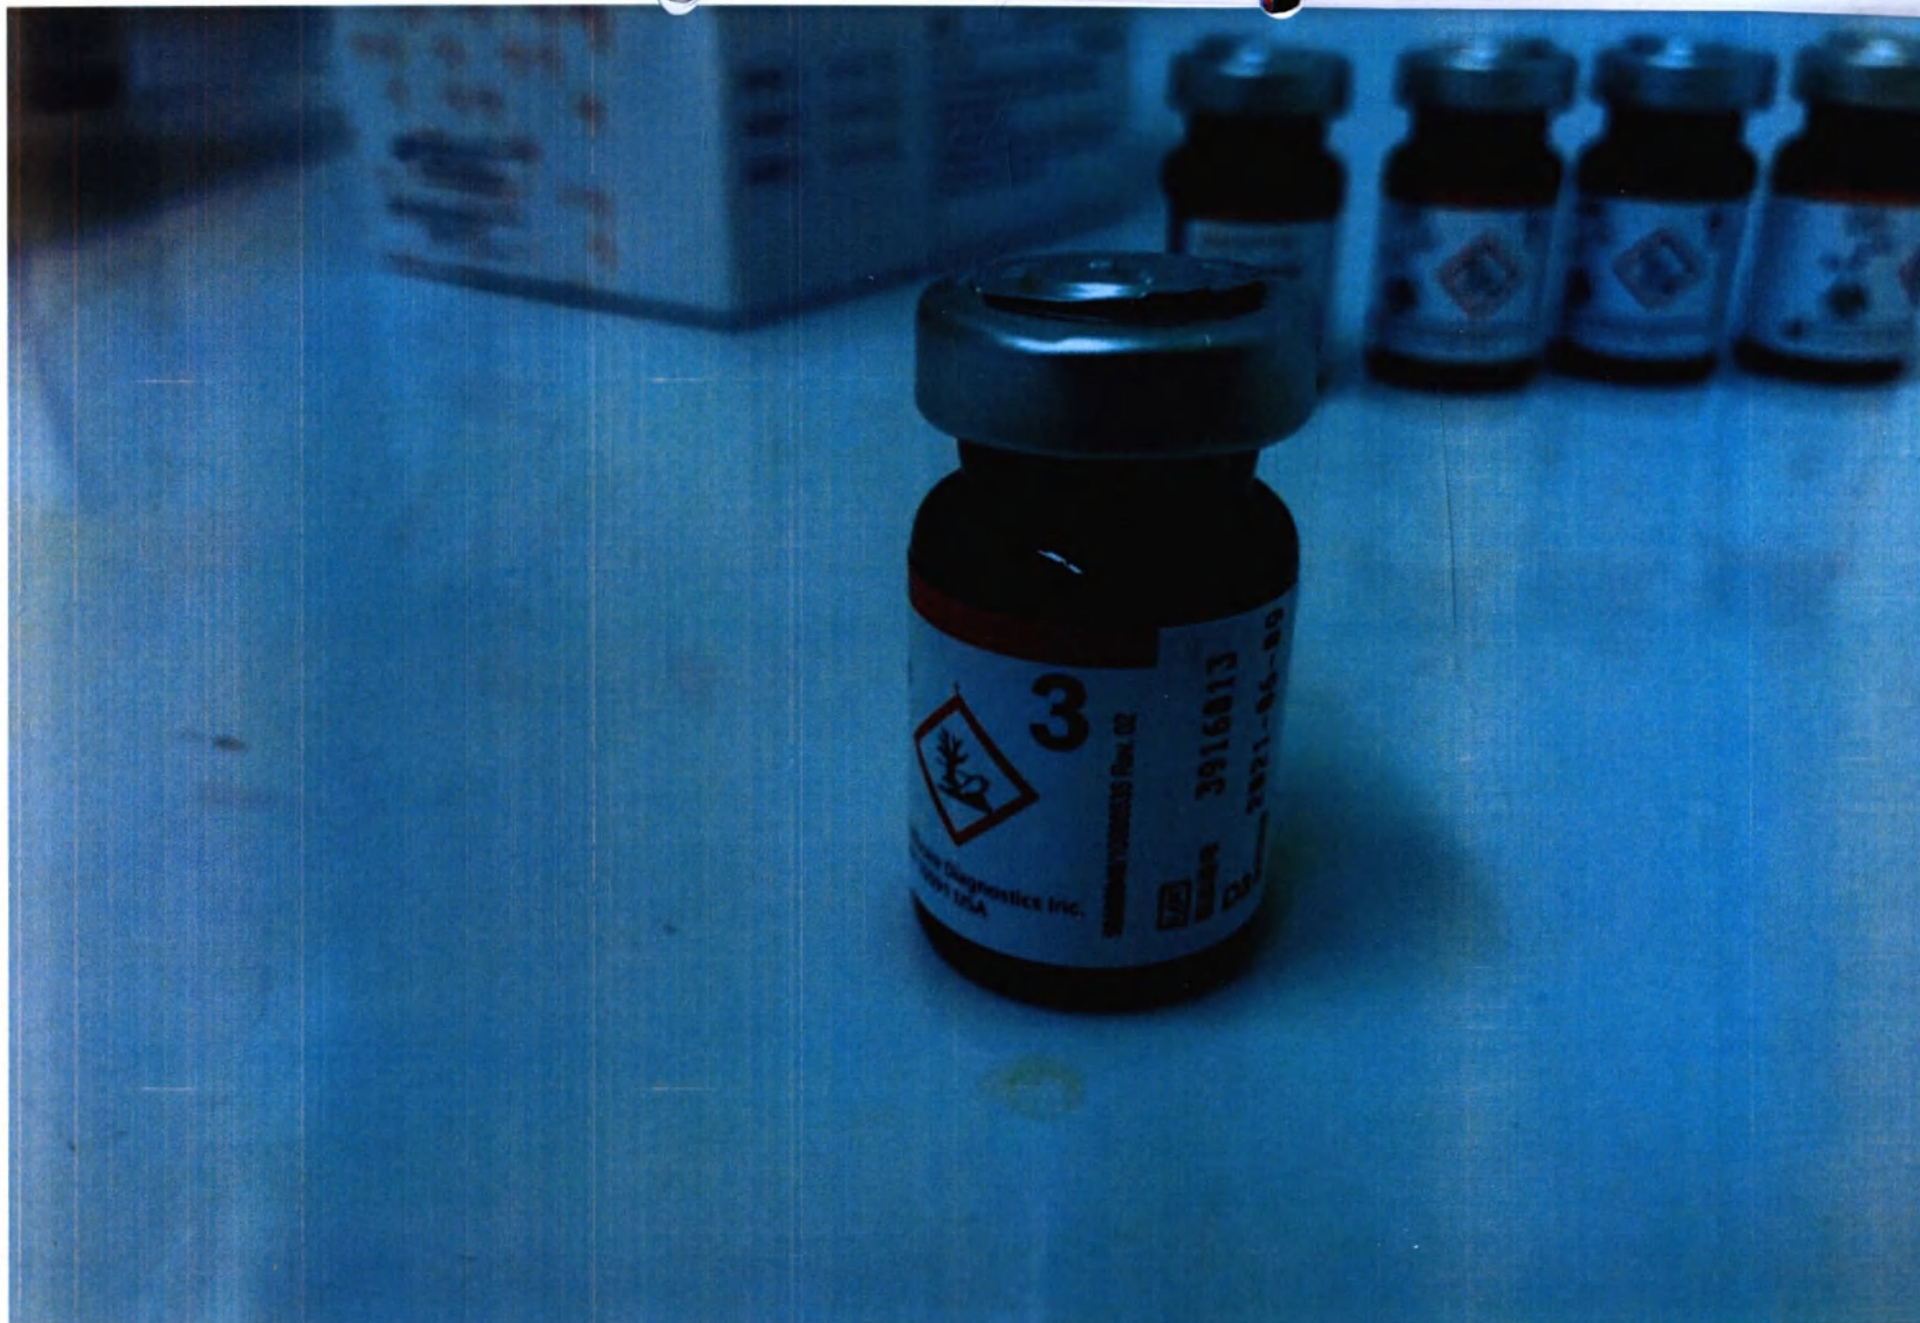


Рисунок 13. Набор контрольных материалов для определения интактного паратиреоидного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Intact Parathyroid Hormone Quality Control (Atellica IM PTH QC)): Контрольный материал 3-го уровня Atellica IM PTH QC CONTROL 3, 1,0 мл.

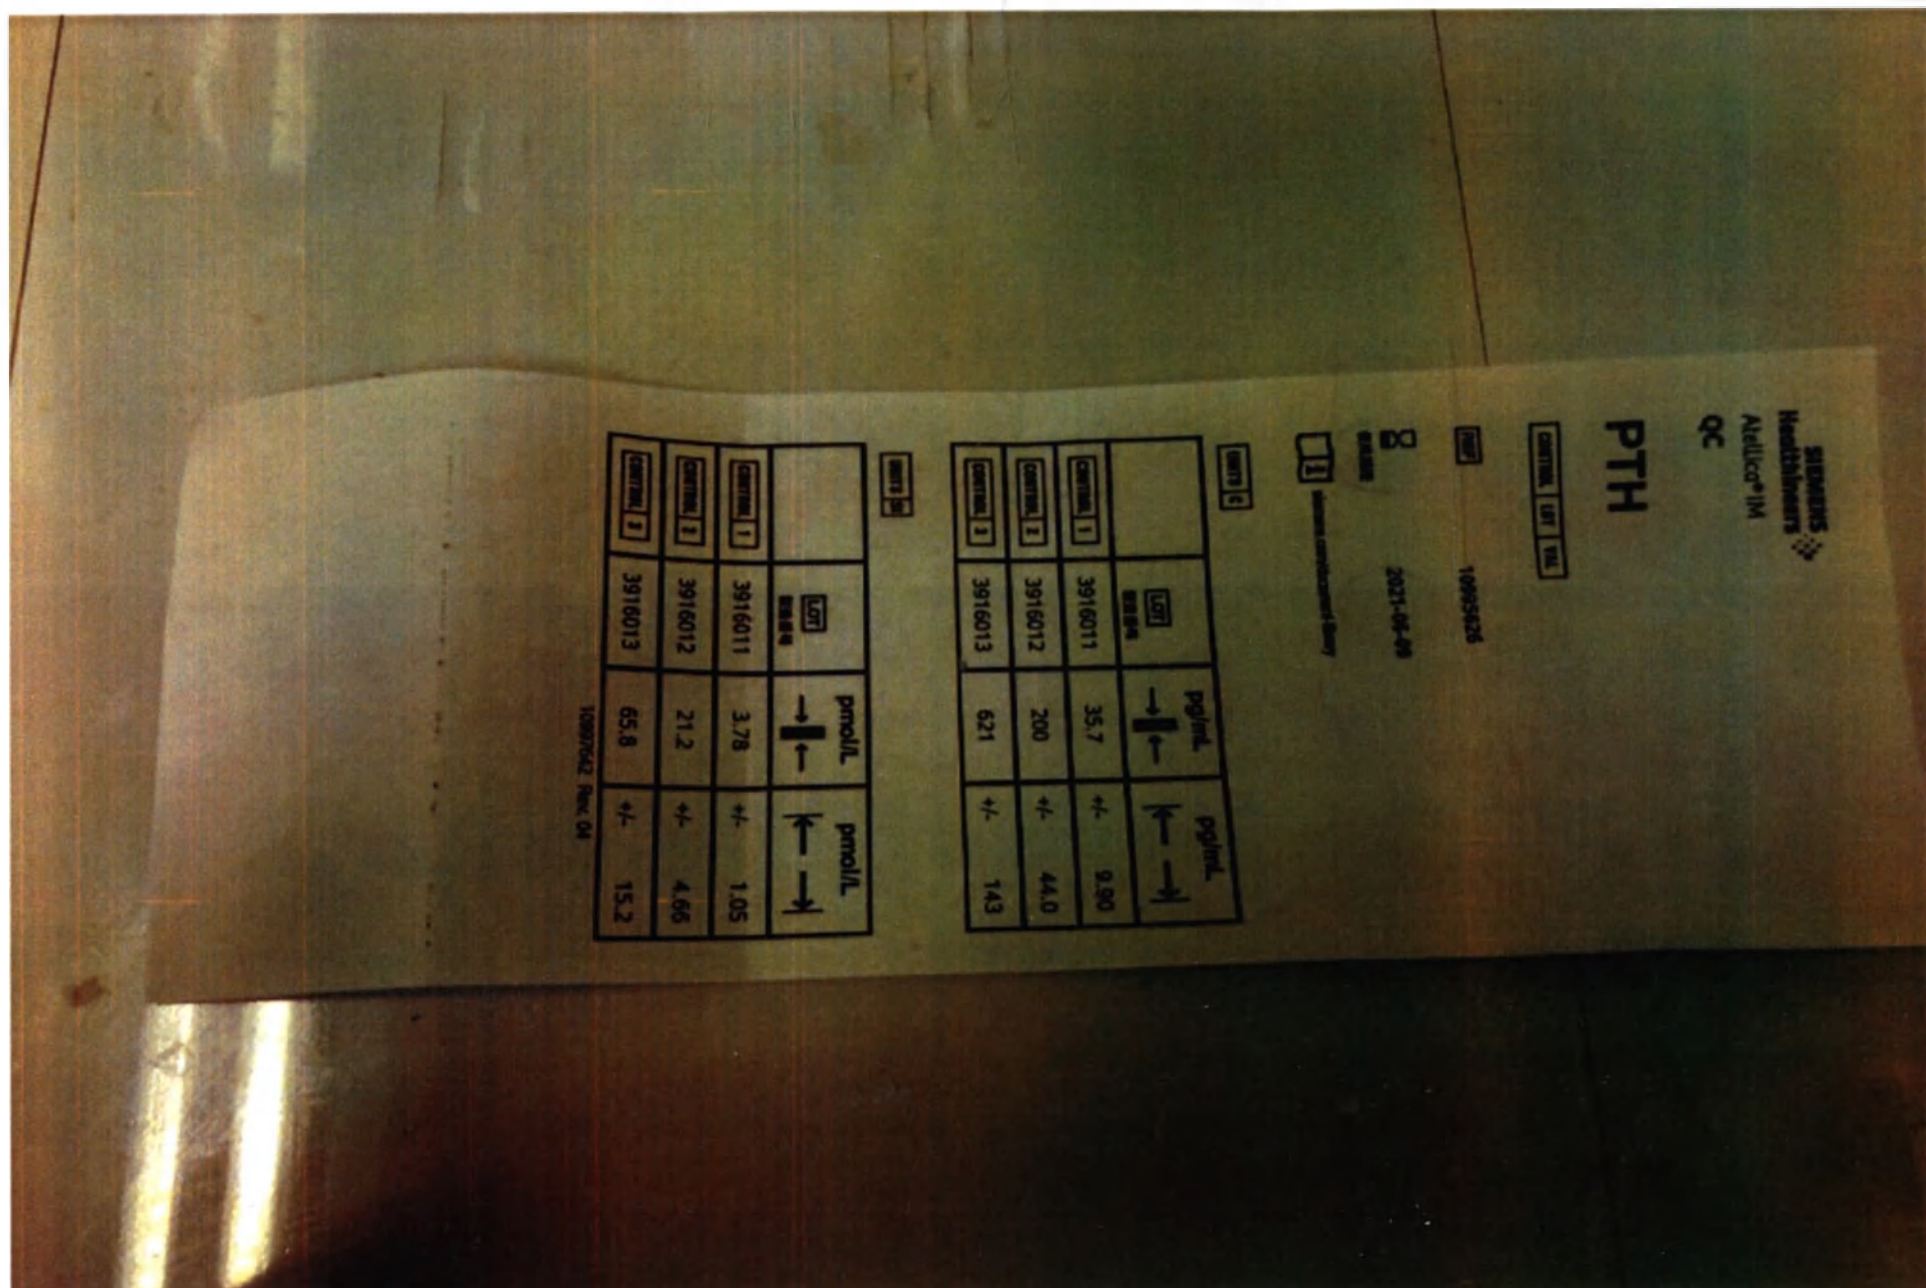


Рисунок 14. Набор контрольных материалов для определения интактного паратиреоидного гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Intact Parathyroid Hormone Quality Control (Atellica IM PTH QC)); Лист значений контрольных материалов для конкретного лота.

Всего прошито и пронумеровано  
15 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

