


Фотографии общего вида медицинского изделия

**Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения
кальпротектина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 –
NESCAUTO Cp Auto AA01**


«Альфреза Фарма Корпорейшн» (Alfresa Pharma Corporation), Япония


Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения кальпротектина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – NESCAUTO Cp Auto AA01 – Фотография 1

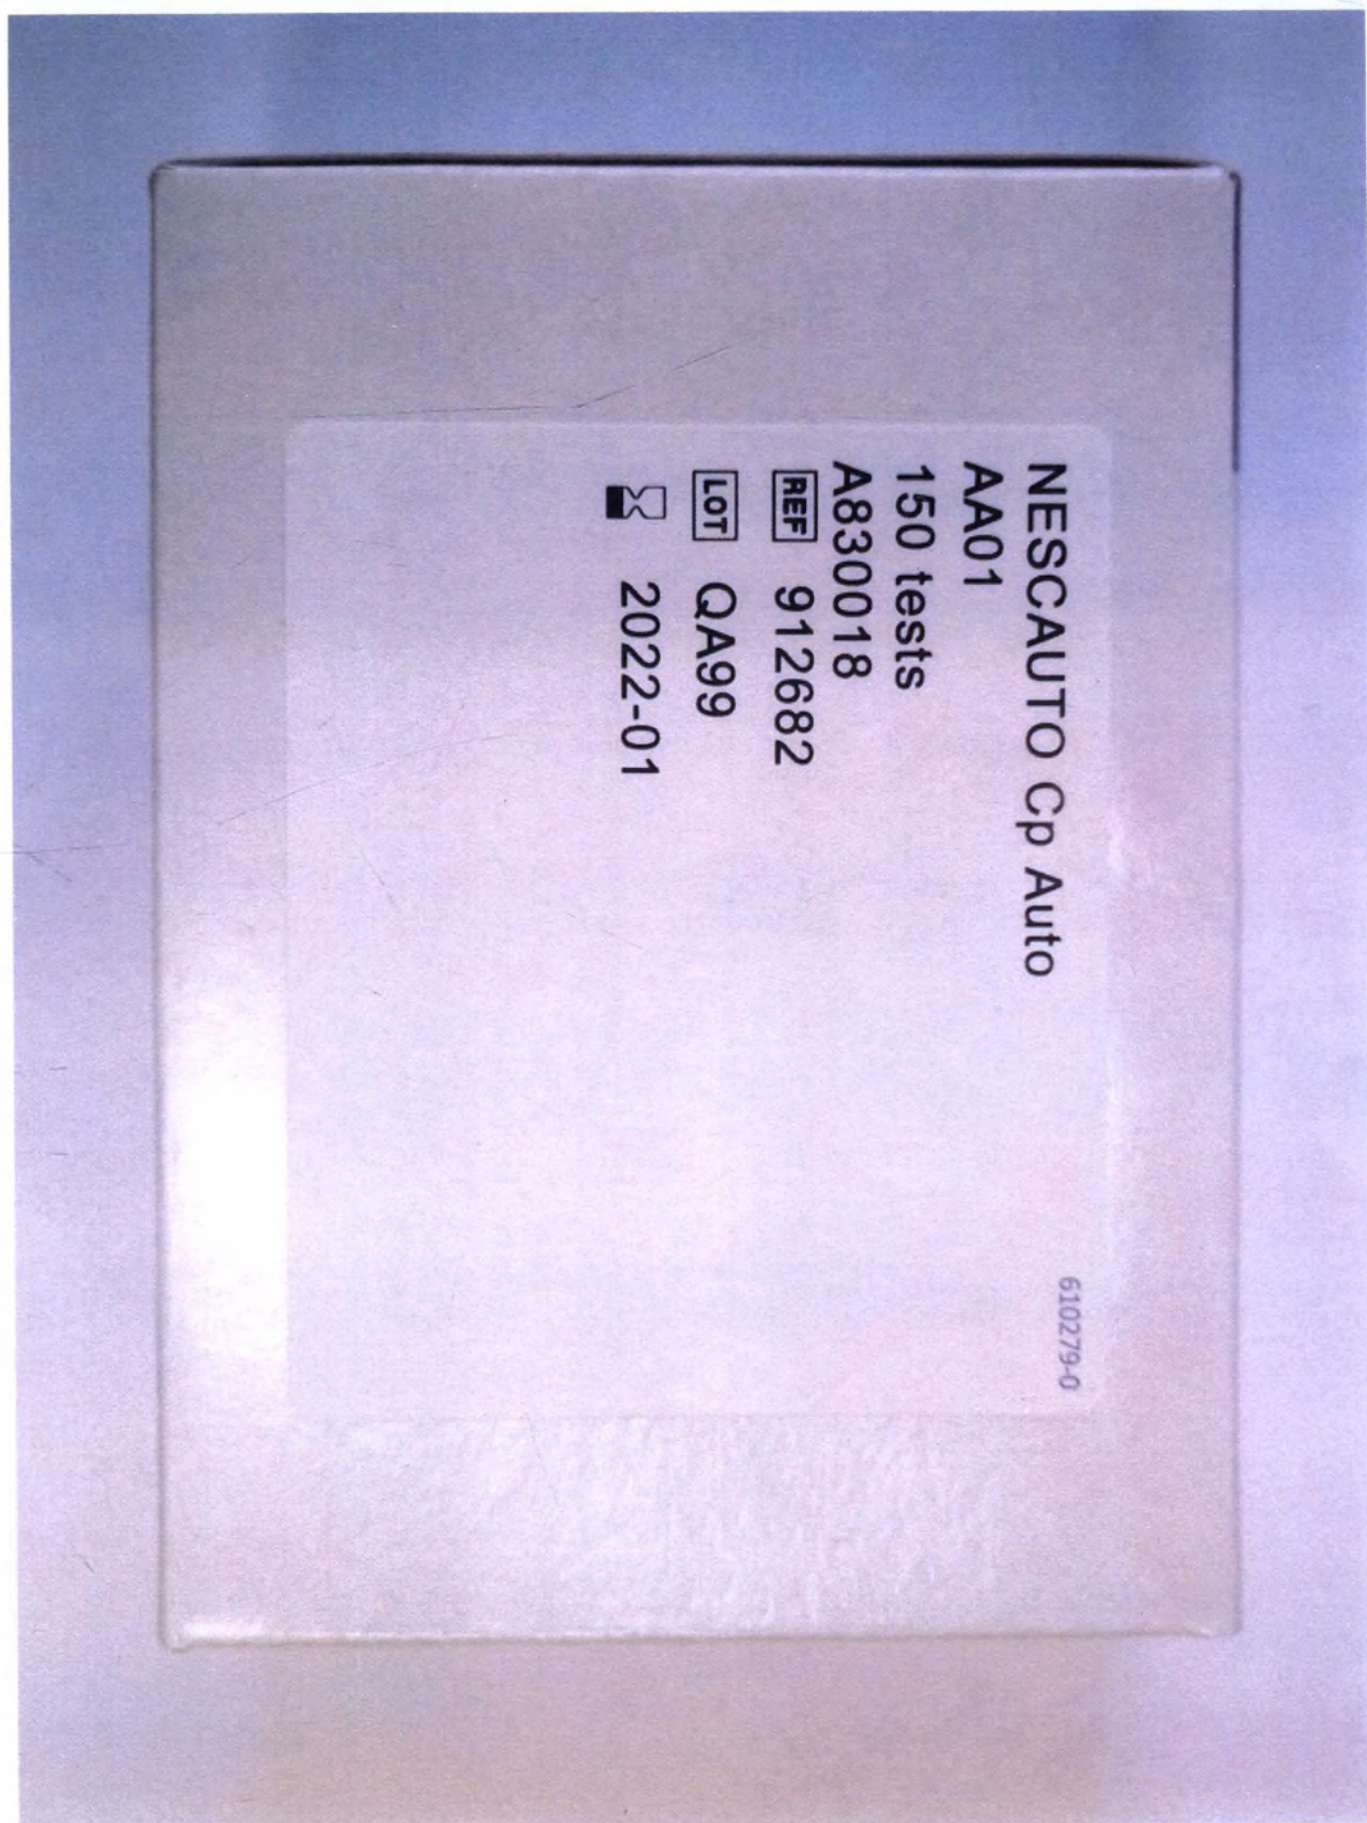

610279-0

Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения кальпротектина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – NESCAUTO Cp Auto AA01 – Фотография 2

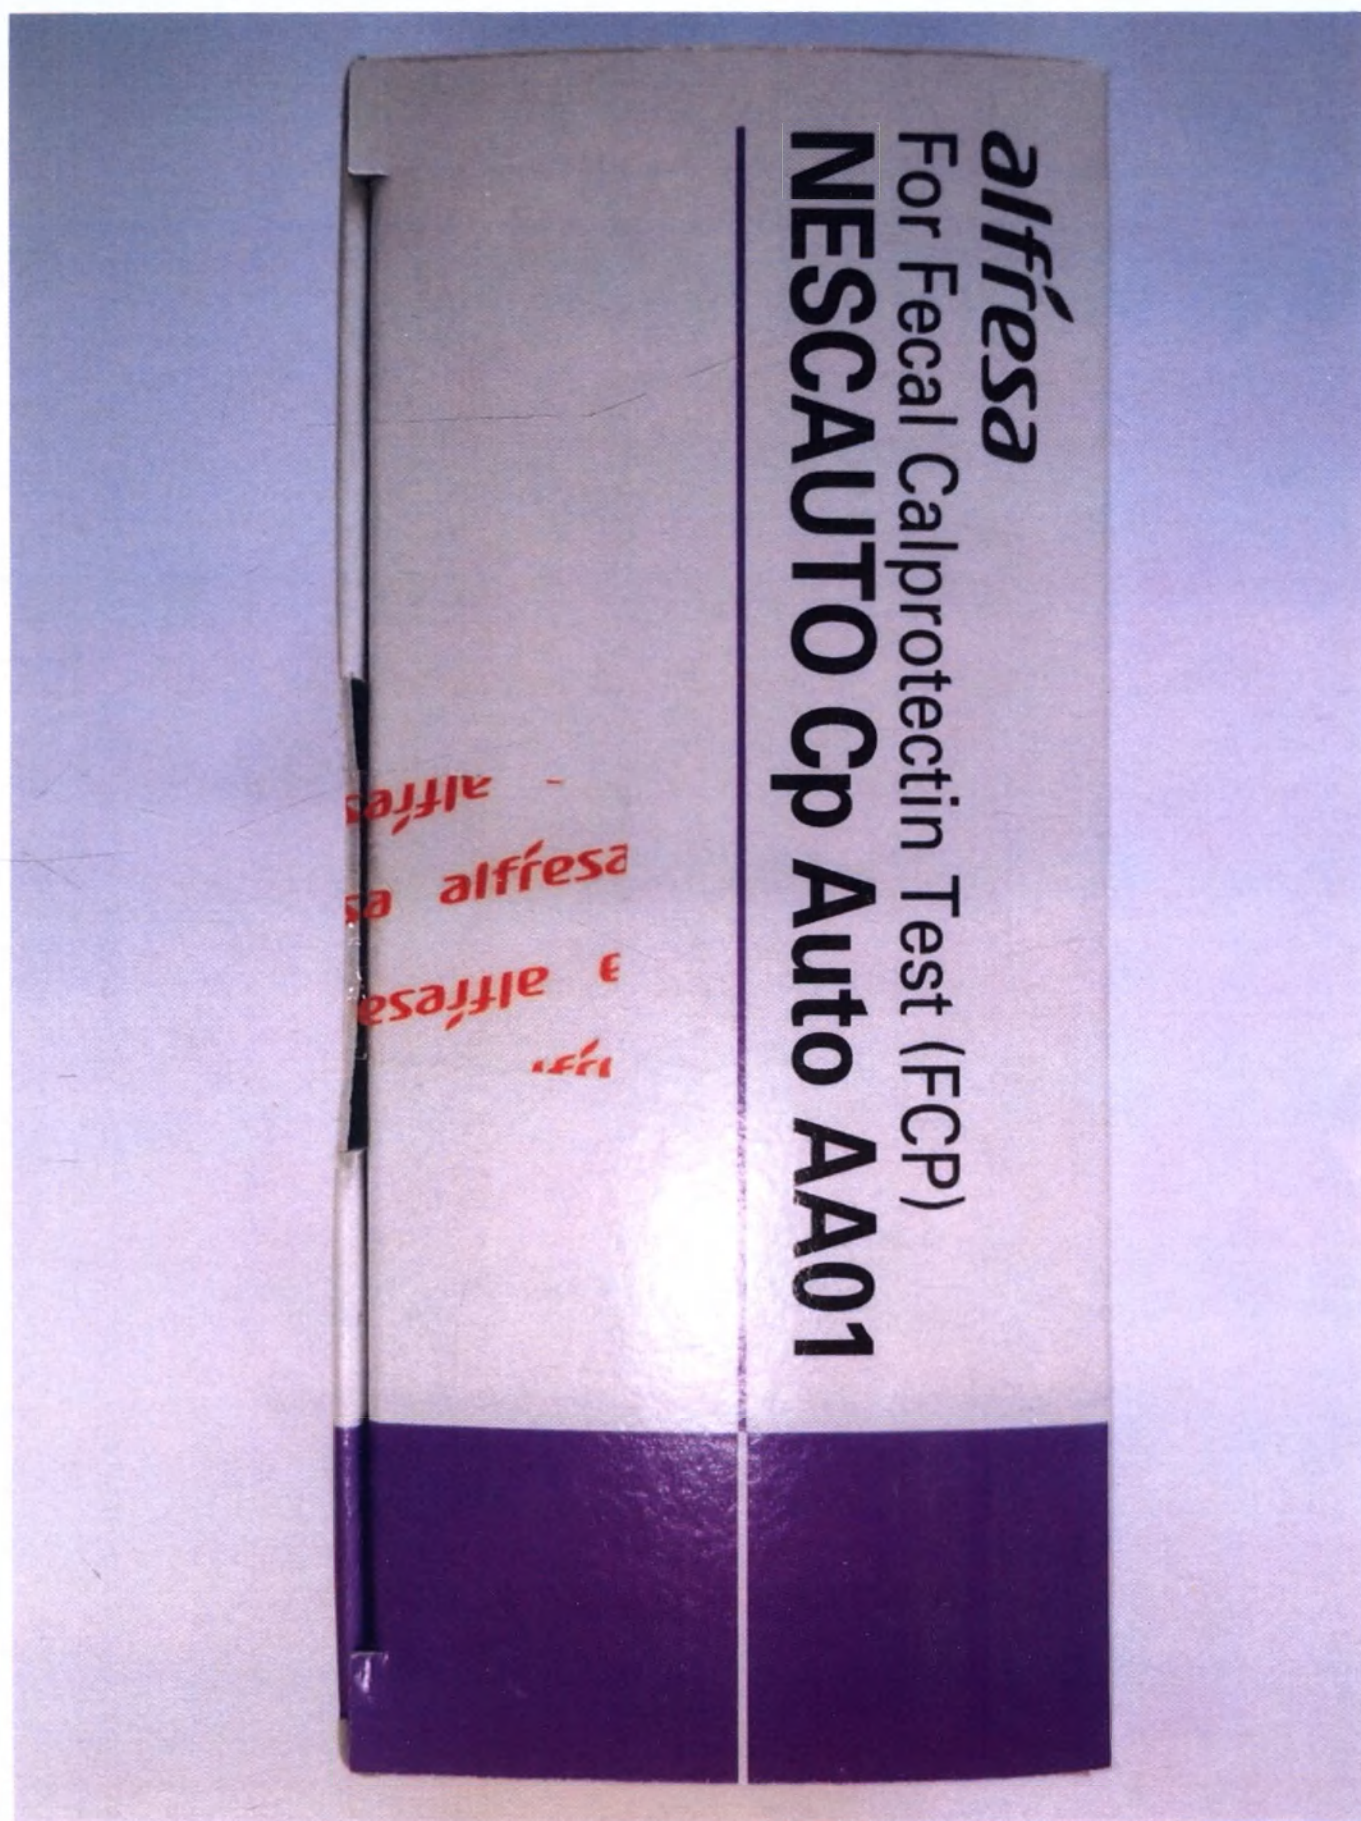

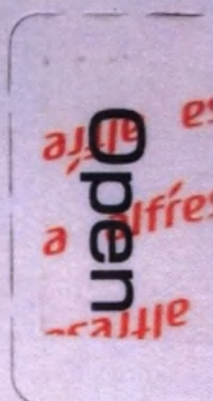

REAG 1

.....2x12mL

REAG 2

.....2x5.5mL



Alfresa Pharma Corporation

18 Taiheidai Shouou-Cho, Katsuta-gun, Okayama,
709-4321, Japan

EC REP

Emergo Europe


Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands

For Fecal Calprotectin Test (FCP)

NESCAUTO Cp Auto AA01




150 tests




Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения кальпротектина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – NESCAUTO Cp Auto AA01 – Фотография 5




Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения кальпротектина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – NESCAUTO Cp Auto AA01 – Фотография 6

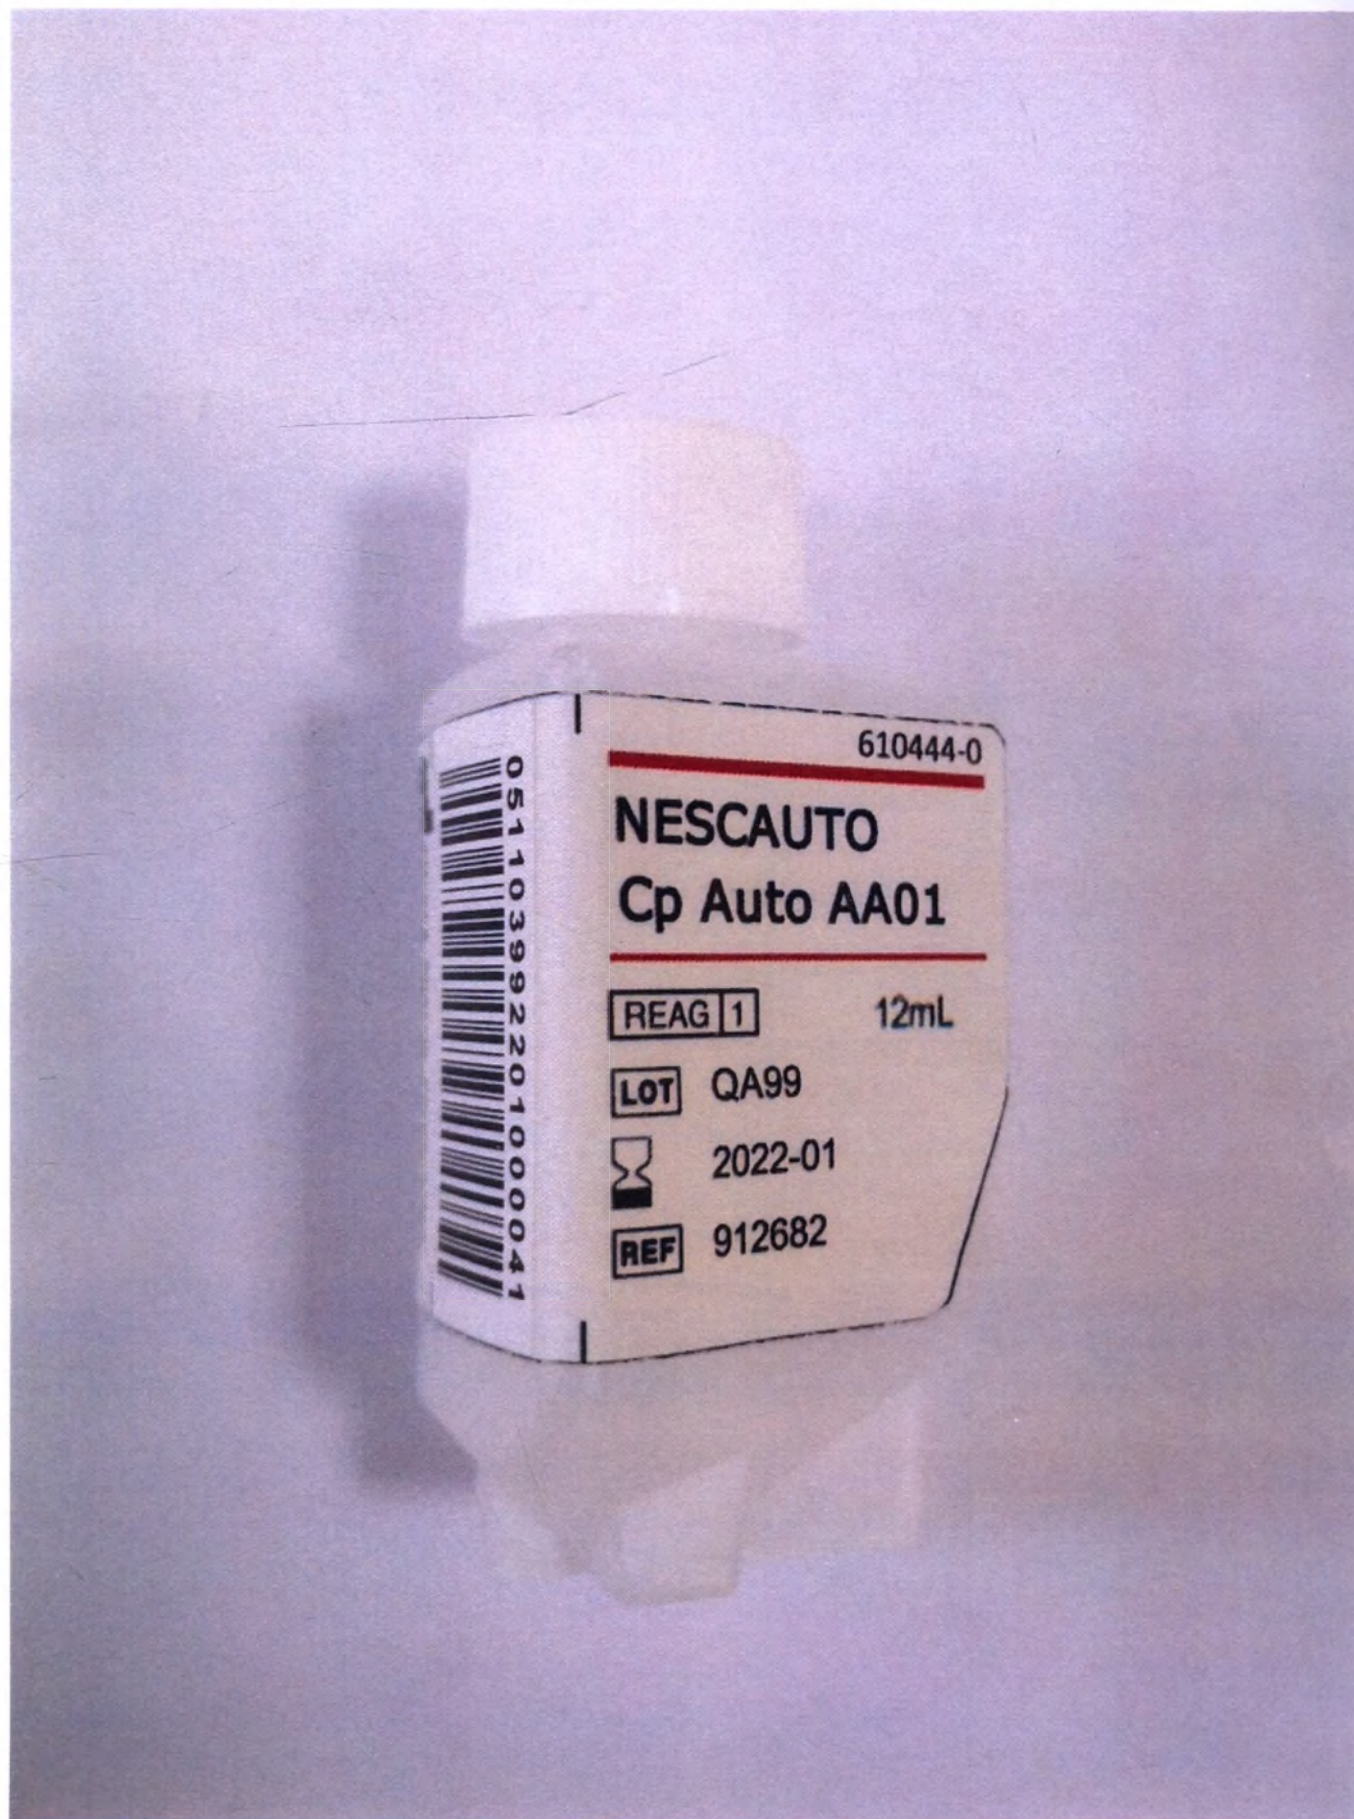


Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения кальпротектина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – NESCAUTO Cp Auto AA01 – Фотография 7

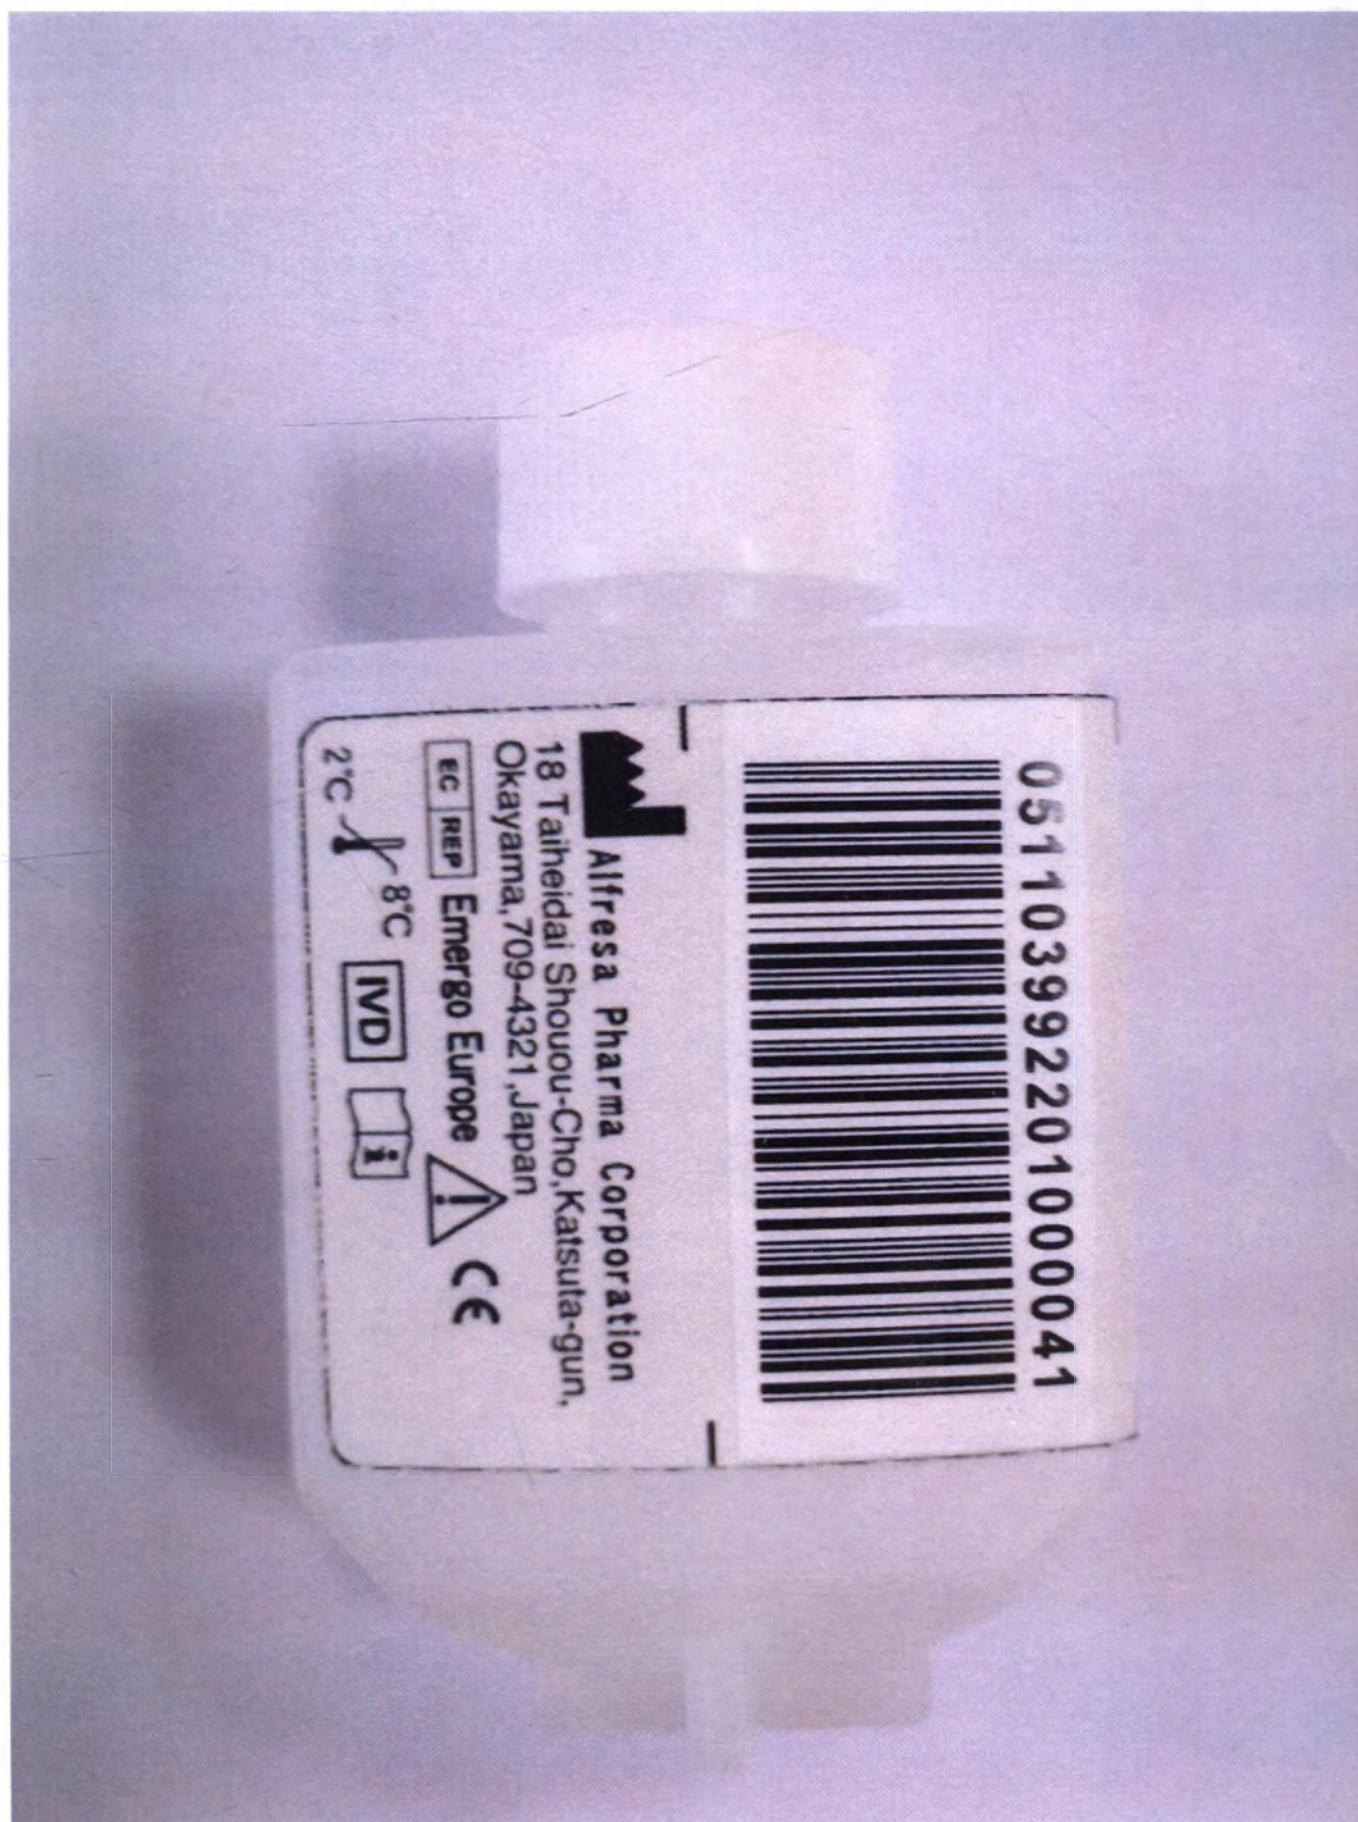

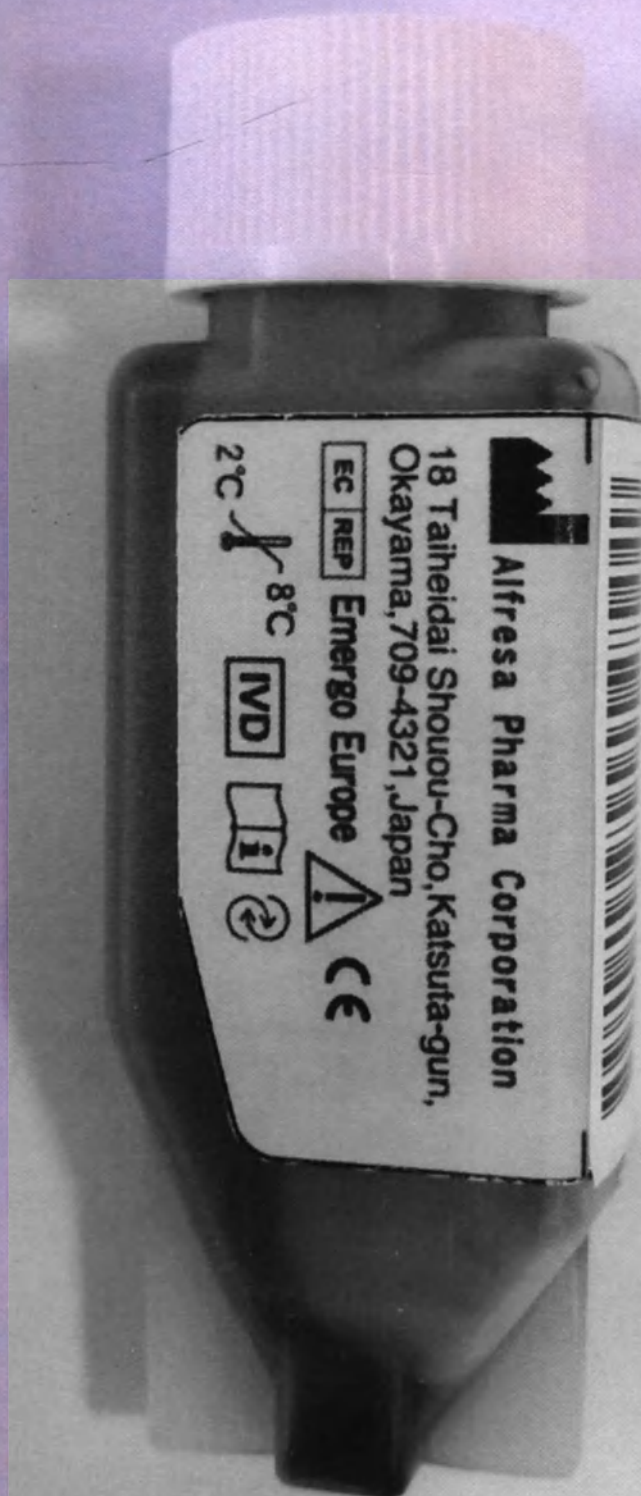

Набор реагентов in vitro для автоматического количественного определения кальпротектина в кале в упаковке для анализаторов NS-Prime AA01 – NESCAUTO Cp Auto AA01 – Фотография 9

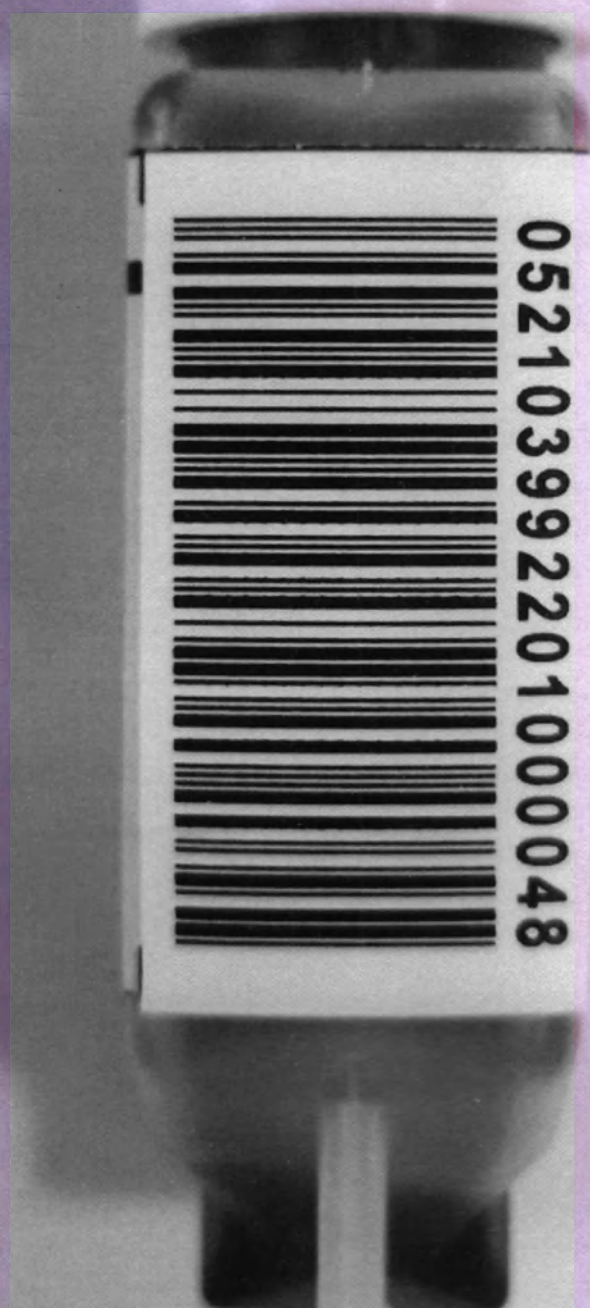

Прошито и пронумеровано

10 (десять)

листа(ов)

Генеральный директор

ООО «АГРОС-ИНТЕРНЕЙШНЛ»

Коновалов С.А.

