


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ООО «Мед ТеКо»


А.В.Беньков

« 08 » 12 2020 г.




**Фотографические изображения общего вида медицинского
изделия**

**Стерилизатора плазменного универсального «Пластер-50-Мед
ТеКо» по ТУ 9451-022-56812193-2009**

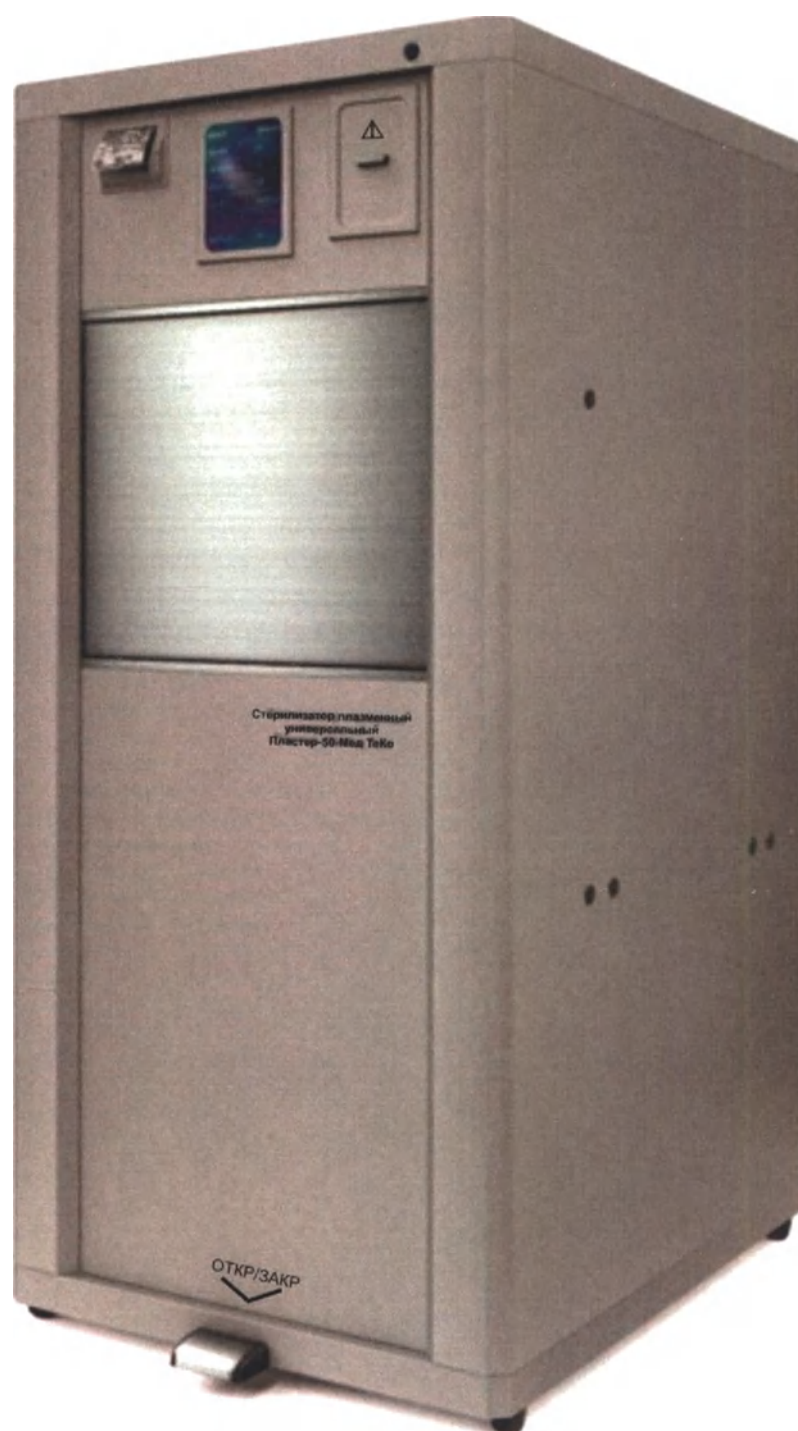

Общий вид стерилизатора (Дверь камеры закрыта)

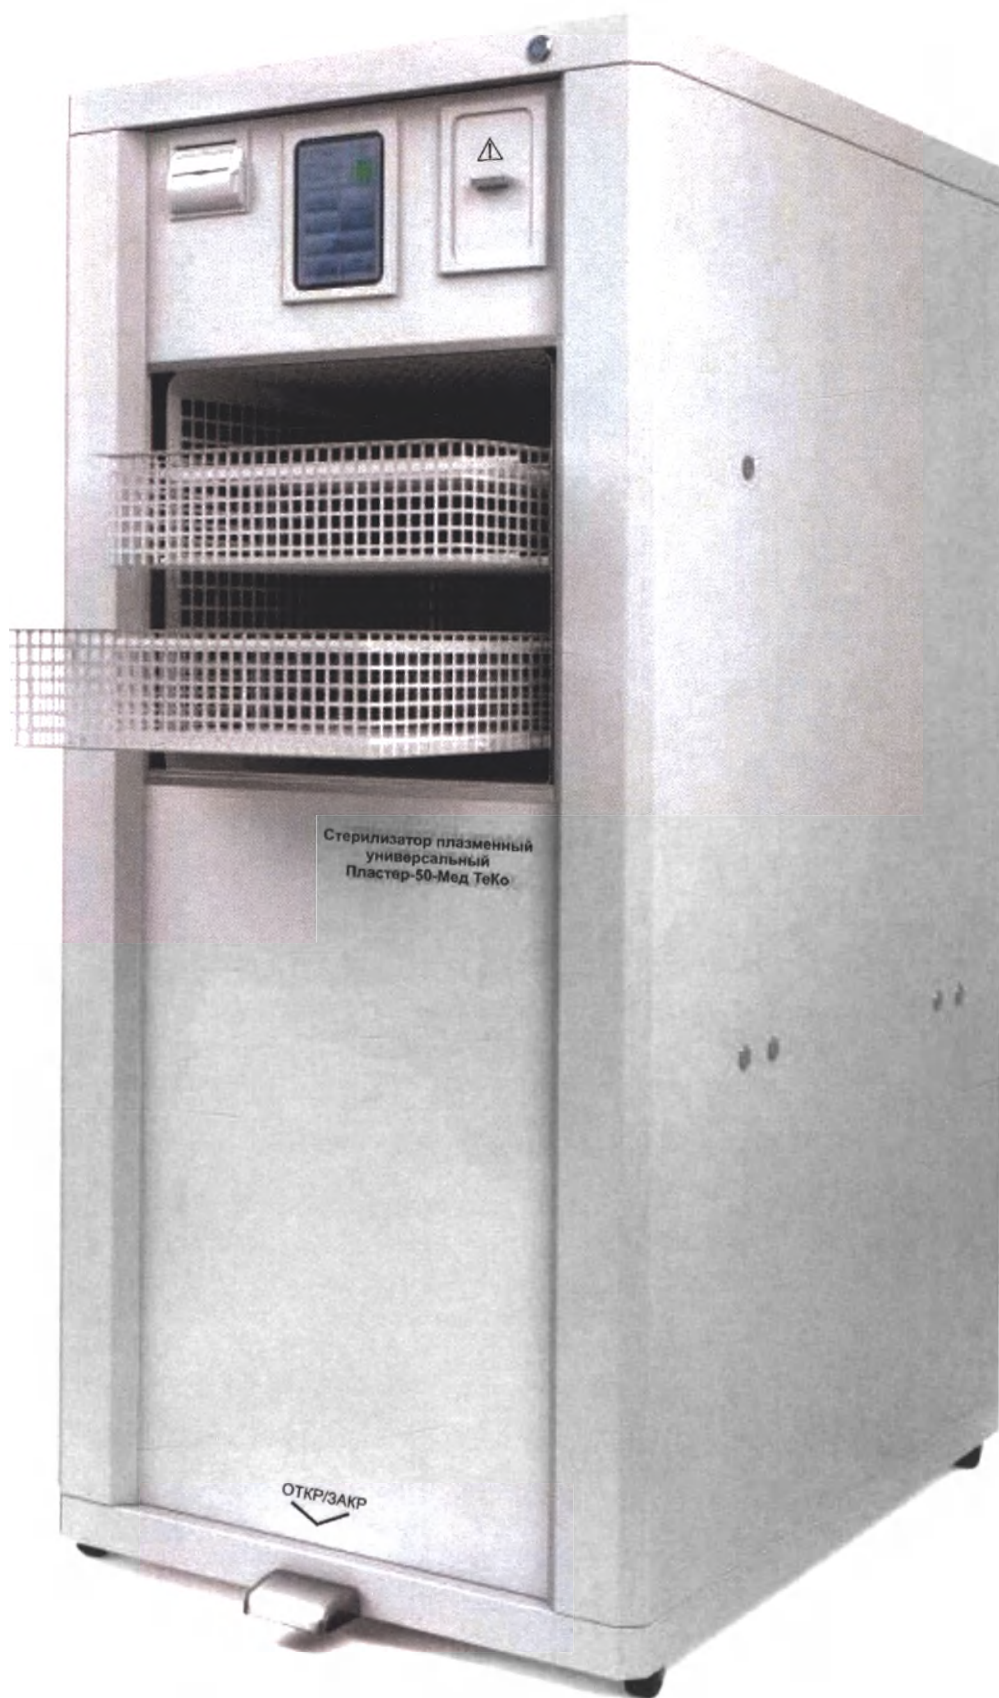

Общий вид стерилизатора (Дверь камеры открыта)


Расходные материалы




Средство стерилизующее «СТ-60-Мед ТеКо», для пероксидно-плазменных стерилизаторов



Индикатор автономный биологический одноразовый для контроля стерилизации парами пероксида водорода (плазменной стерилизации) «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА-ВИНАР»

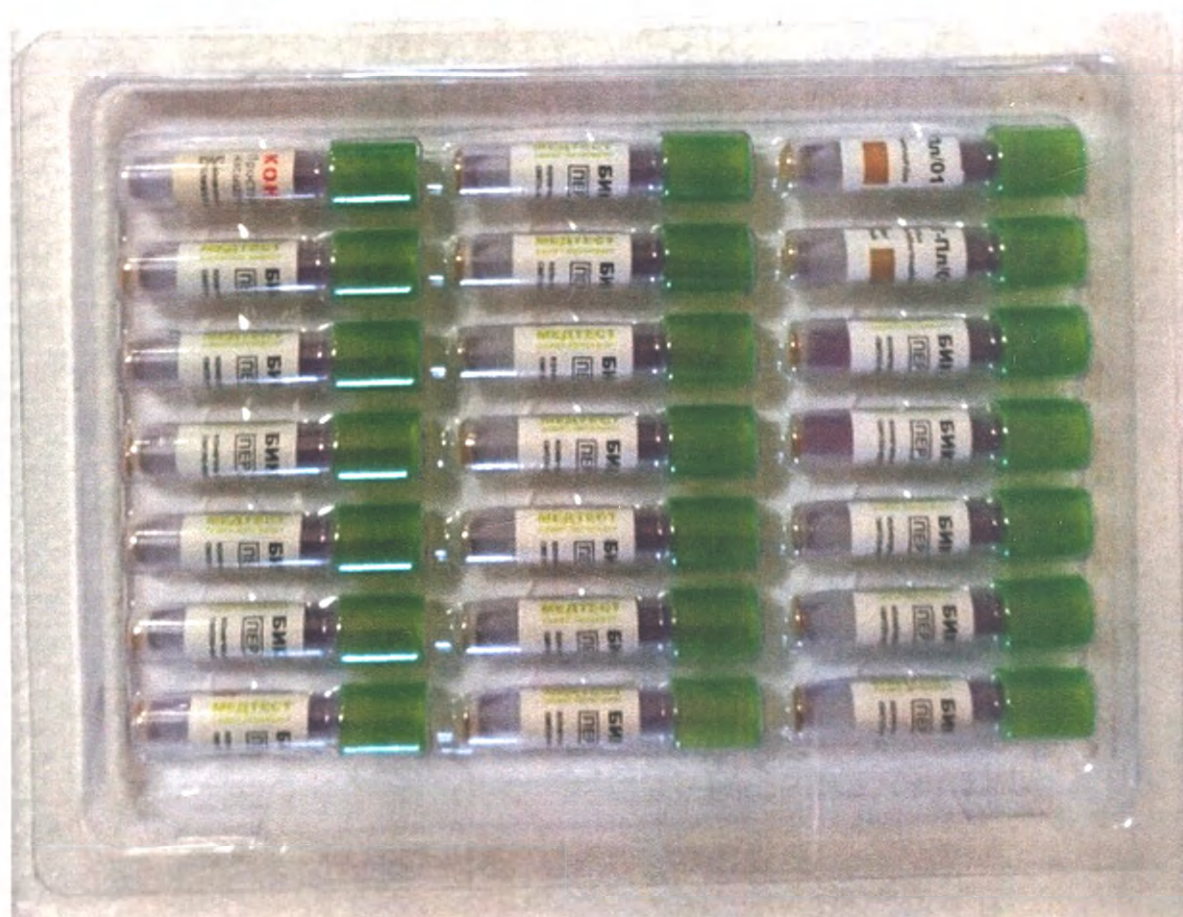

Индикатор биологический одноразового применения для контроля процессов плазменной (пероксидной) стерилизации БИКСт-Пл/01-«Медтест»

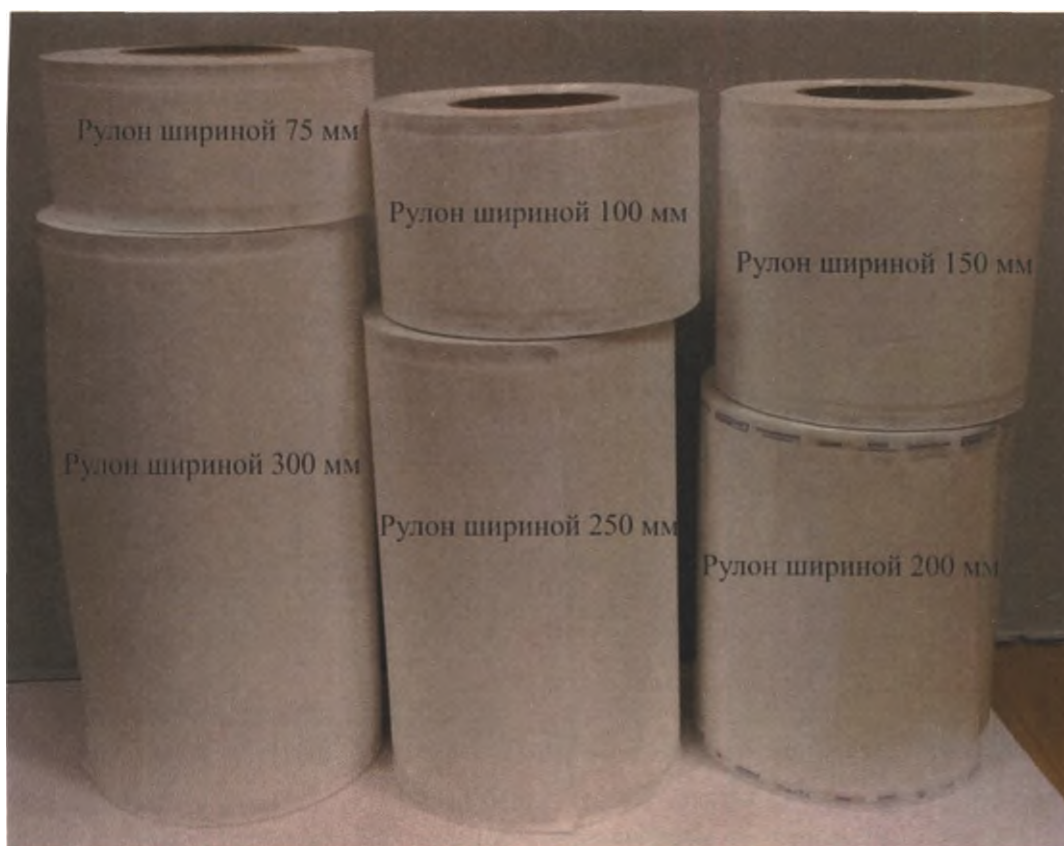

Материал упаковочный

Пакеты и рулоны «Клинипак» для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации



Материал упаковочный

Рулоны Тайвек (Tyvek) для плазменной стерилизации производство Sogeva S.p.l. Италия
ширина (мм): 75; 100; 150; 200; 250; 300

Химические индикаторы



Индикатор химический одноразового применения для контроля параметров режимов газовой стерилизации в атмосфере плазмы пероксида водорода
ИКПлСт-"Медтест"(класс 4 – многопеременный)




Индикатор стерилизации парами перекиси водорода химический одноразовый
многорежимный класса 5 «ВИНАР-ПЛАЗМА-5Класс»



Чековая лента из термобумаги 80x12x50


Комплект для обслуживания стерилизатора

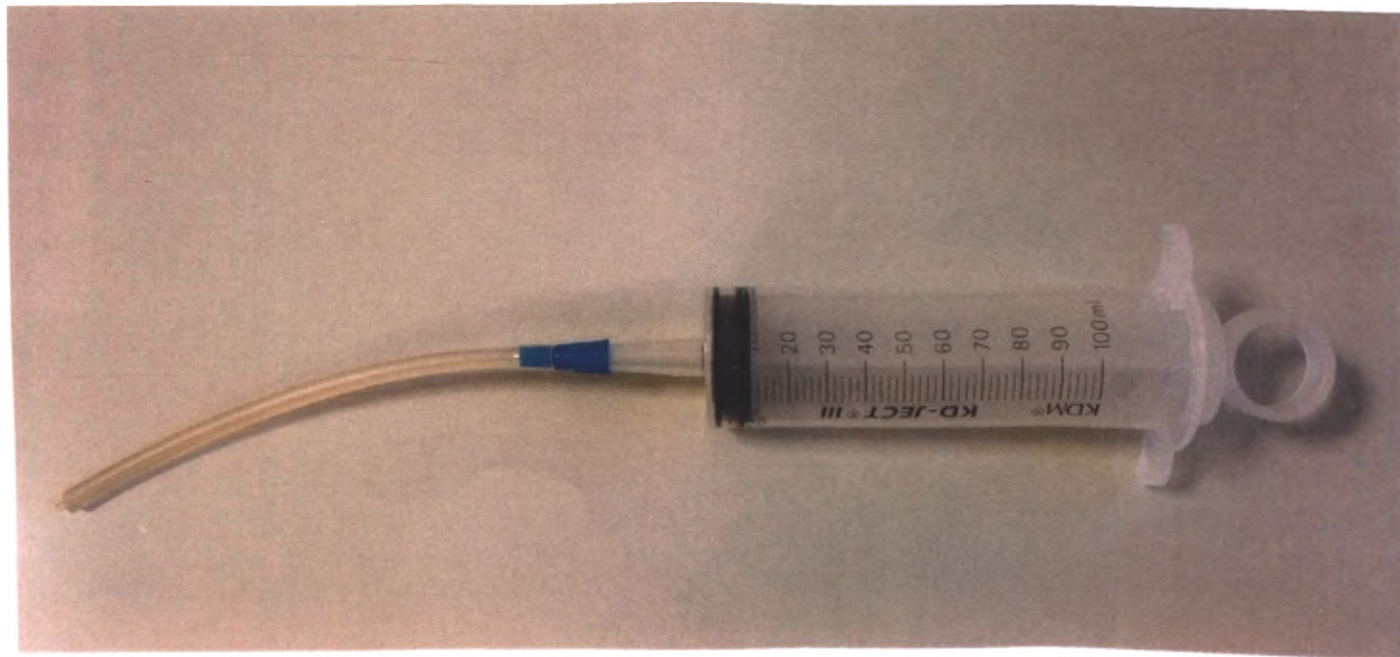

Устройство для удаления стерилизующего средства



Очки защитные

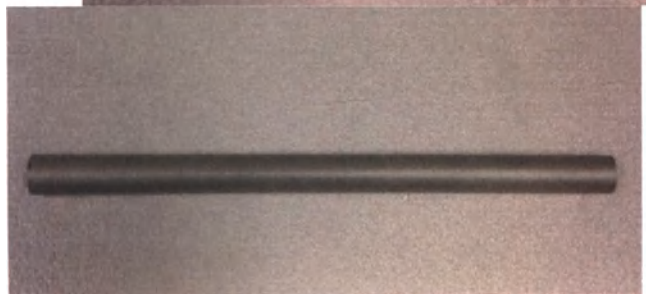

Захваты – 1 комп.



Пронито и пронумеровано

10 декабря лист(ов)