

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Асептические медицинские системы»


Гуськов Н.Г.
«3» августа 2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Светильник хирургический LED-AMS с принадлежностями
по ТУ 32.50.50-024-21504087-2020

Светильник хирургический LED-AMS 2-160/100



Светильник хирургический LED-AMS 2-160/160




Светильник хирургический LED-AMS 2-100/100




Светильник хирургический LED-AMS 1-100




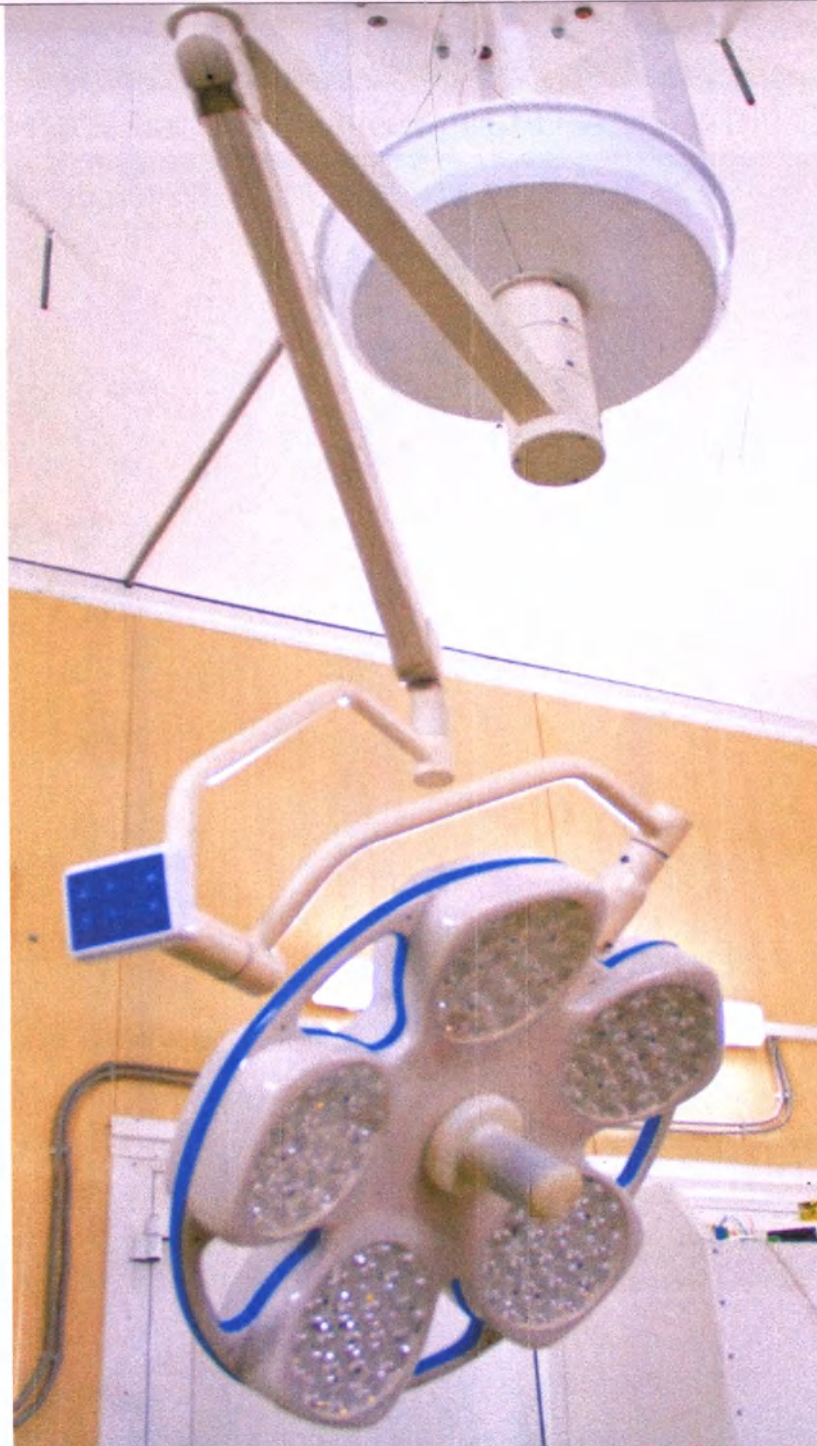

Светильник хирургический LED-AMS 1-100 С

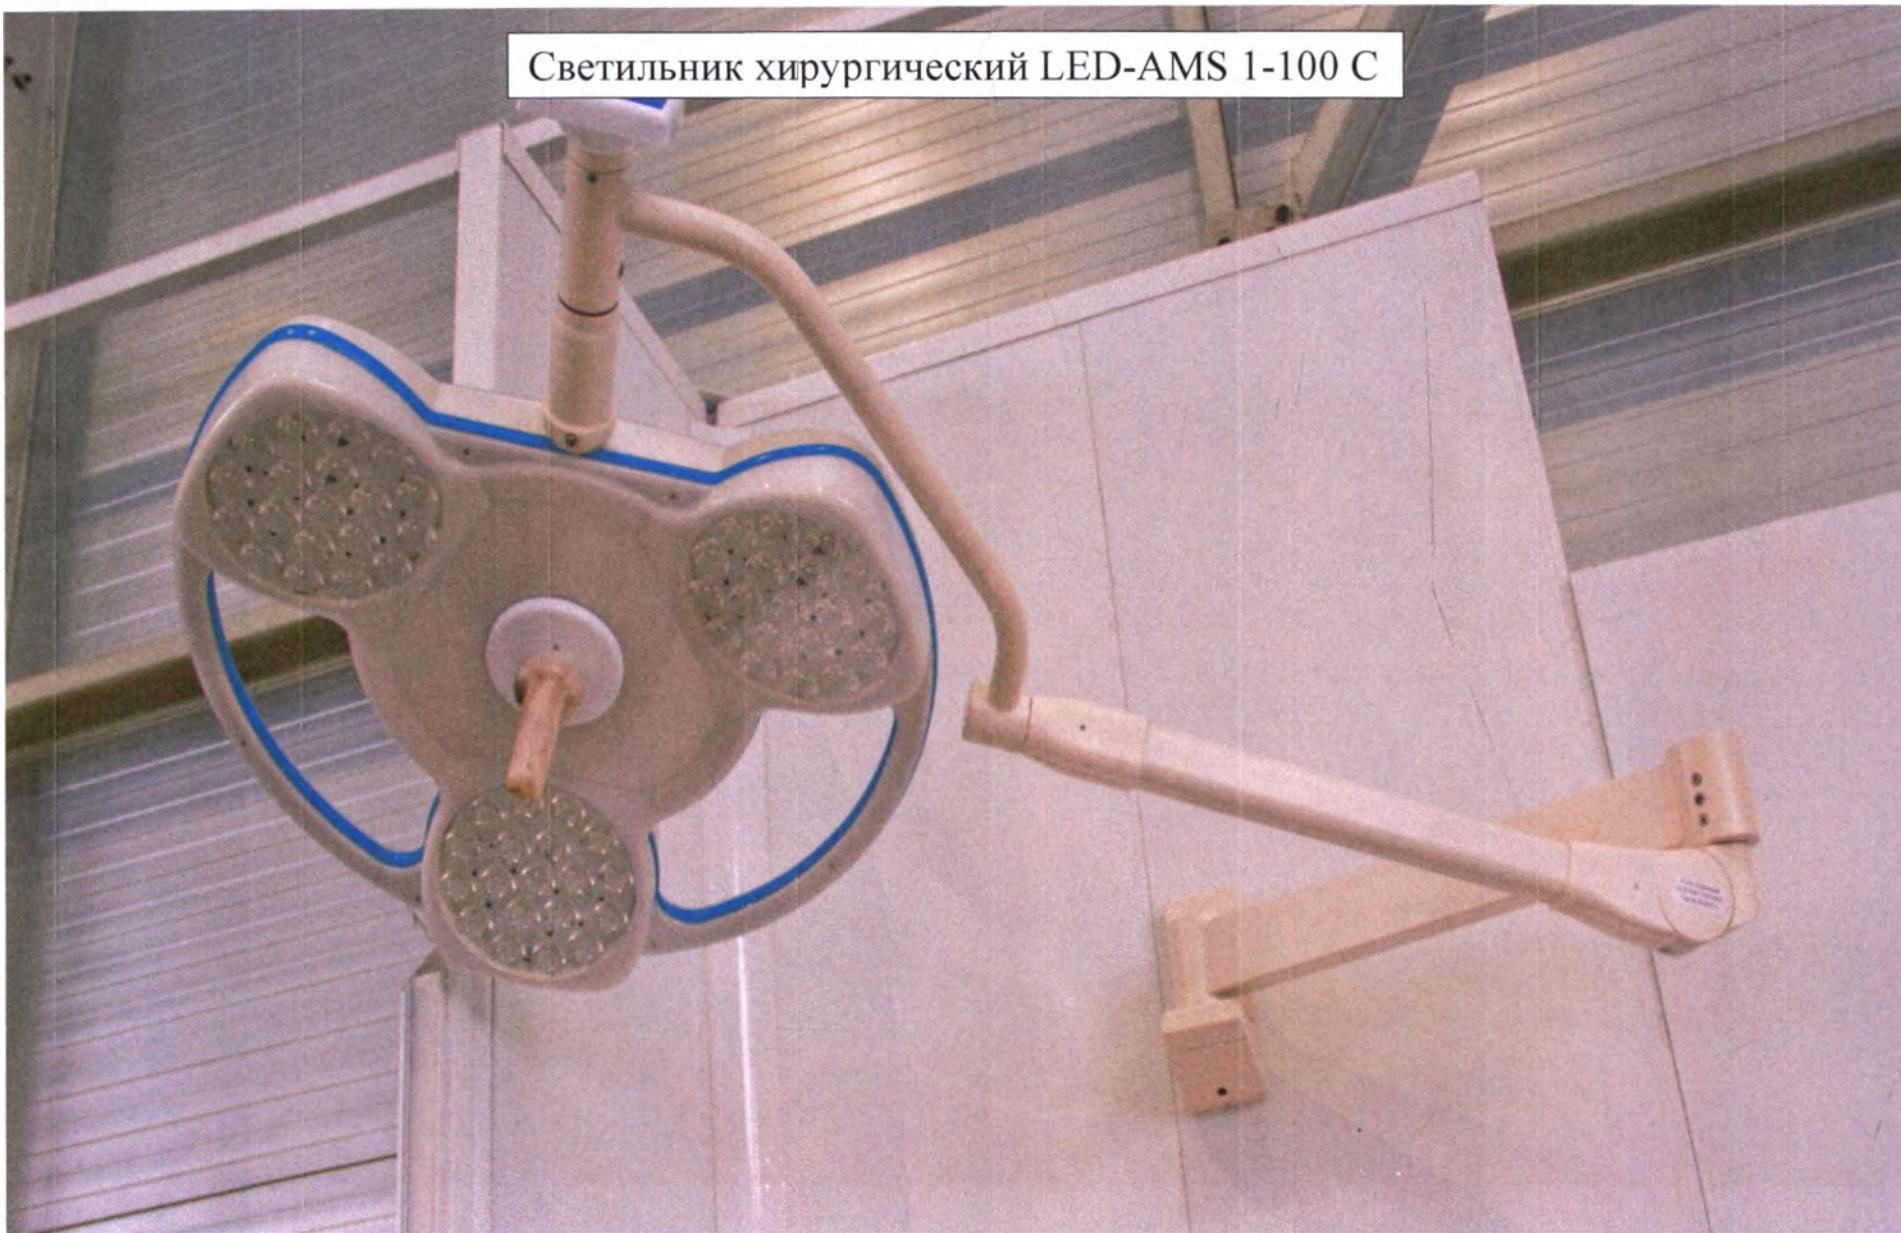

Светильник хирургический LED-AMS 1-160 С

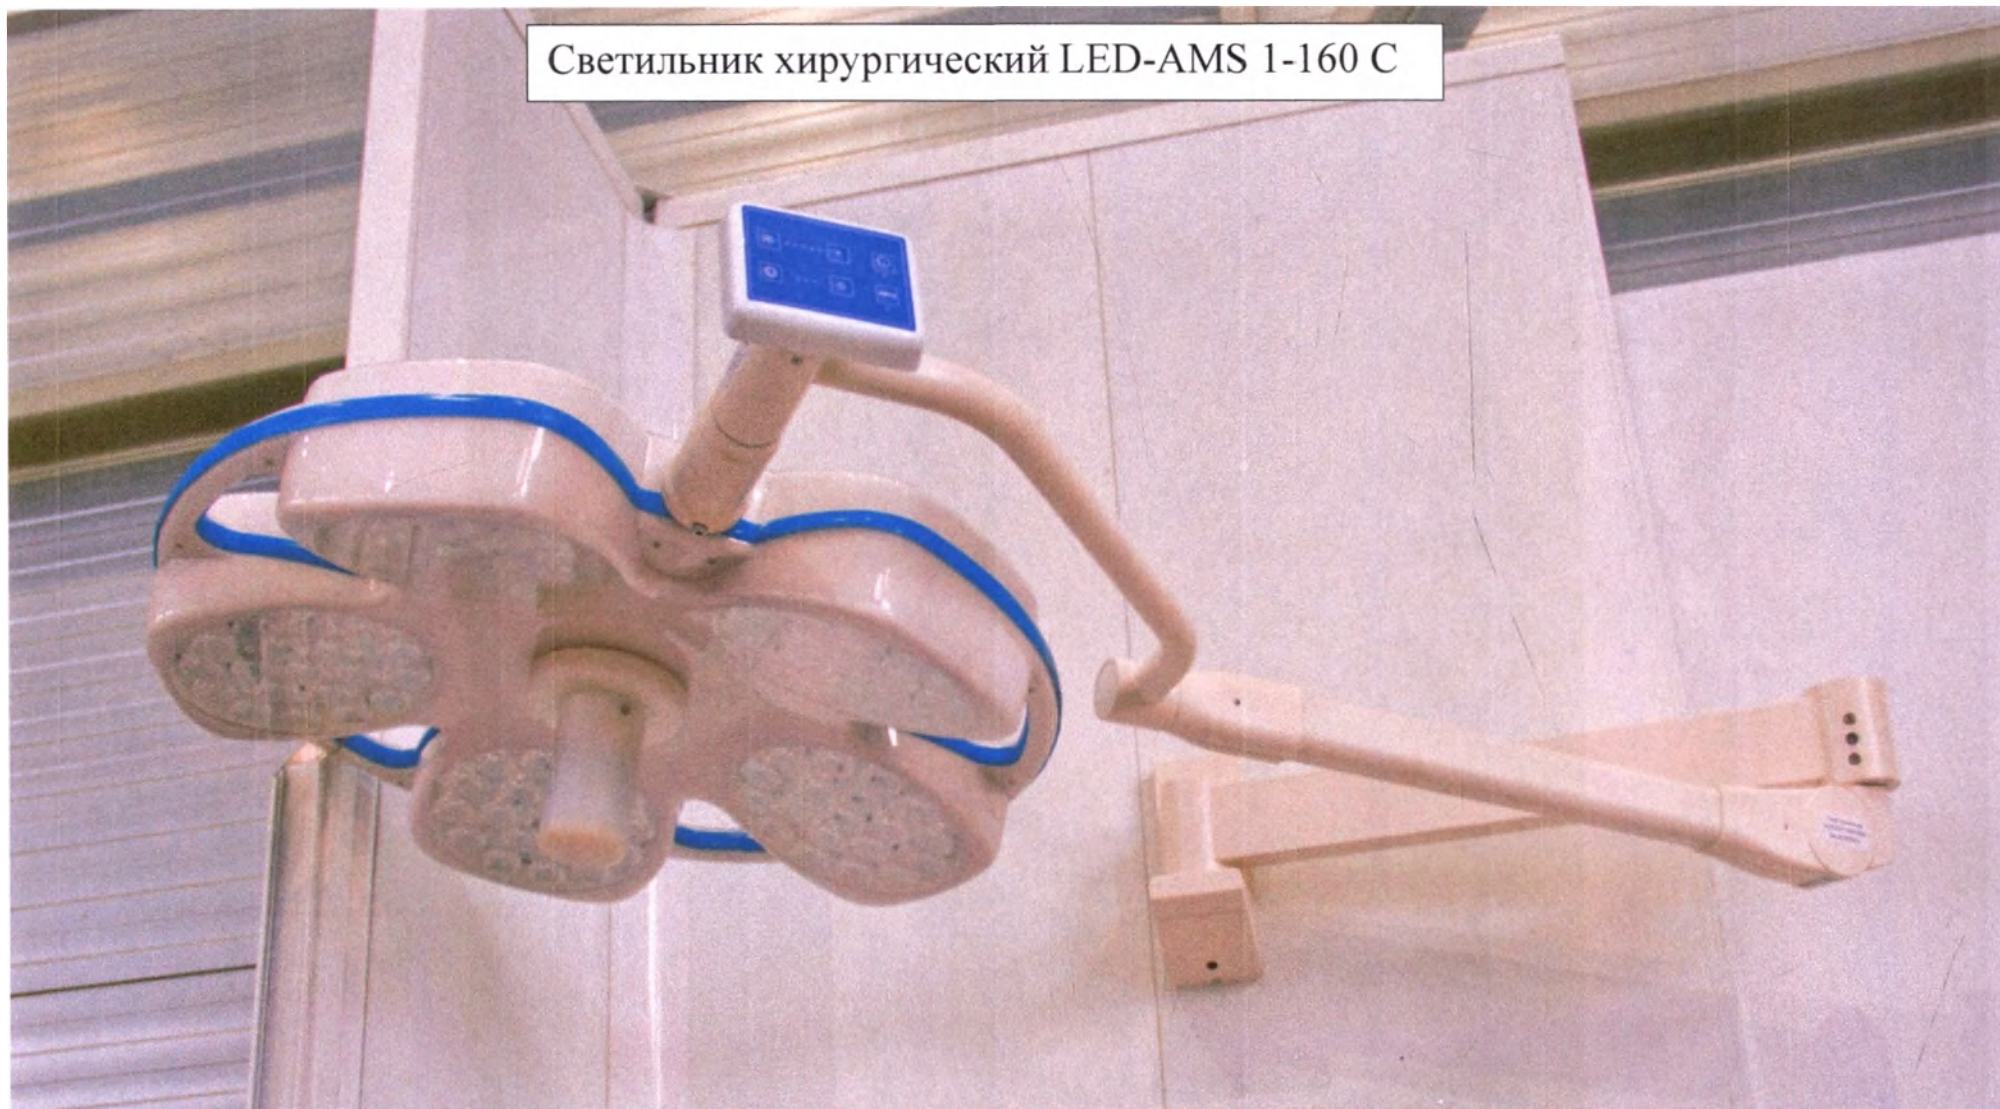

Светильник хирургический LED-AMS 1-100 П



Светильник хирургический LED-AMS 1-160 П




Блок освещения 160.




Блок освещения 100.



Ось центральная L1

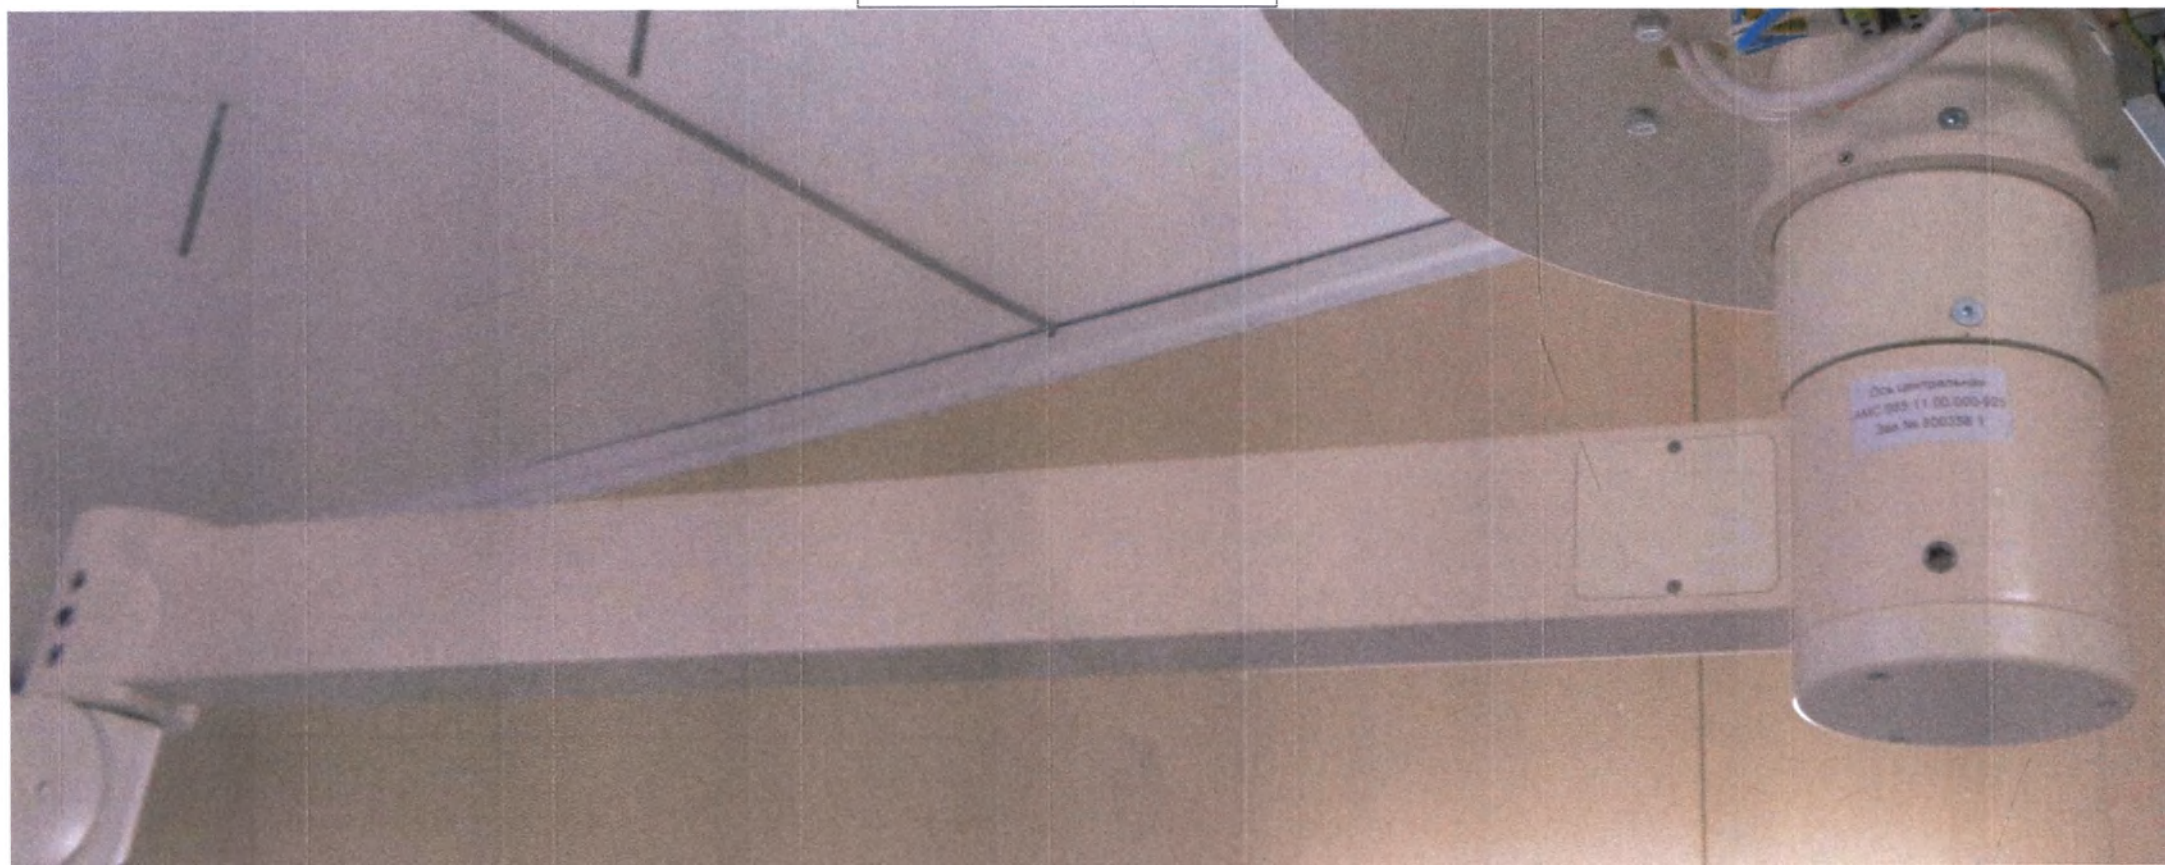

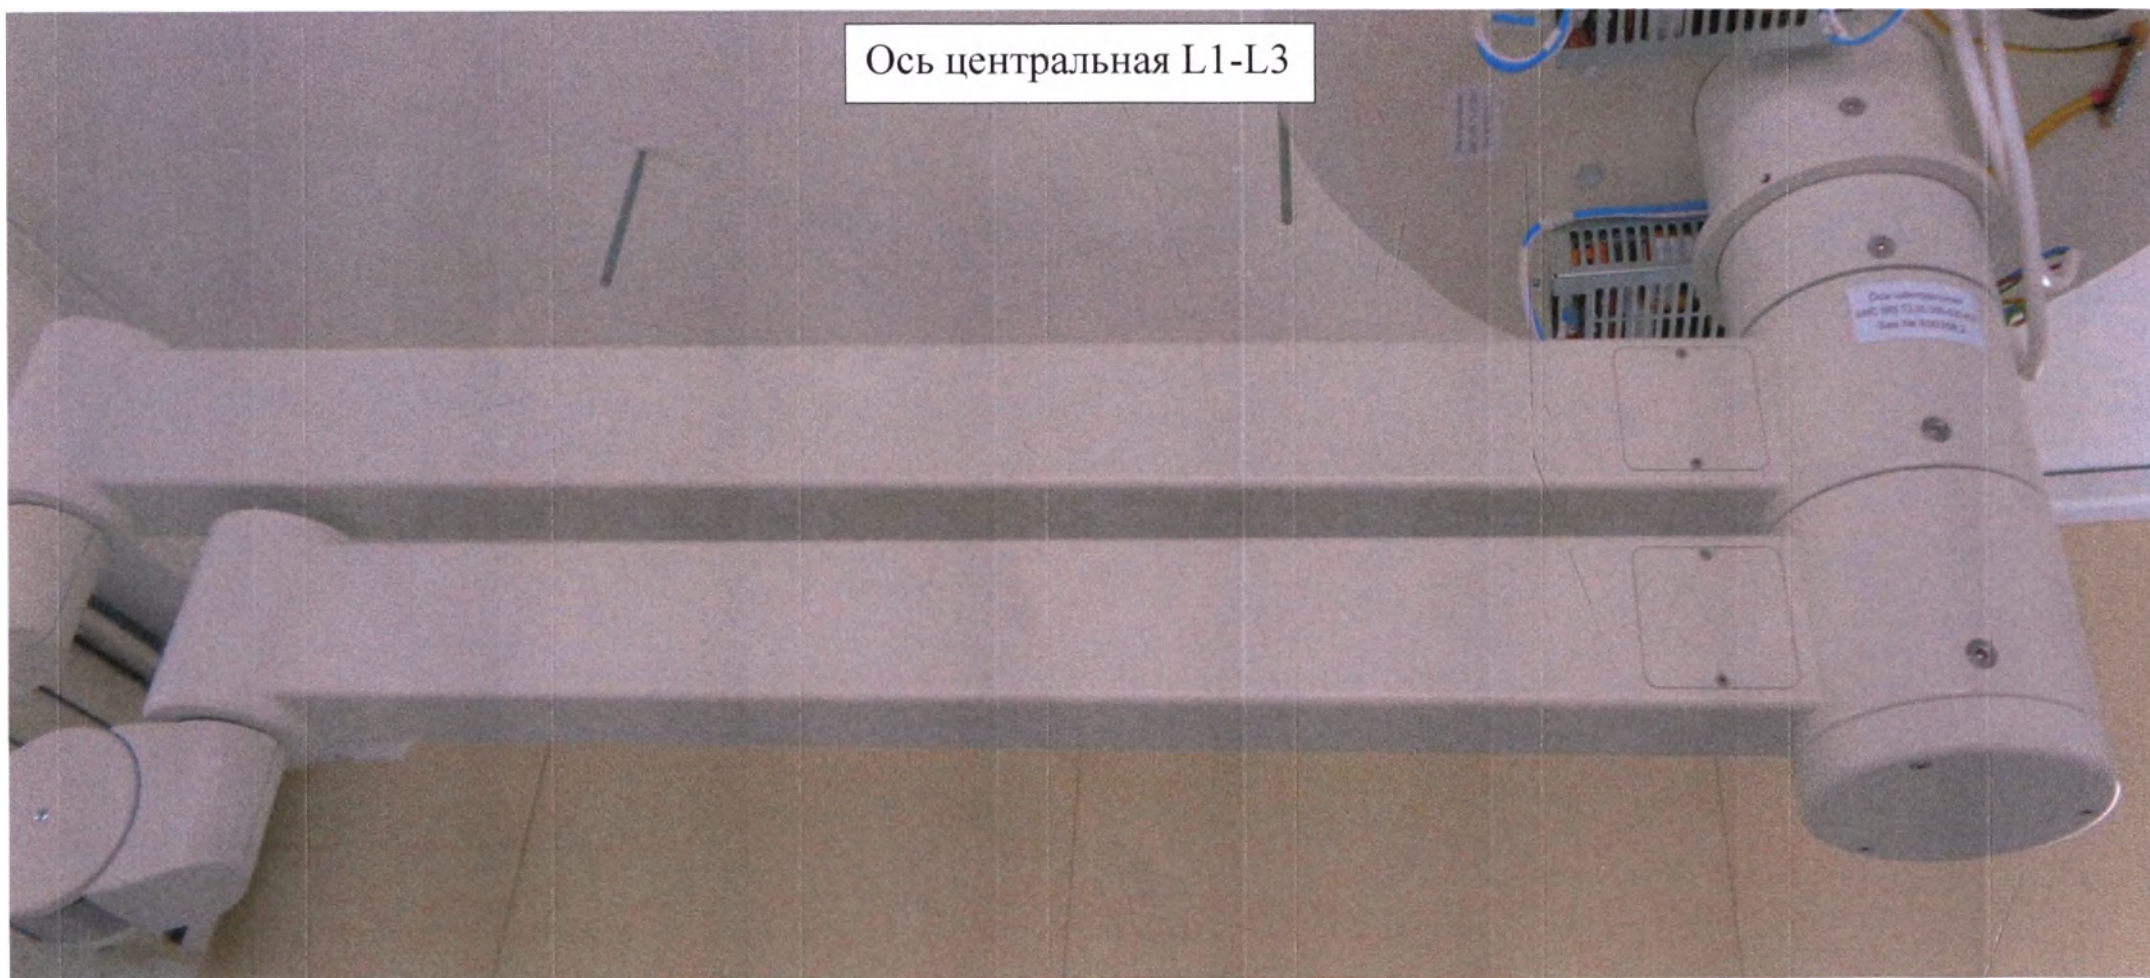

Ось центральная L1-L3

Ось центральная L1-L3-L5



Рычаг пружинный АСРОБАТ 2000




Рычаг пружинный АСРОБАТ 2000 NRH



Рычаг пружинный ACROBAT 3000




Фланец потолочный

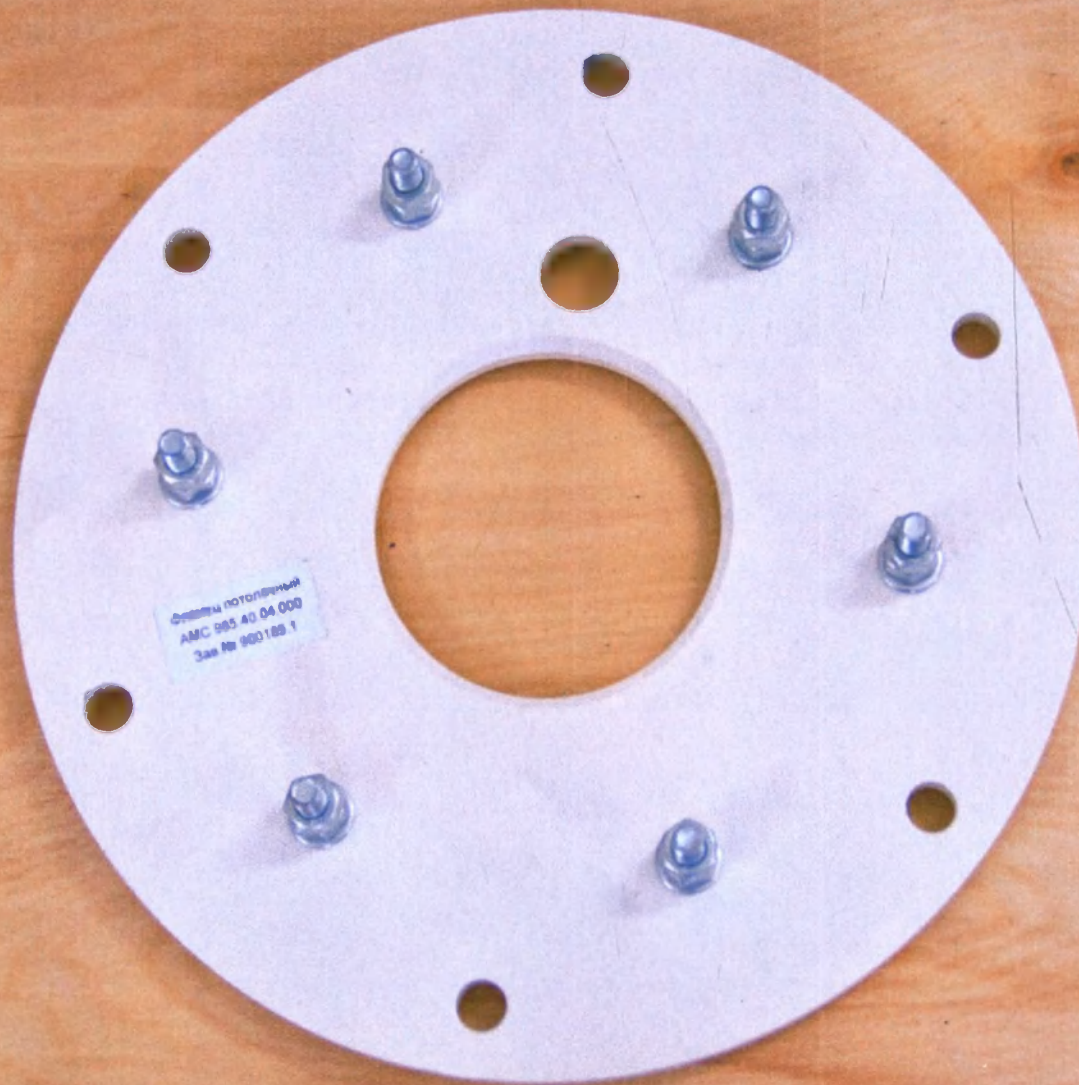

Проставка





Фланец крепежный

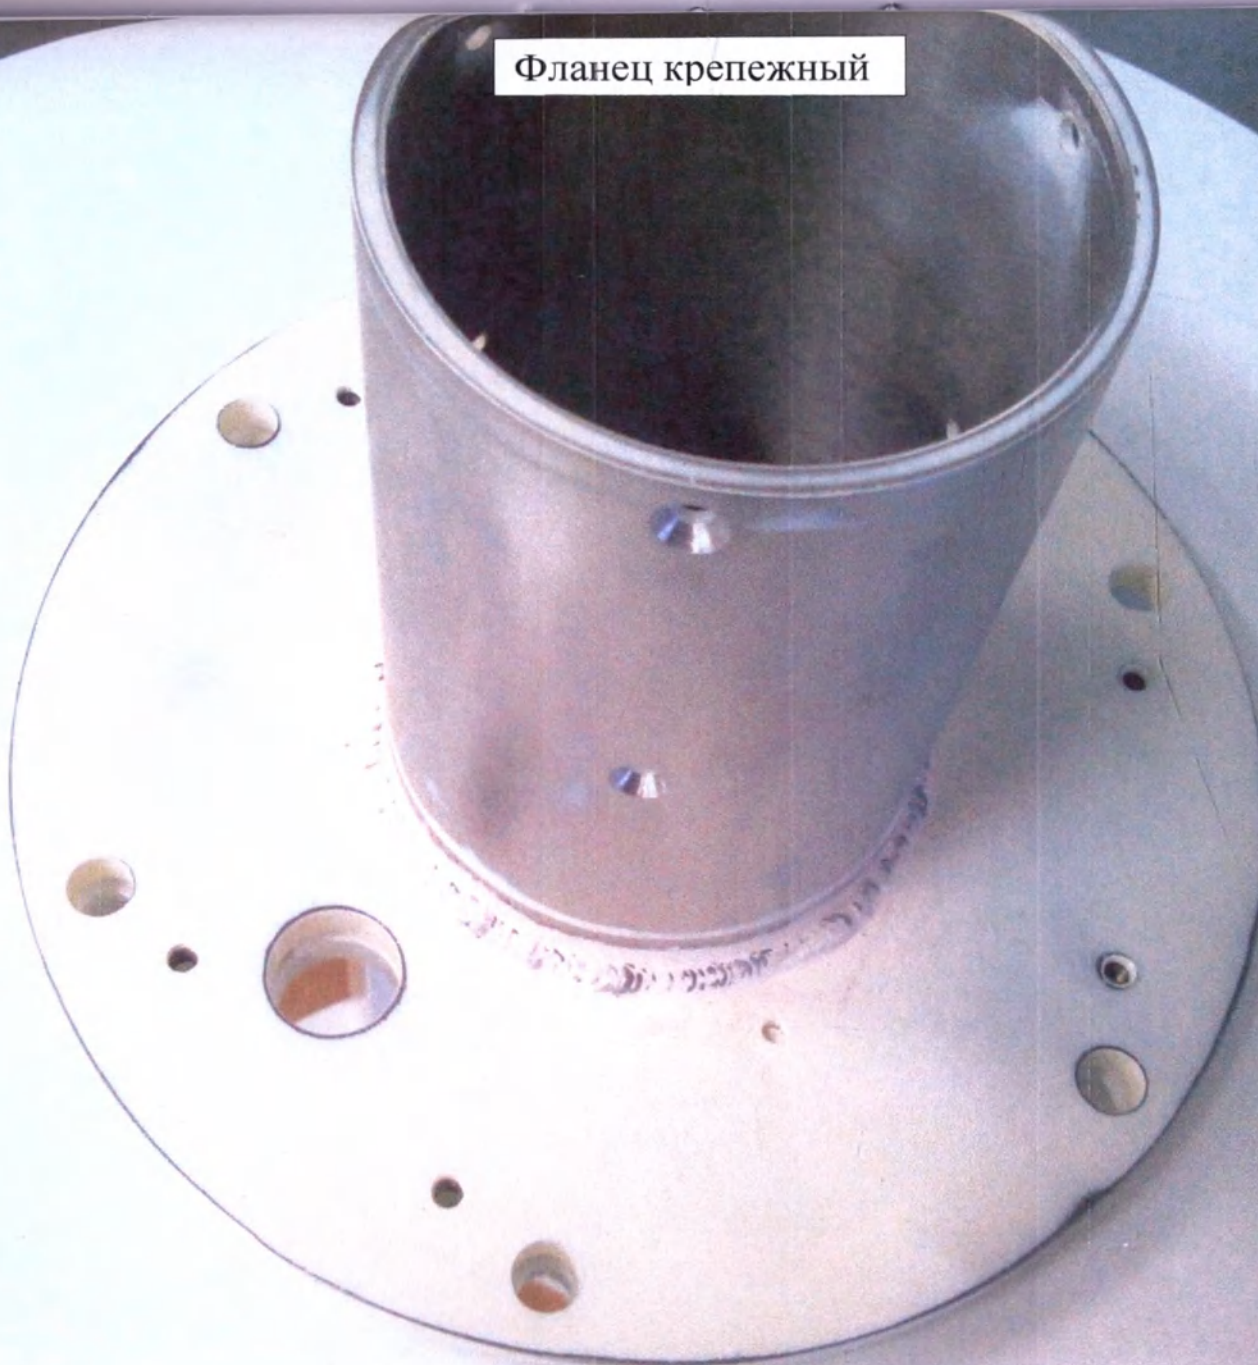

Плита монтажная



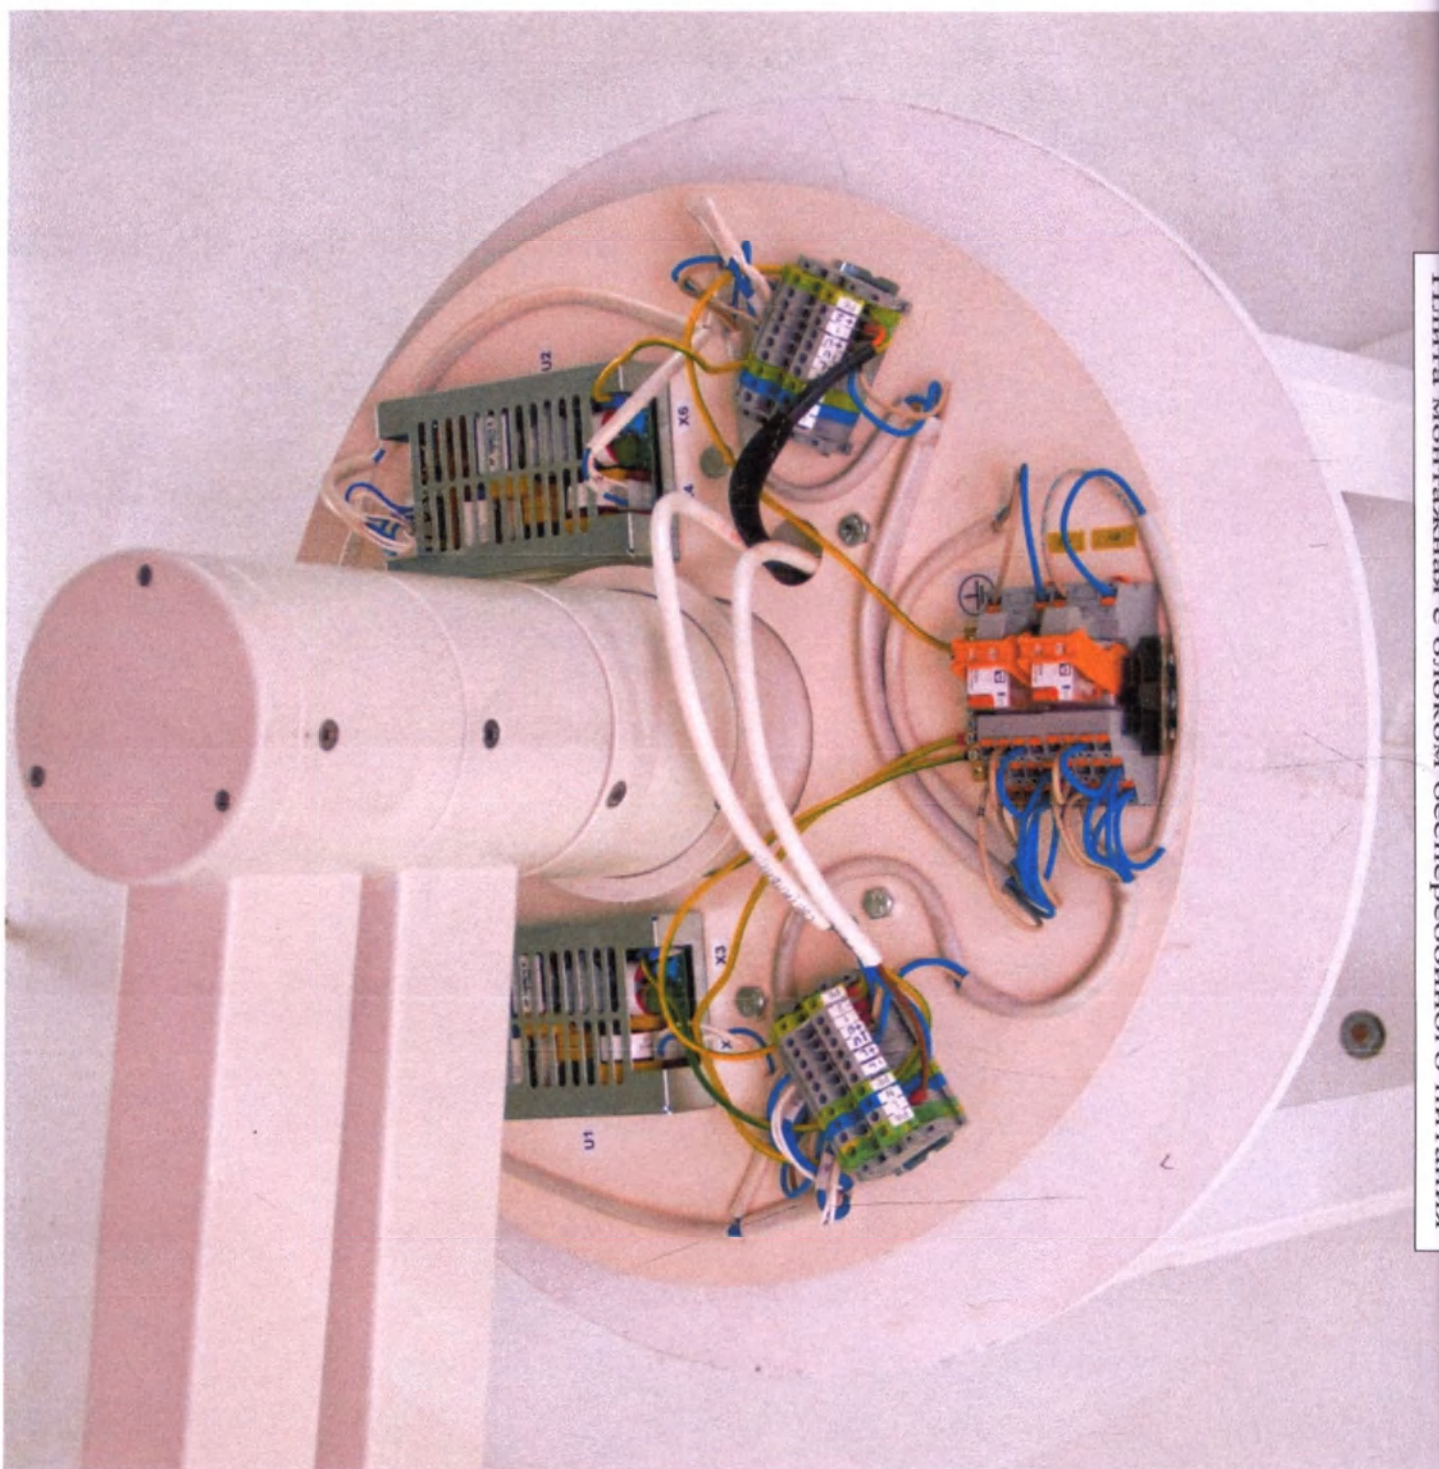

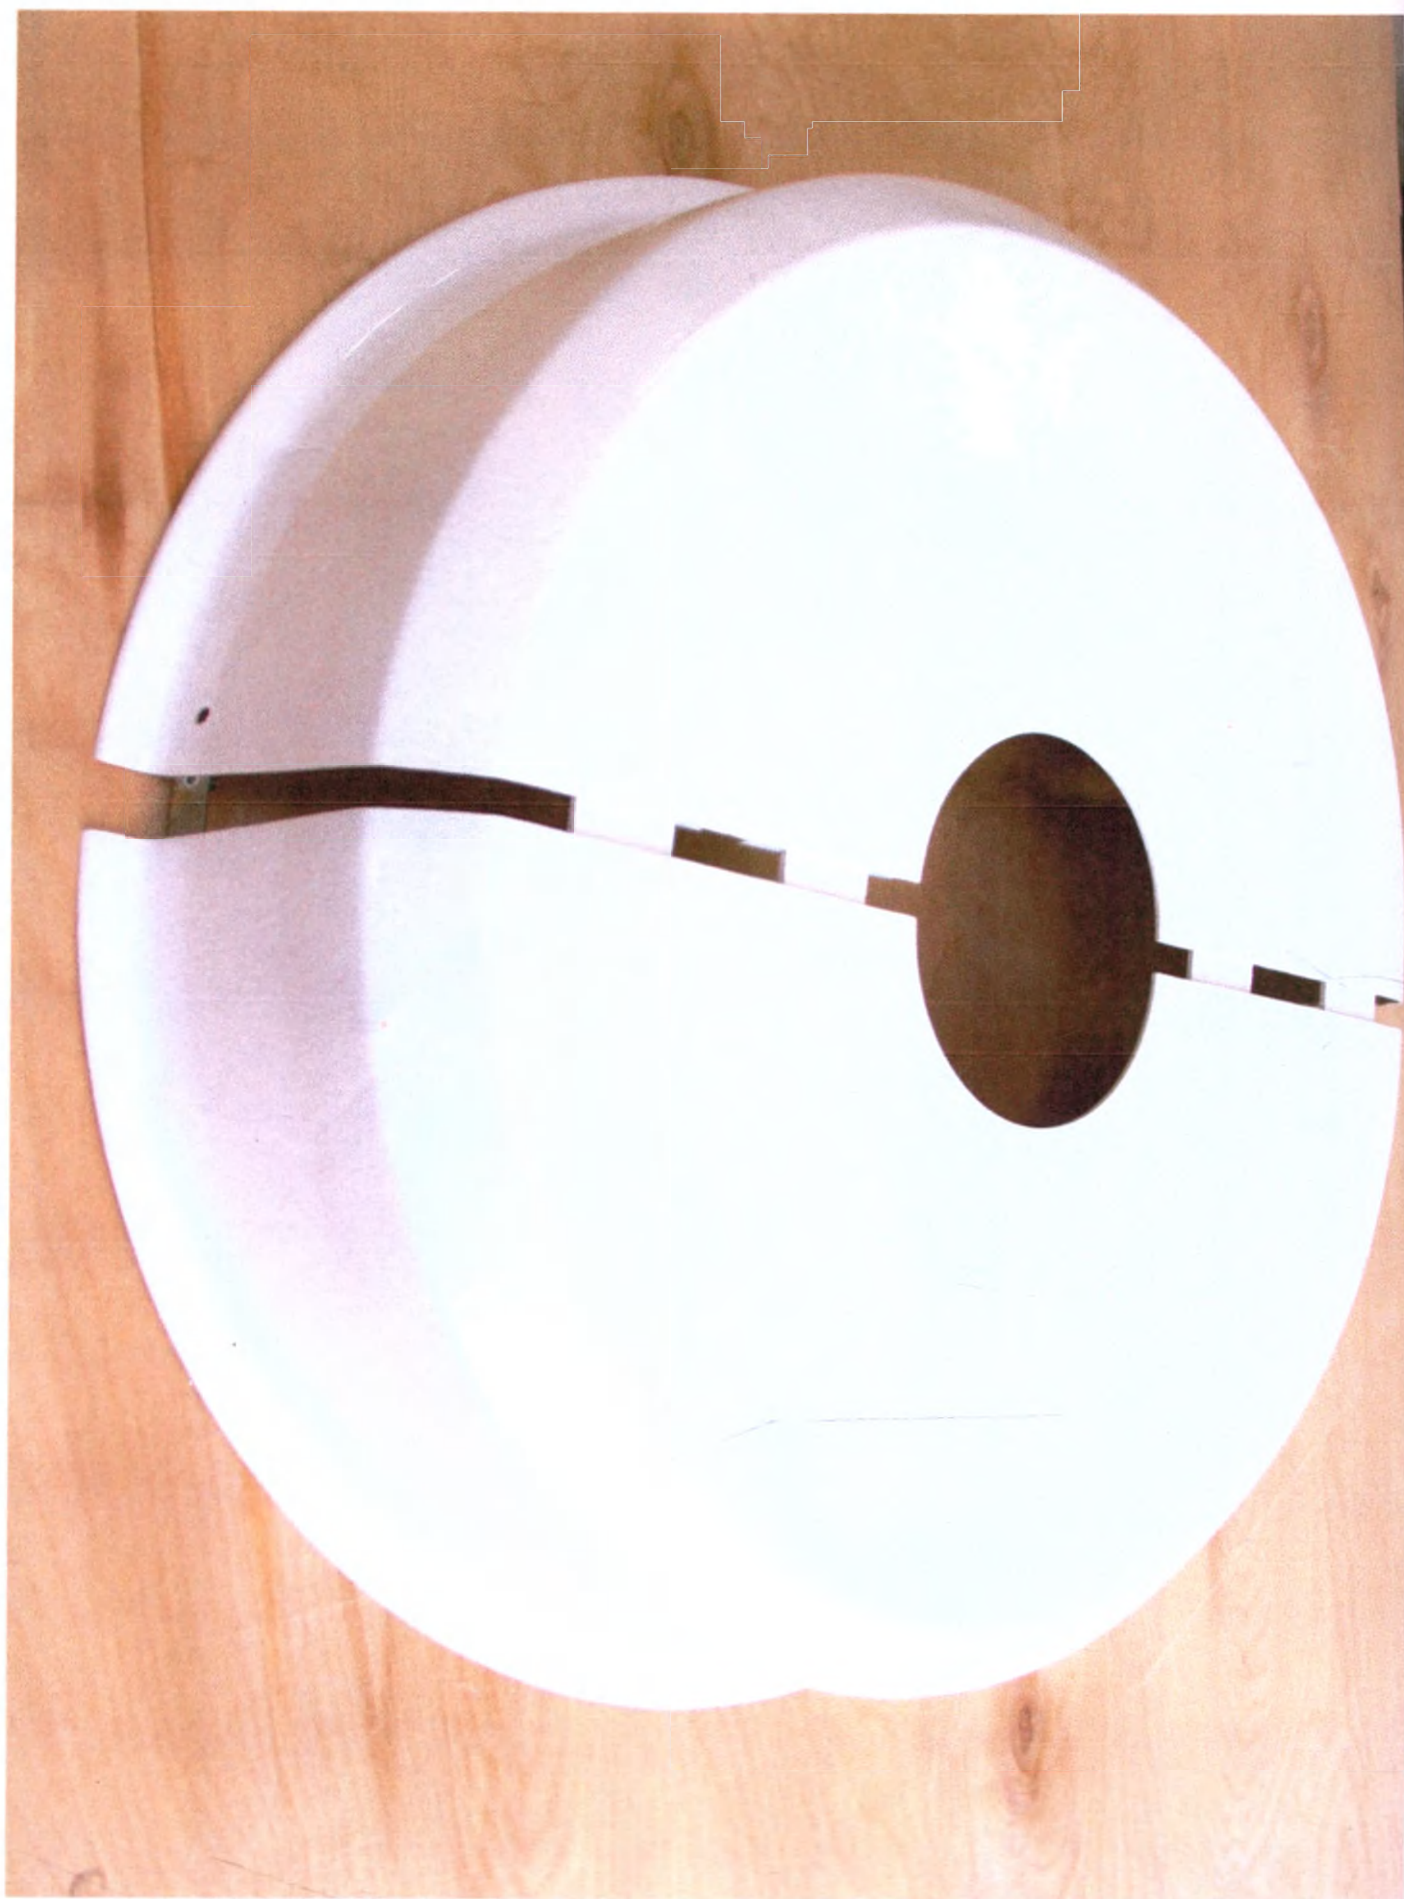


Ручка съемная




Кронштейн видеокамеры



Кронштейн видеомонитора

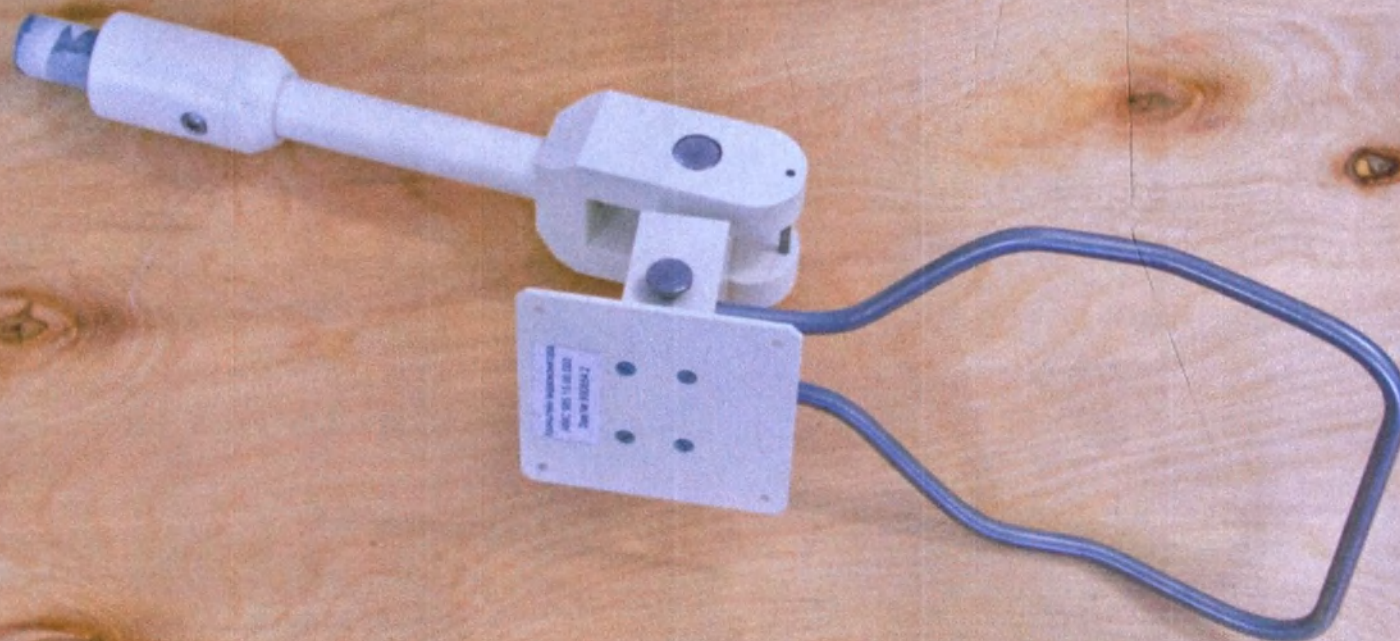

Кронштейн настенный

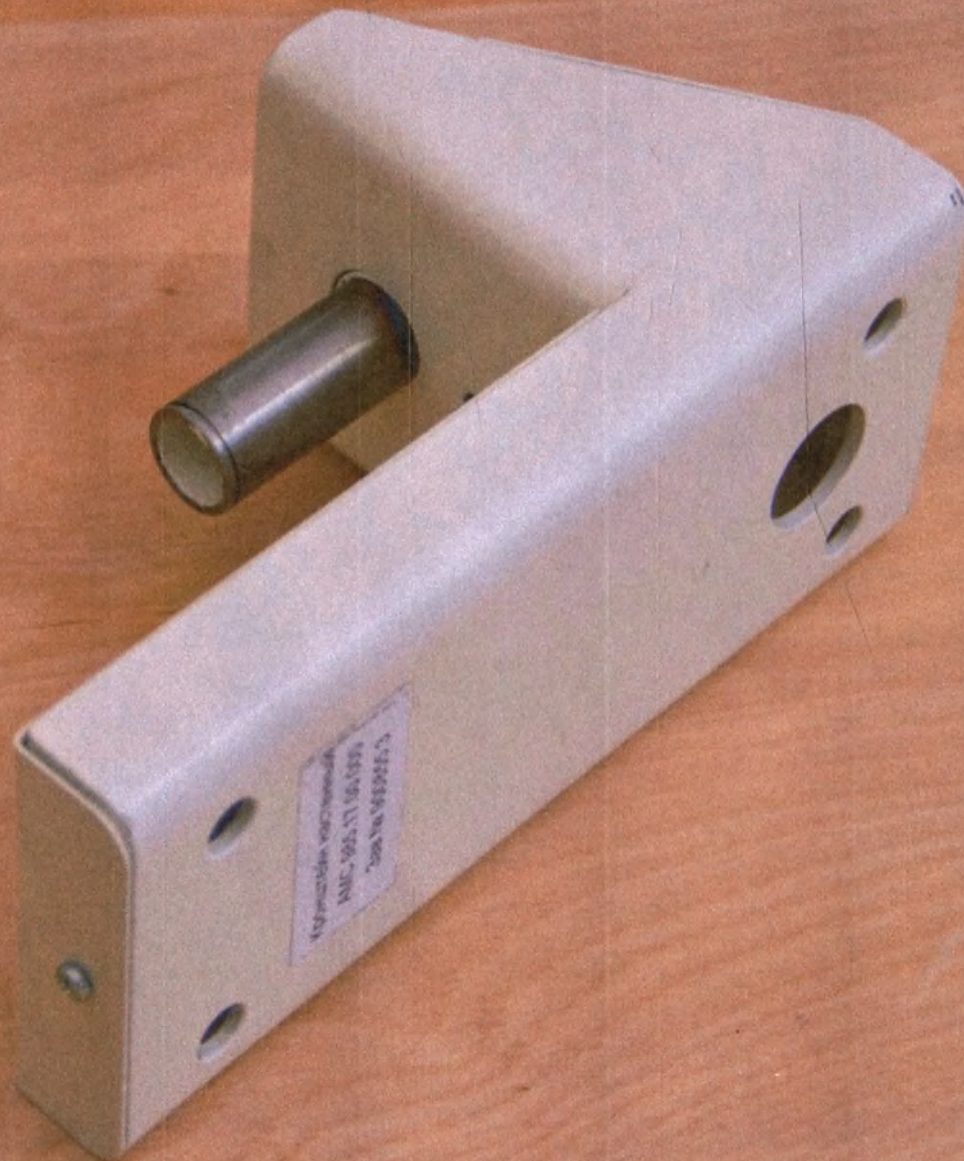

Шкаф аварийного питания

Шкаф аварийного питания
АМС 985.19.00.000
Зав. № 900913.2



TEST







Комплект потолочных крепежных элементов (тяга АМС 3.03.02.100-Л, гайка М16, шайба плоская 16)



Комплект потолочных крепежных элементов (гайка шестигранная М16, шайба плоская 16, гильза сетчатая 22х1М, капсула 70 50 ml, резьбовая шпилька М16х150)



Комплект потолочных крепежных элементов
(анкер забиваемый M16x20x65, болт шестигранная головка M16x70, шайба плоская
16, шайба пружинная 16)



Комплект настенных крепежных элементов (гайка шестигранная M10, шайба плоская M10, гильза сетчатая 16x1M, капсула 70 500ml, резьбовая шпилька M10x115)



Комплект настенных крепежных элементов (анкер забиваемый М10х40, болт шестигранная головка М10х50, шайба плоская 10, шайба пружинная 10)







Светильник хирургический LED-AMS 1-100П зав. № 805500
Пример маркировки



Светильник хирургический LED-AMS 1-100П зав. № 805500
Пример маркировки

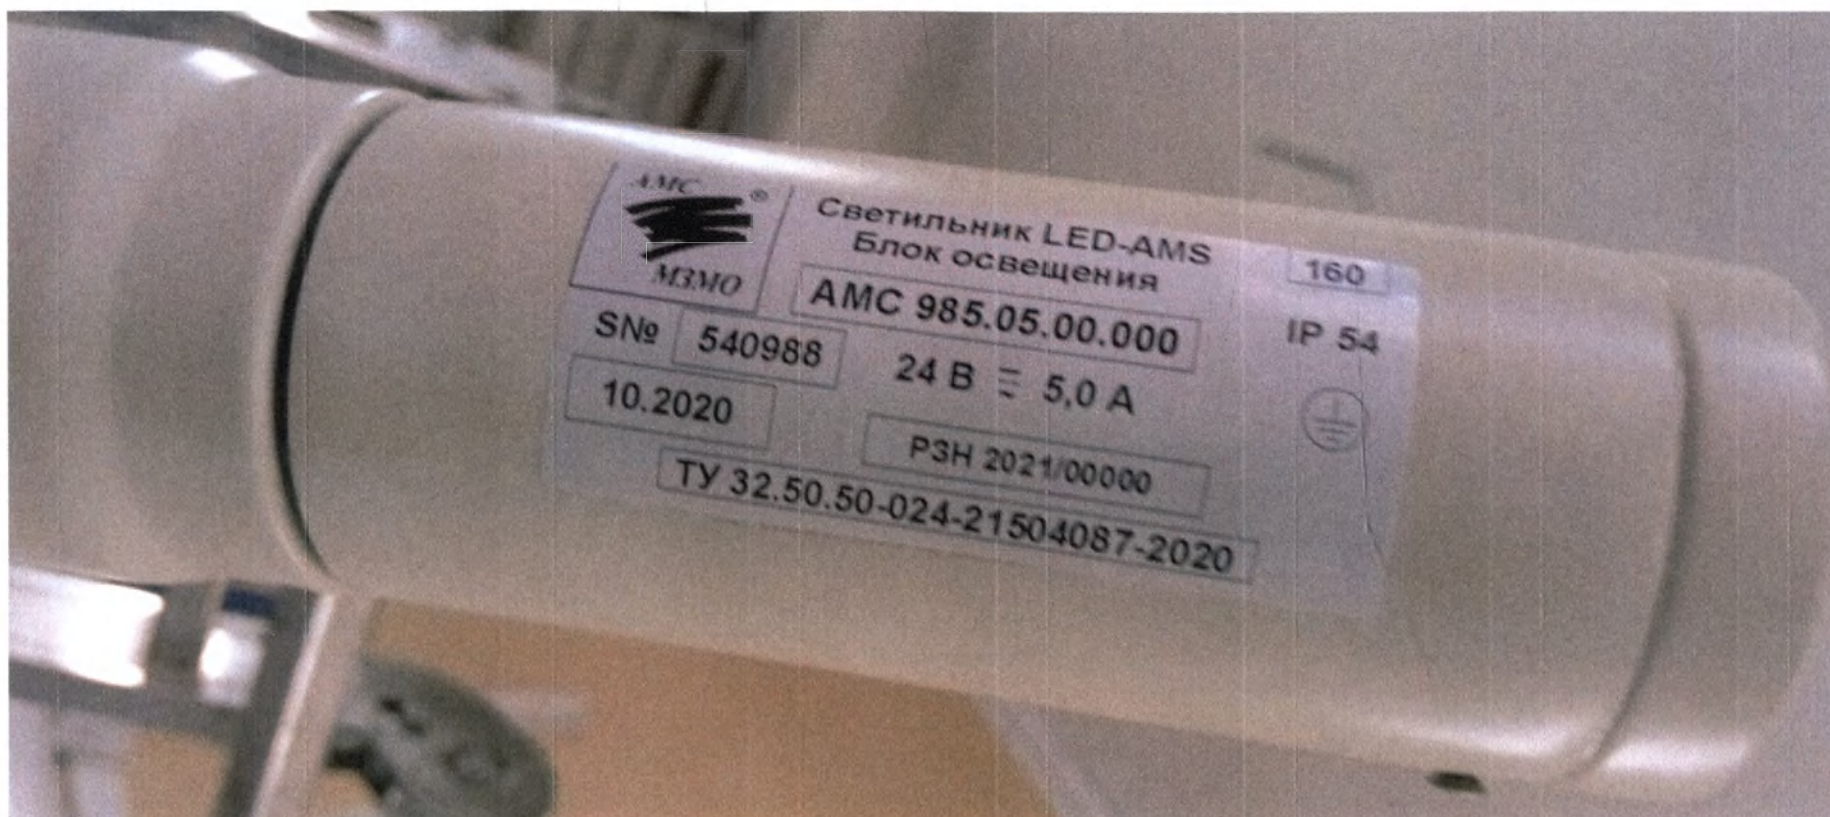

Светильник хирургический LED-AMS 1-160 С, зав. № 540988
Пример маркировки.

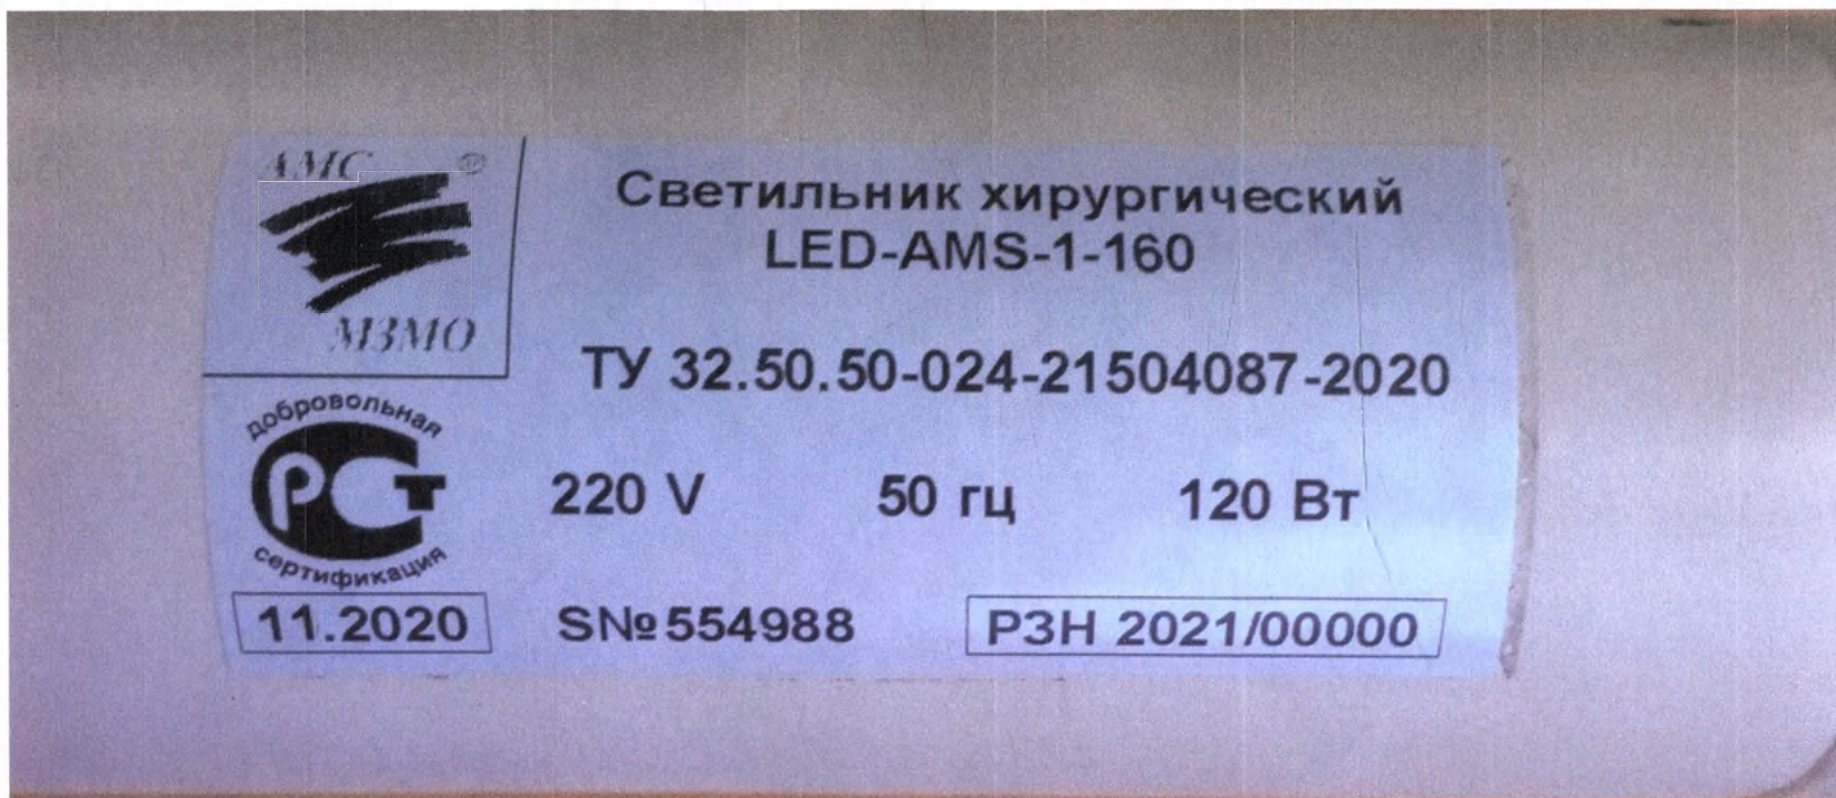

Светильник хирургический LED-AMS 1-160, зав. № 554988

Пример маркировки

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 40 лист об
Генеральный директор АО «АМС»
« Н. Г. Гуськов » 2021 г.

