

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЗАО «АЗРТ»

Н.Е. Станкевич
« 07 » 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Аппарат рентгеновский диагностический
цифровой – «ГРАФИКС-Ц»**

**Аппарат рентгеновский диагностический цифровой – «ГРАФИКС-Ц»
АПРБ 941210.005.000.000.00**




«Аппарат рентгеновский диагностический цифровой «ГРАФИКС - Ц» (Исполнение 1), в составе:

1. Устройство рентгеновское питающее высокочастотное TOP-X 850 HF, модель TOP-X 850 HF с принадлежностями: пульт управления TXFAC1



или

Устройство рентгеновское питающее высокочастотное «УРПвч – «АЗРТ»

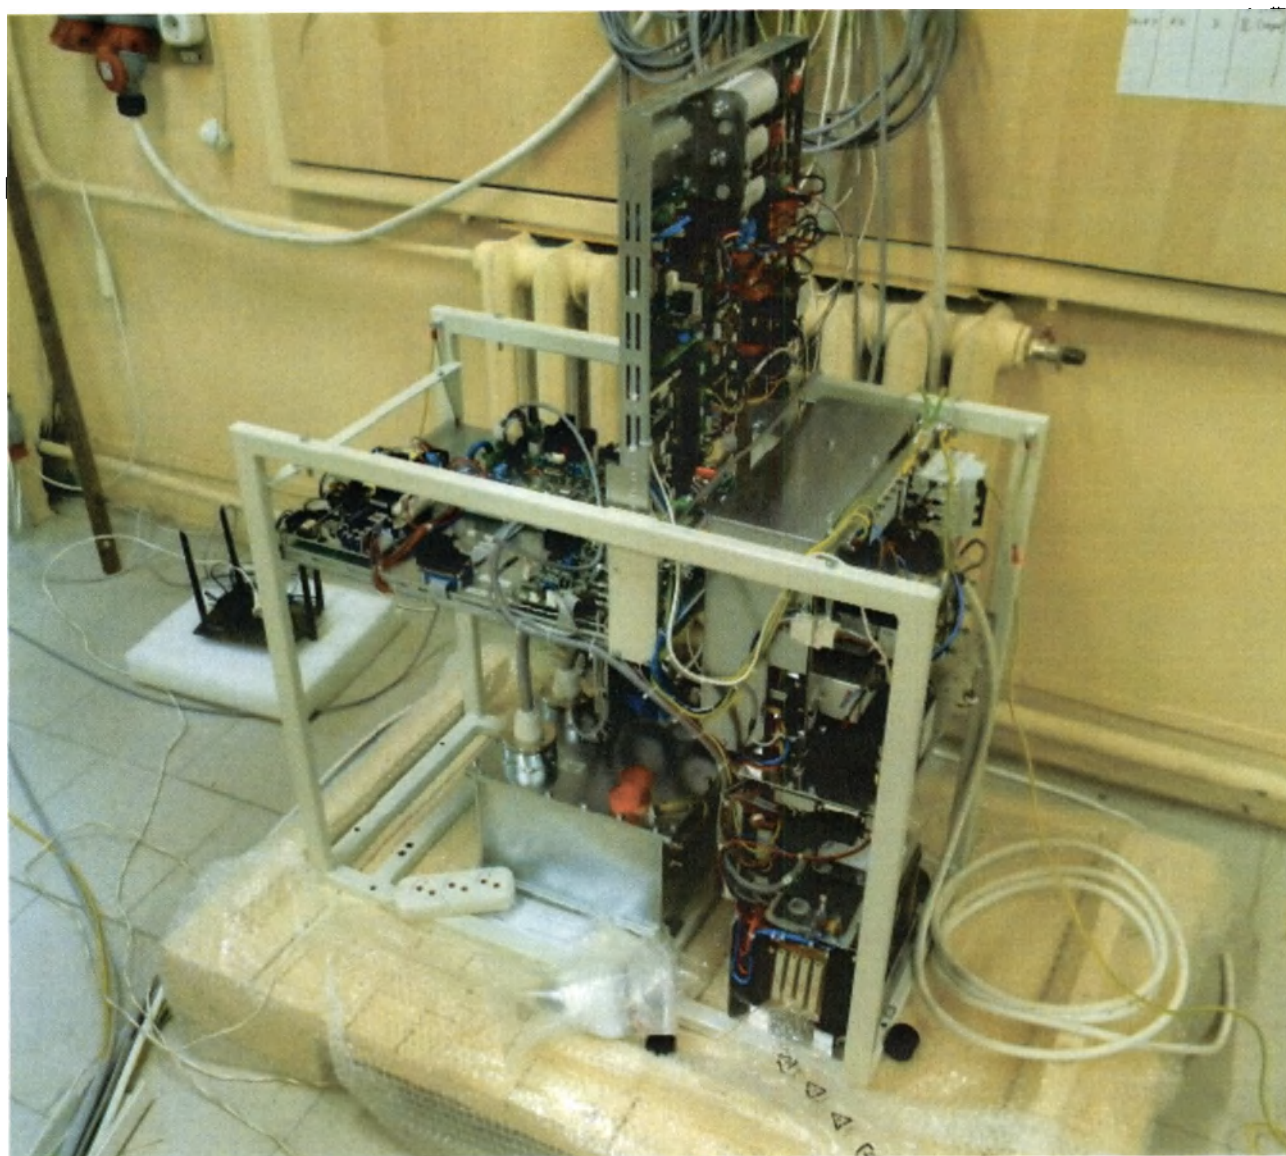

2. Штатив снимков, АПРБ 941210.004.100.000.00



или


Штатив с основанием, колонной и манипулятором, модель (MDZ)



или
Штатив для рентгеновских аппаратов MDZ



3. Диафрагма глубинная, КЛУЖ 38637.020.05

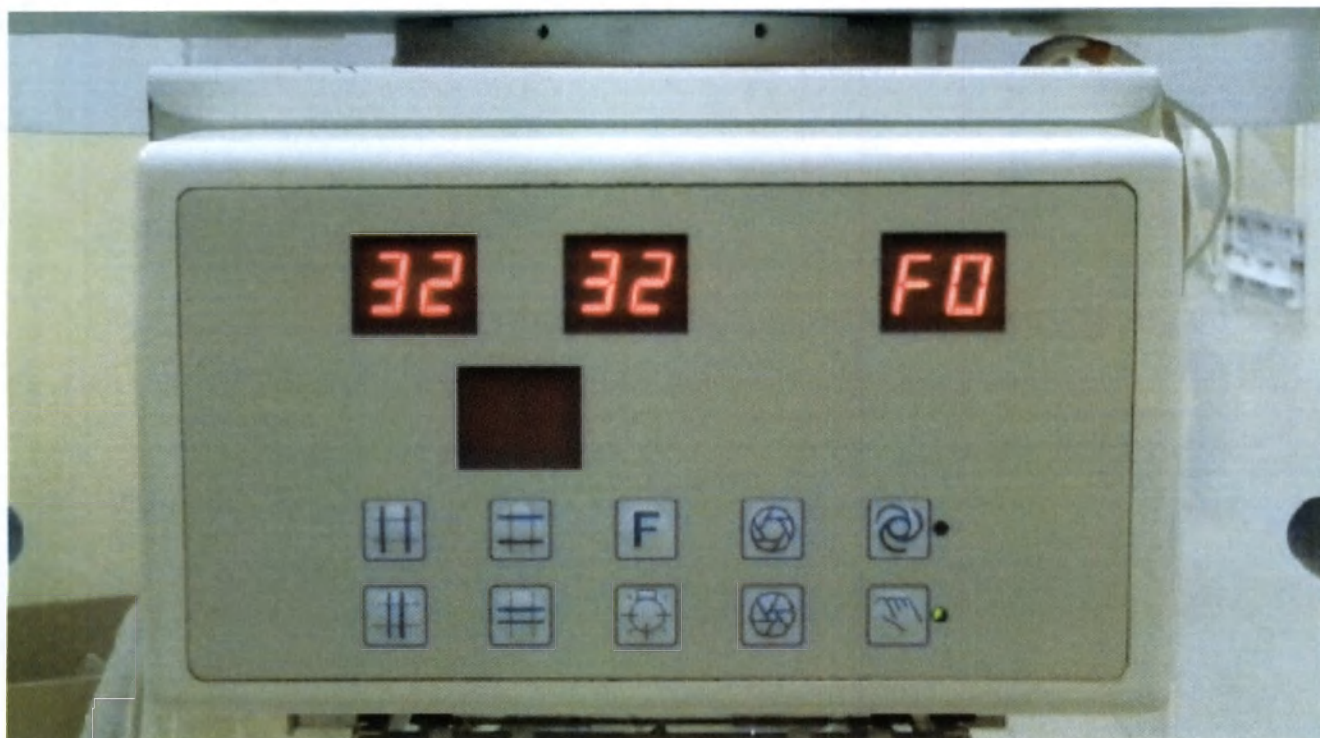


или
Диафрагма, модель (MDZ)




или
Коллиматор Optica, модель Optica 10




4. Электронная система управления, АПРБ941210.004.100.000.00 ОЗ

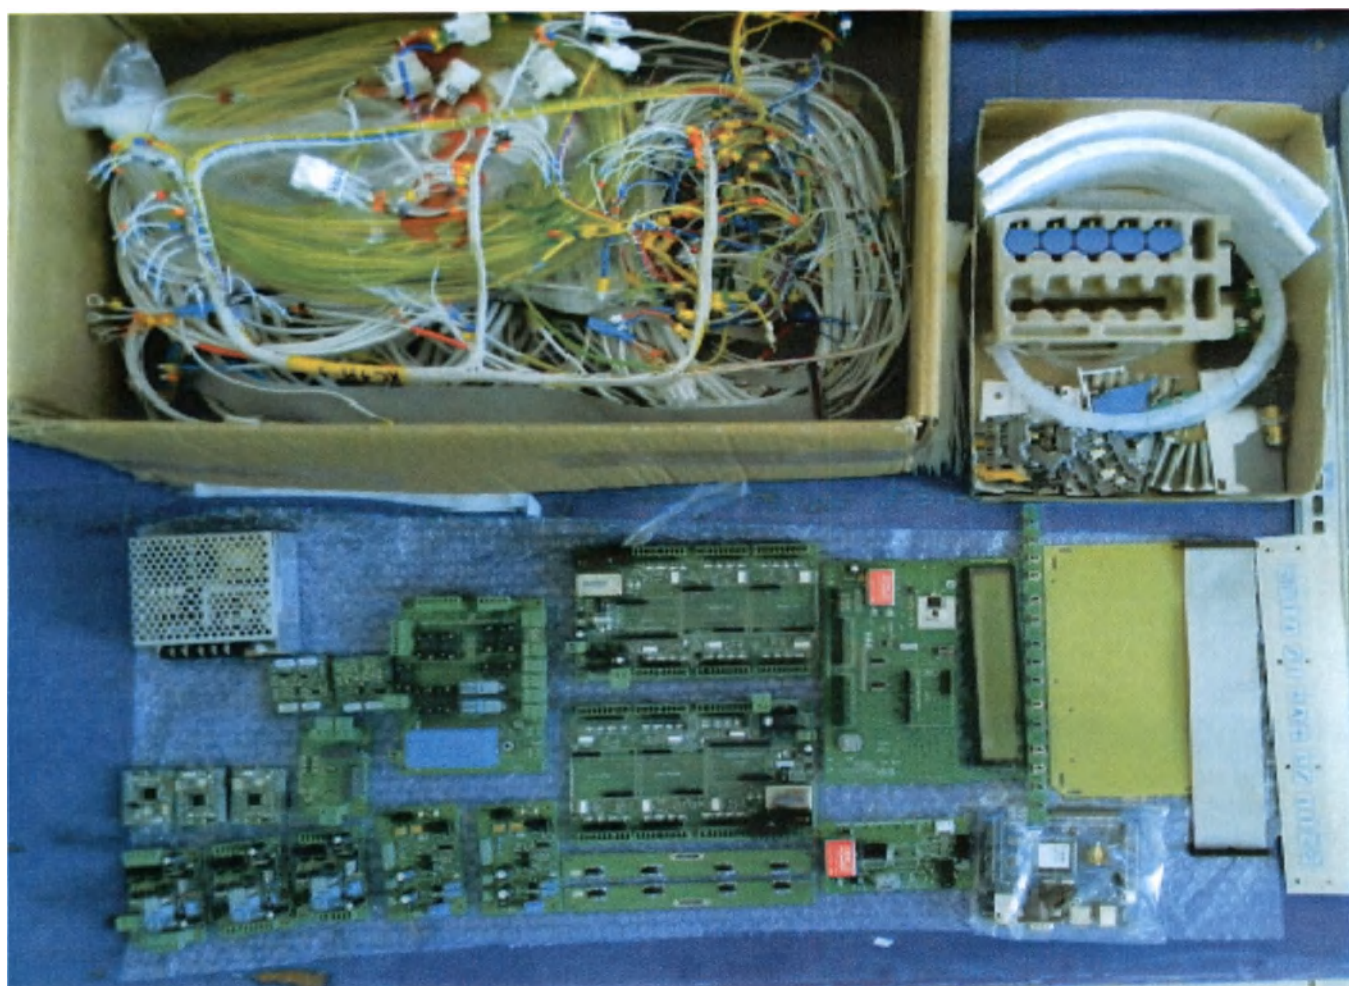

5. Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения, АПРБ 941210.002.110.00

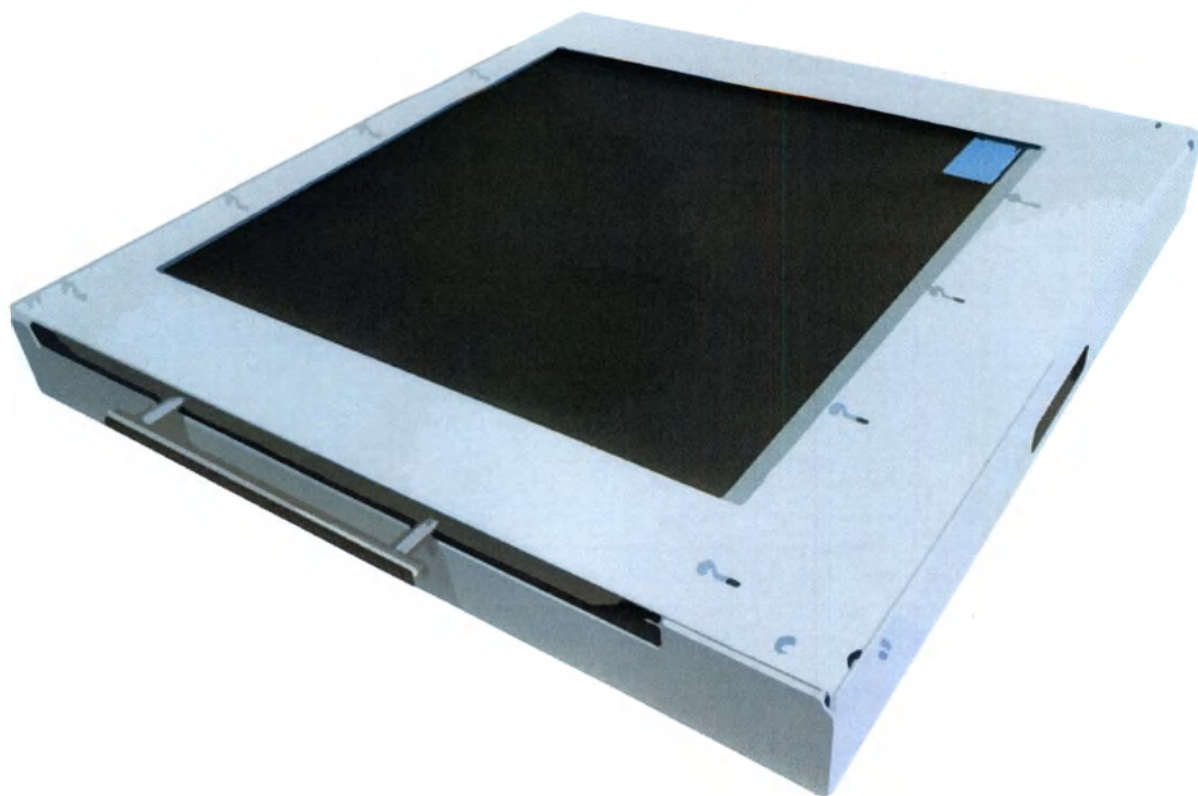

6. Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений
УЦОИ-«АККОРД»

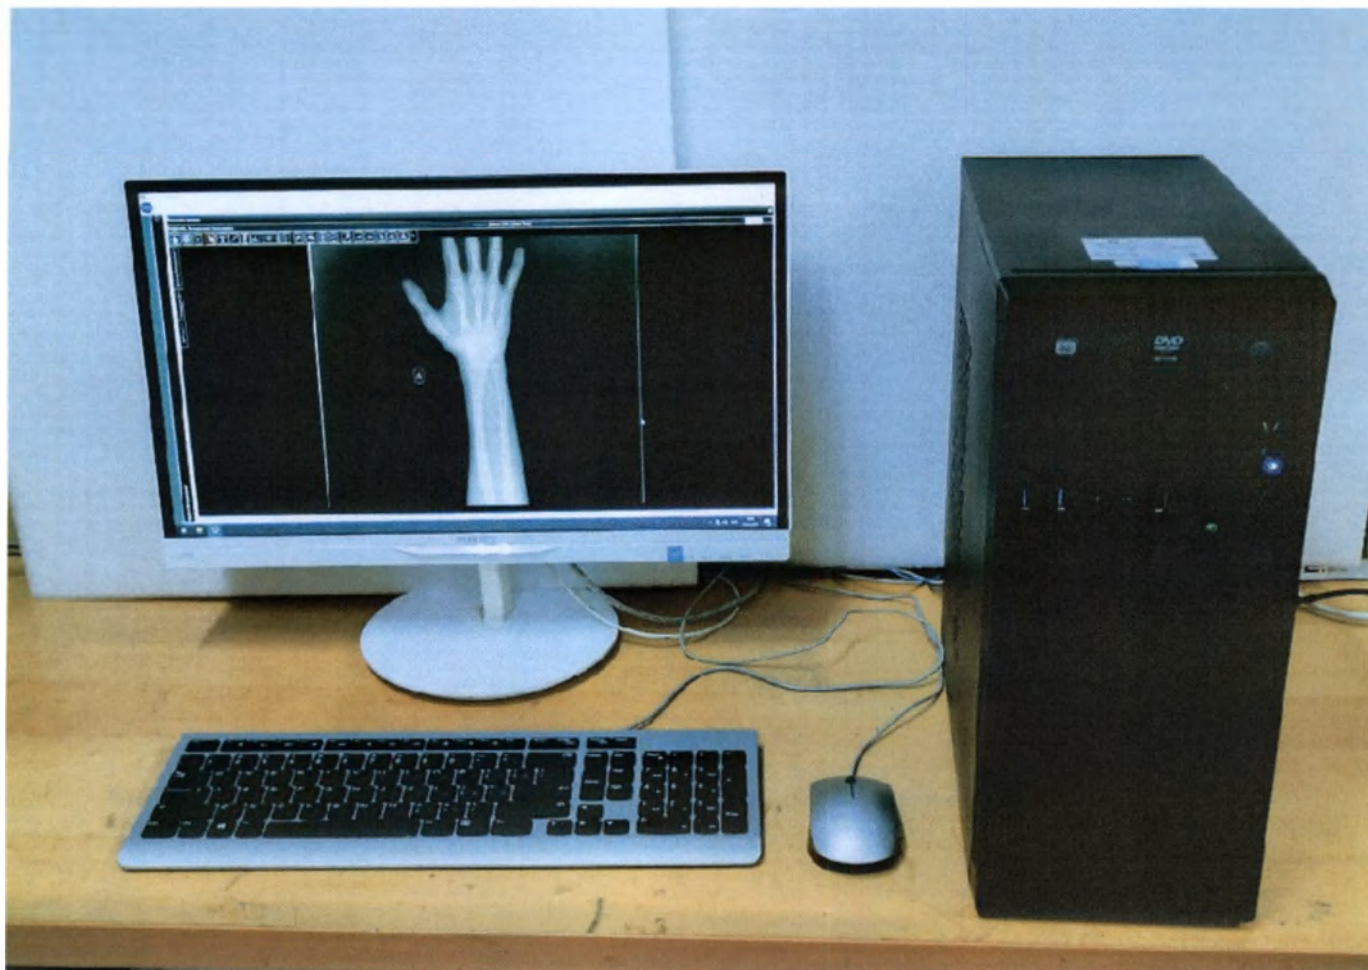

7. Дозиметр рентгеновского излучения клинический, исполнение ДРК-1




или

Дозиметр рентгеновского излучения клинический, исполнение ДРК-1М



8. Излучатель рентгеновский E7242X

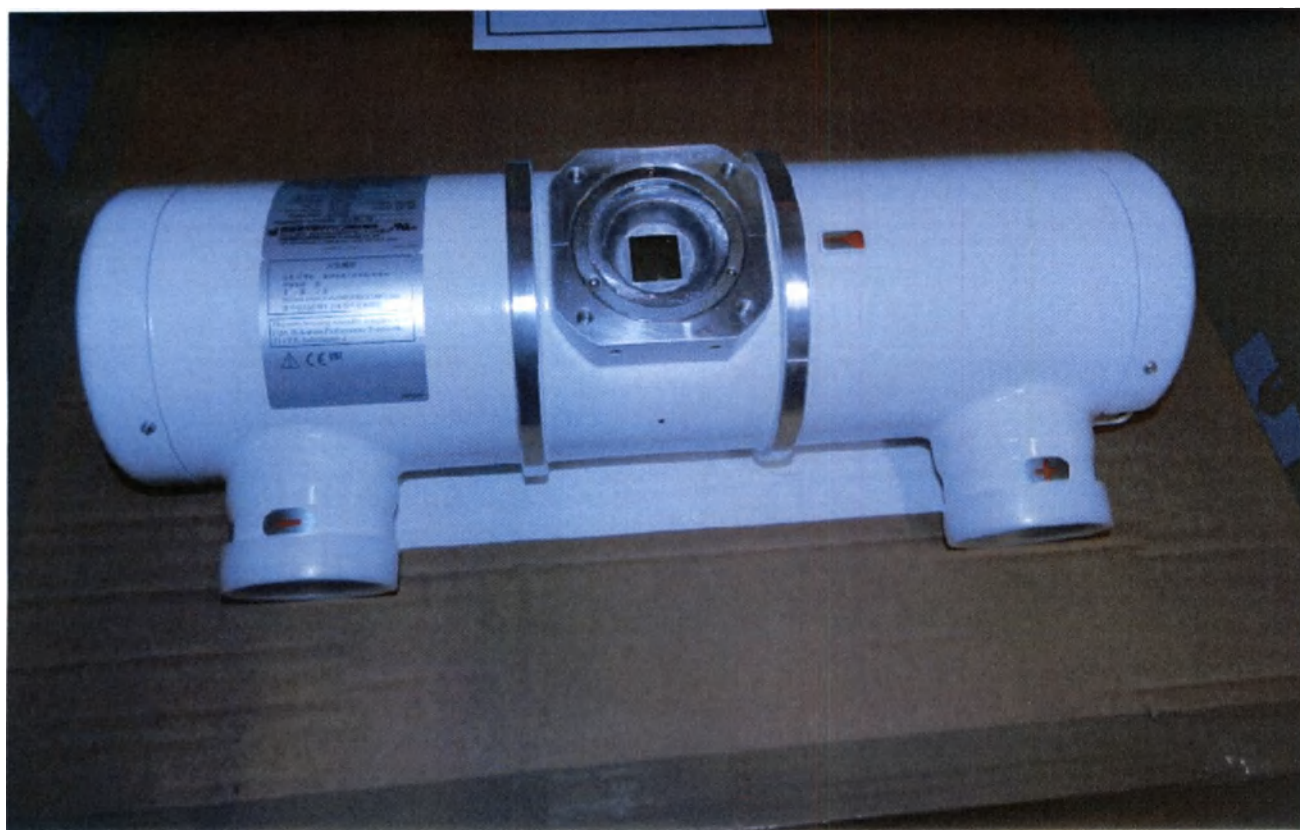

или

Излучатель с трубкой рентгеновской, RAY-12_1, RAY-12_3, RAY-12S_1, RAY-12S_3, RAY-14_1, RAY-14_3, RAY-14S_1, RAY-14S_3



ИЛИ

Излучатель с трубкой рентгеновской, Optilix 154/30/50R-101S



или
Излучатель рентгеновский, C40/X42,



C52/RTM 782 HS, C352/RTM 782 HS.




9. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ – «Р-К»:

или

Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС»:



10. Растр рентгеновский отсеивающий JPI, Тип AAS, ACS, AAC, ACC

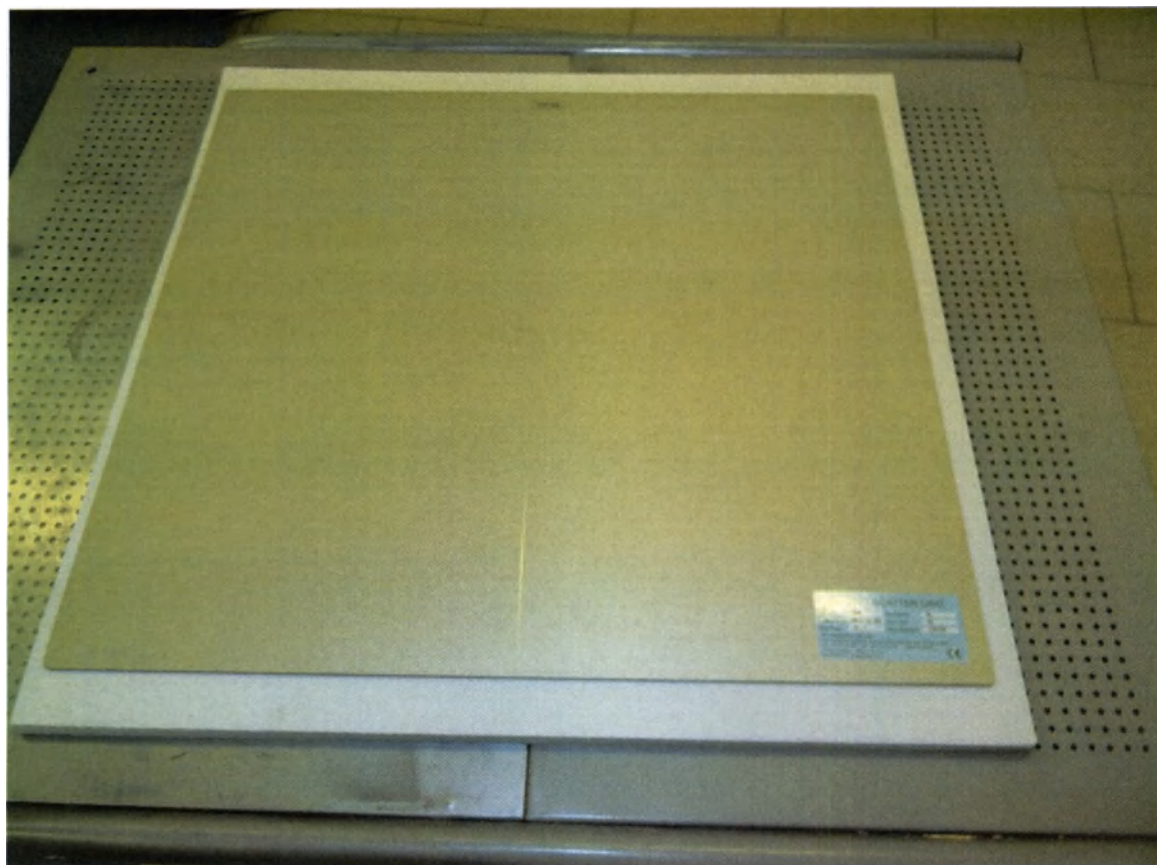

11. Принадлежности:

11.1 Каталка рентгенографическая, АПРБ 941210.000.110.00



ИЛИ

Стол-каталка, модель (MDZ)



или
Каталка рентгенопрозрачная, модель (MRX RAD)




или

Каталка рентгенопрозрачная с лифтом, модель (MRX RAD)



или


Каталка рентгенопрозрачная с лифтом с аккумуляторным питанием, модель (MRX RAD)

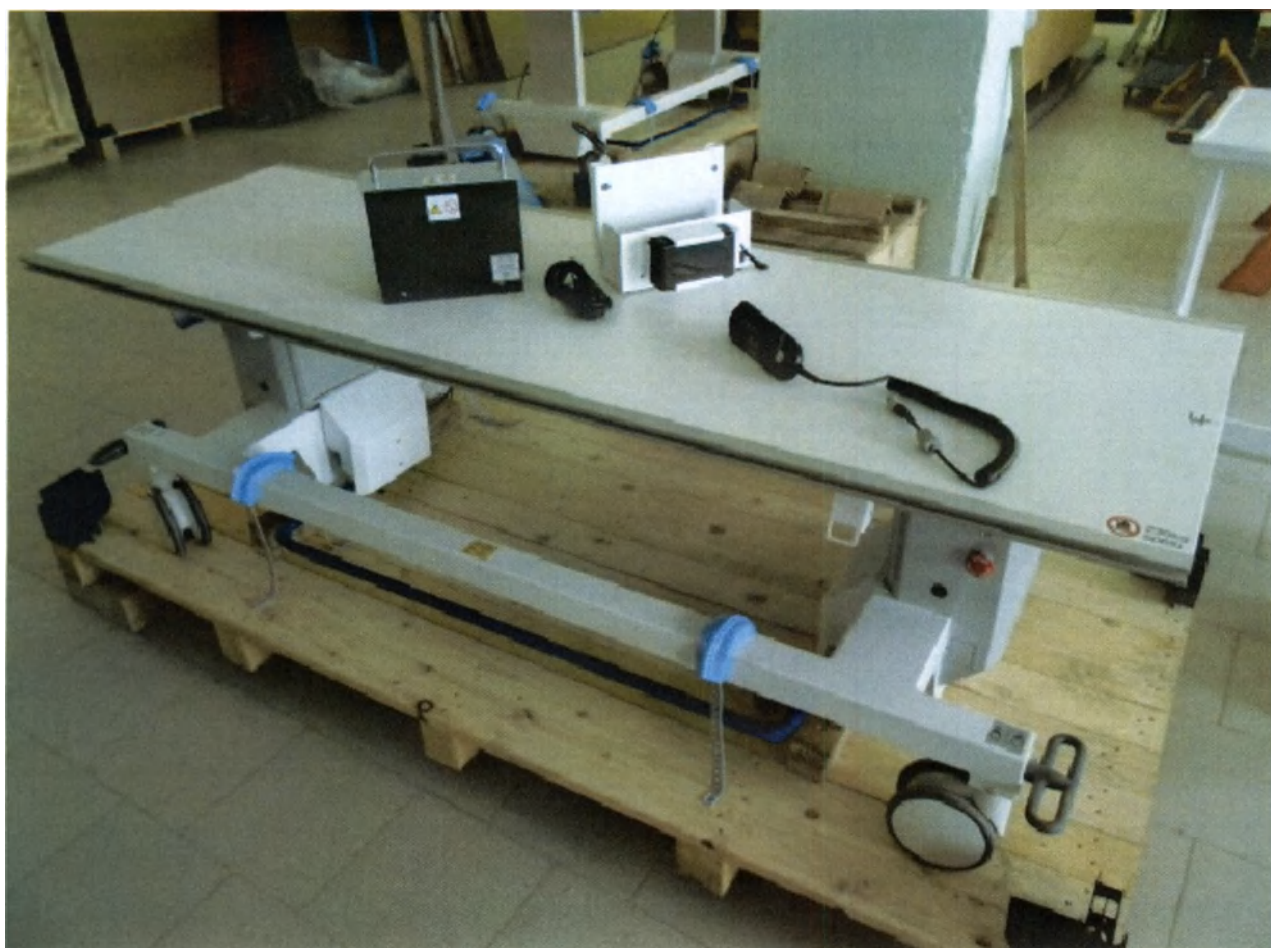

11.2 Система дистанционного видеонаблюдения, АПРБ 941210.000.220.00



11.3 Переговорное устройство, АПРБ 941210.000.210.00

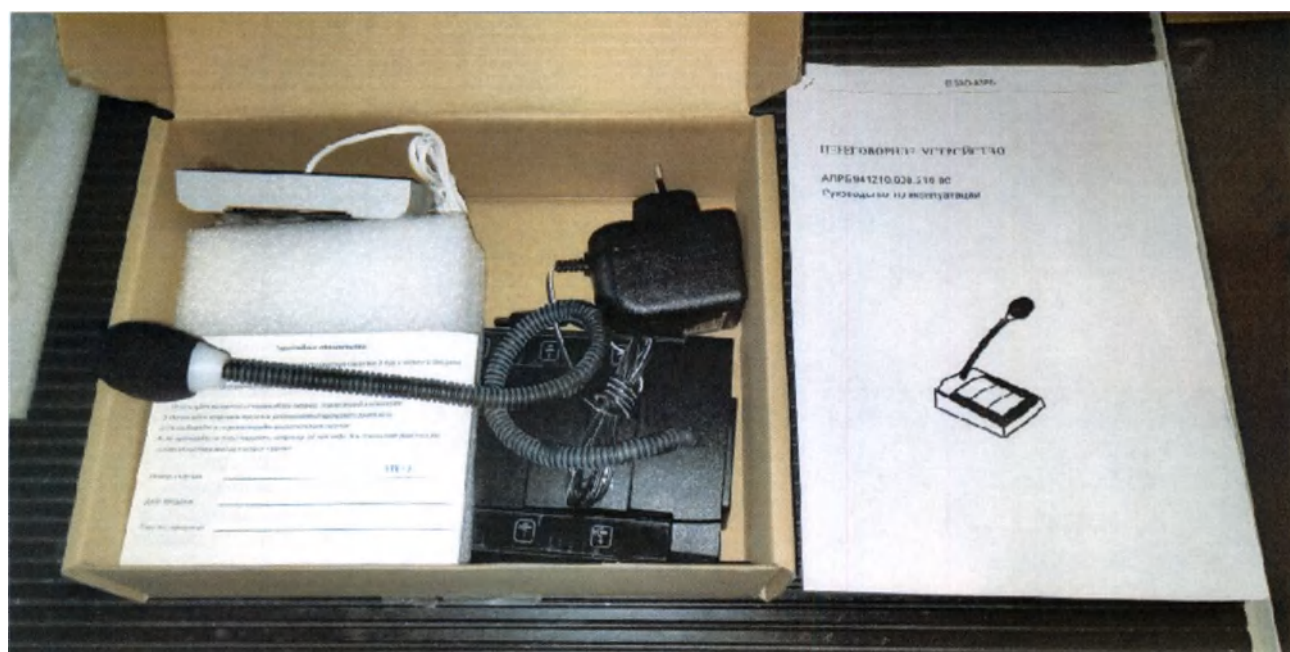


11.4 Стабилизатор напряжения переменного тока, марка «LIDER», модель PS30000W-30,



или

Стабилизатор напряжения серии «Сатурн», модель СНЭ-Т-90, СНЭ-Т-100

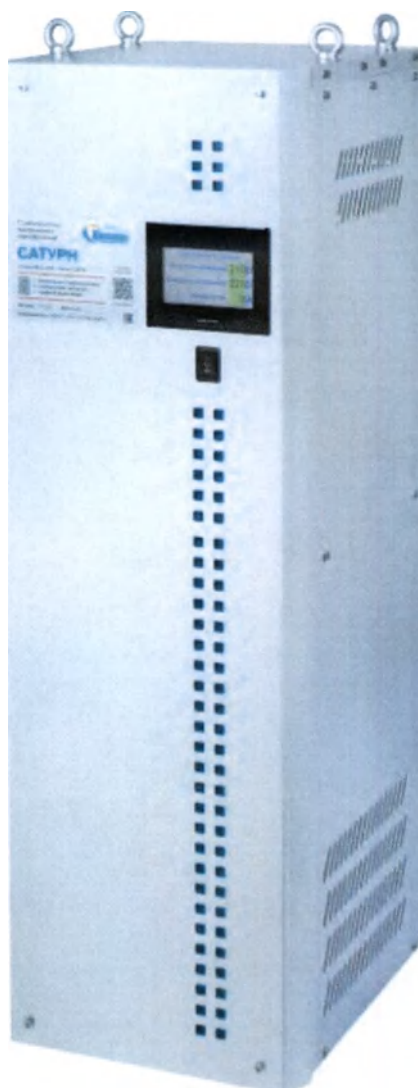


или

Стабилизатор переменного напряжения трехфазный, марка Штиль, модель R81000-3, R100K-3, R100K-3P,



«Аппарат рентгеновский диагностический цифровой «ГРАФИКС - Ц» (Исполнение 2), в составе:

1. Устройство рентгеновское питающее высокочастотное TOP – X 100 LC, модель TOP – X 100 LC с принадлежностями: пульт управления LCDTC1

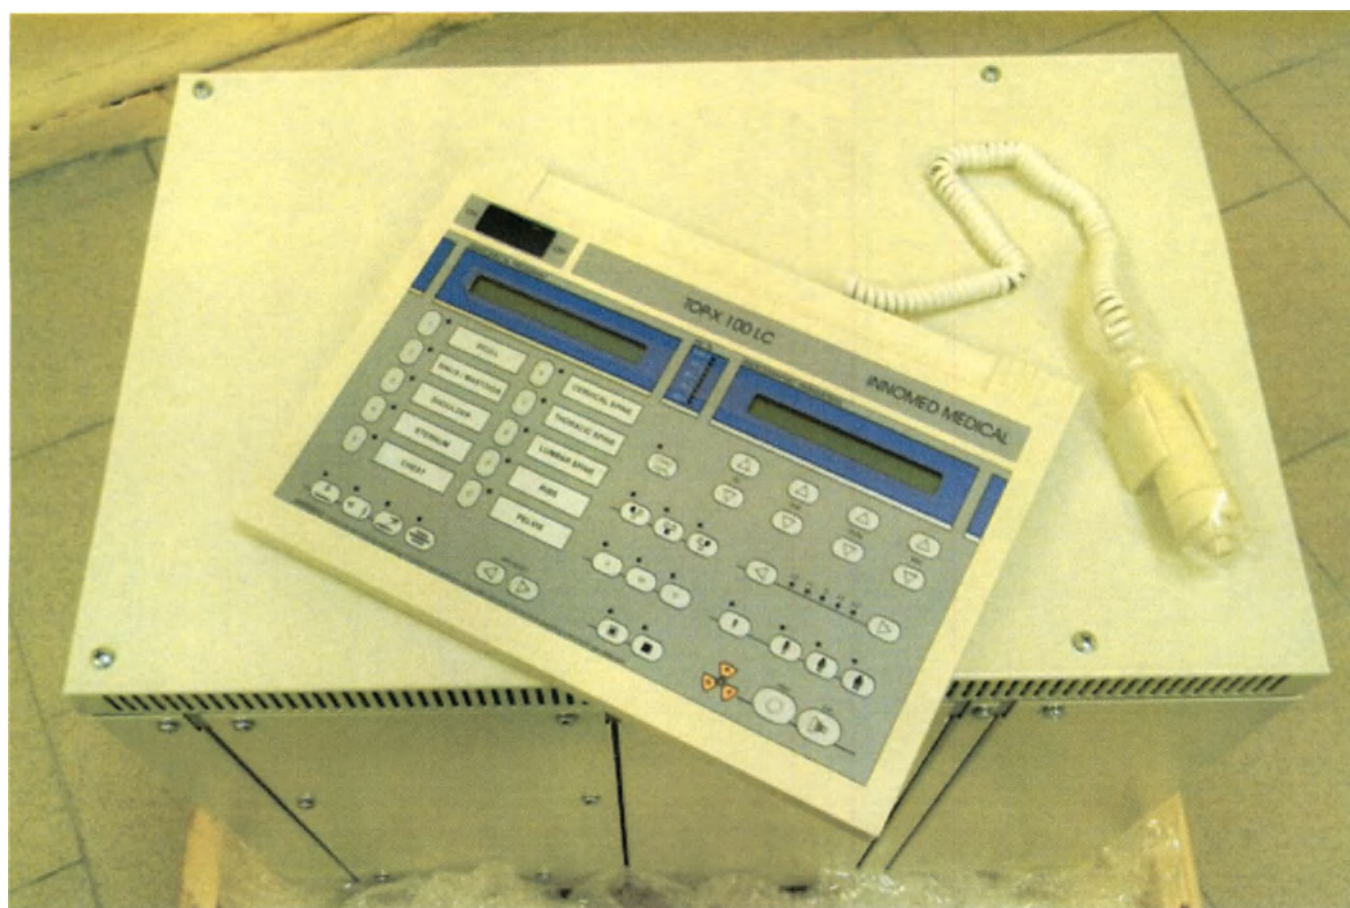

2. Штатив снимков, АПРБ 941210.004.100.000.00



или


Штатив с основанием, колонной и манипулятором, модель (MDZ)



или
Штатив для рентгеновских аппаратов MDZ




3. Диафрагма глубинная, КЛУЖ 38637.020.05

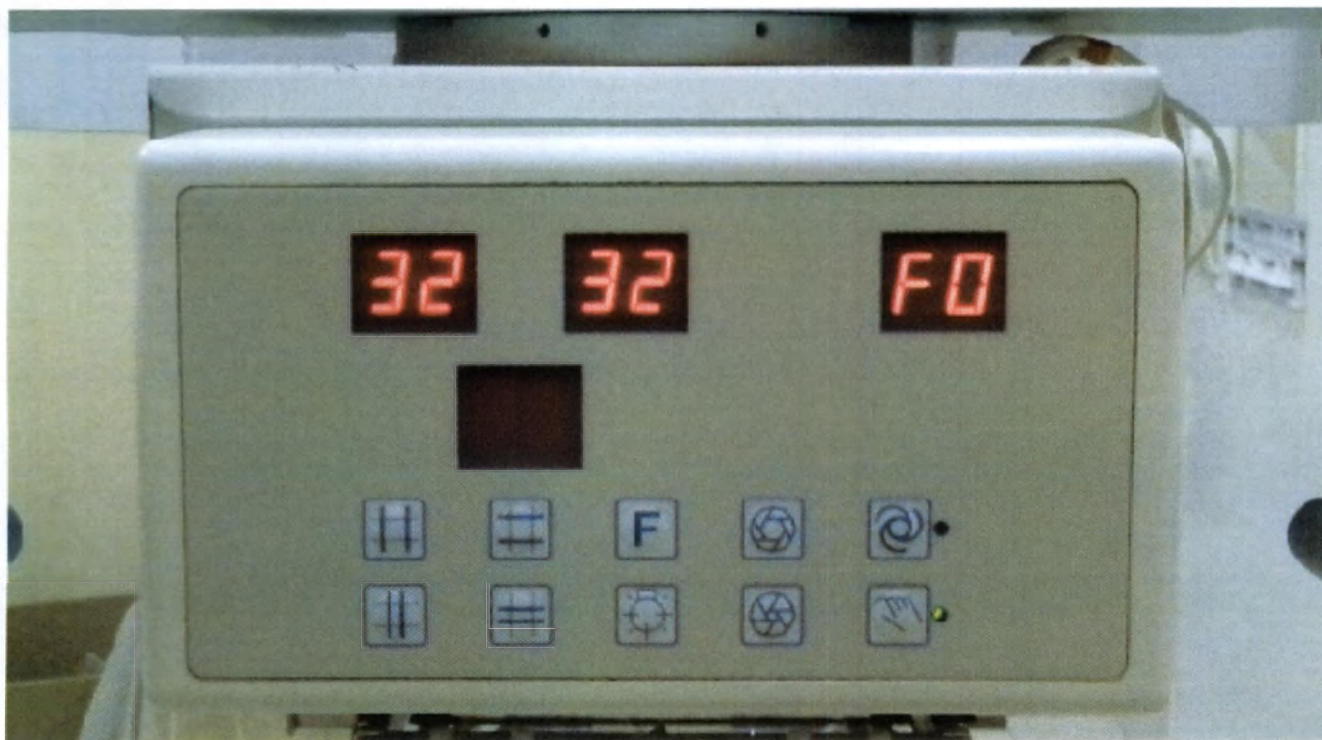


или
Диафрагма, модель (MDZ)




или
Коллиматор Optica, модель Optica 10

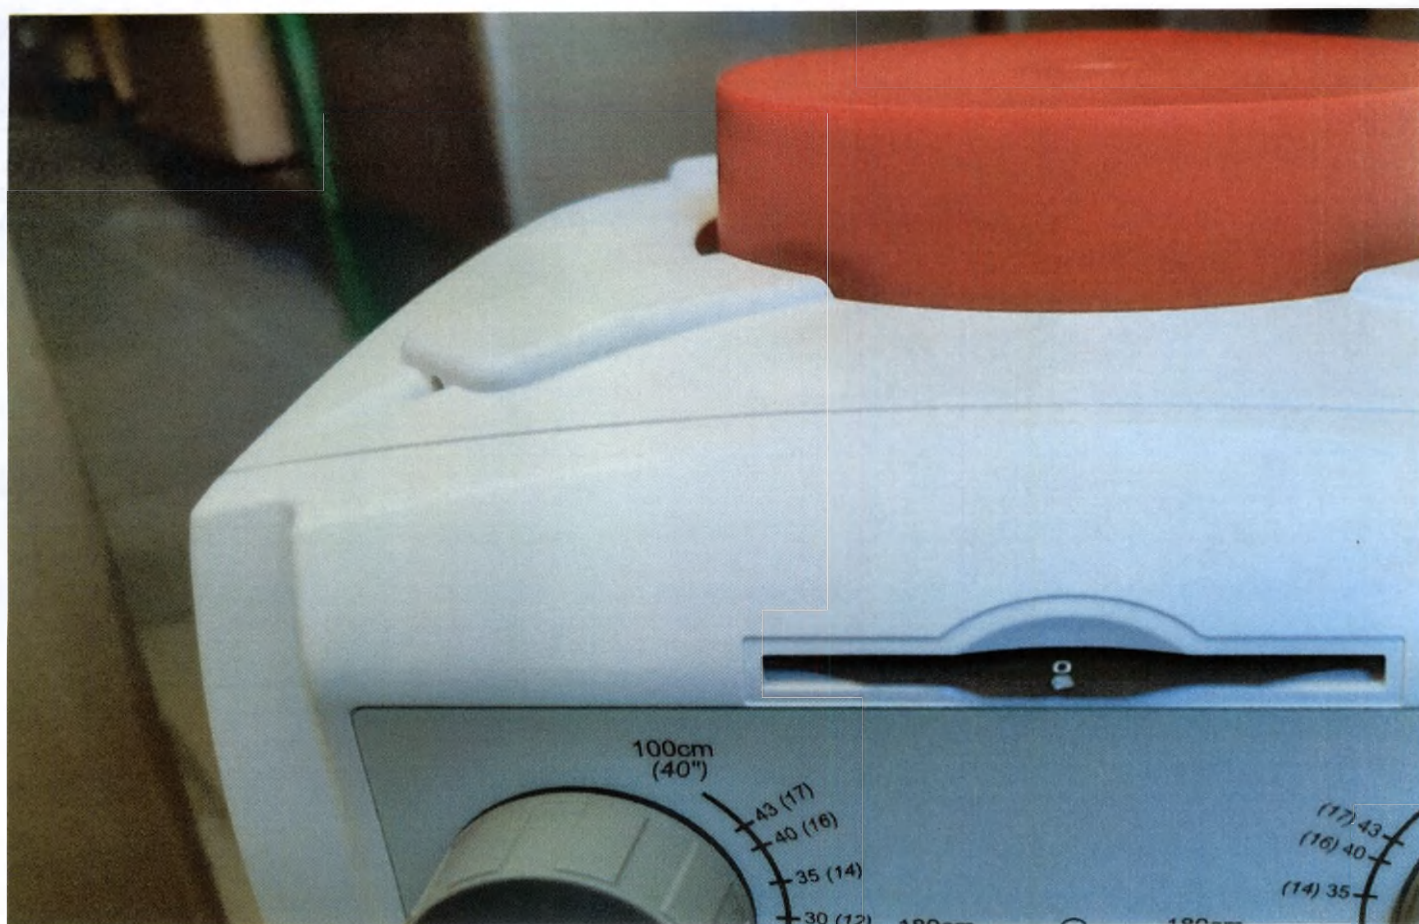


4. Электронная система управления, АПРБ941210.004.100.000.00 ОЭ

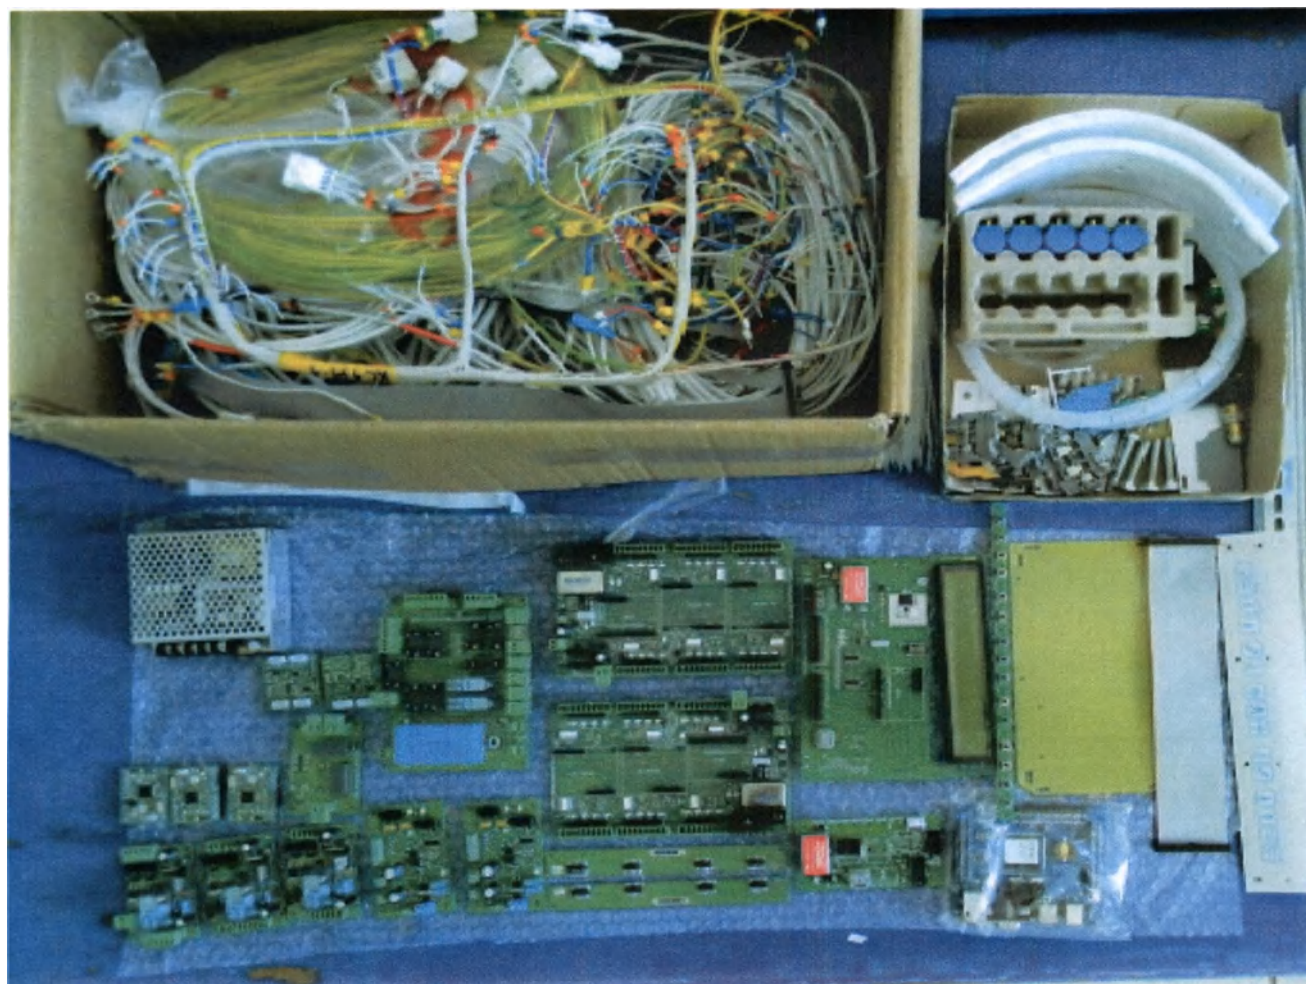

5. Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения, АПРБ 941210.002.110.00

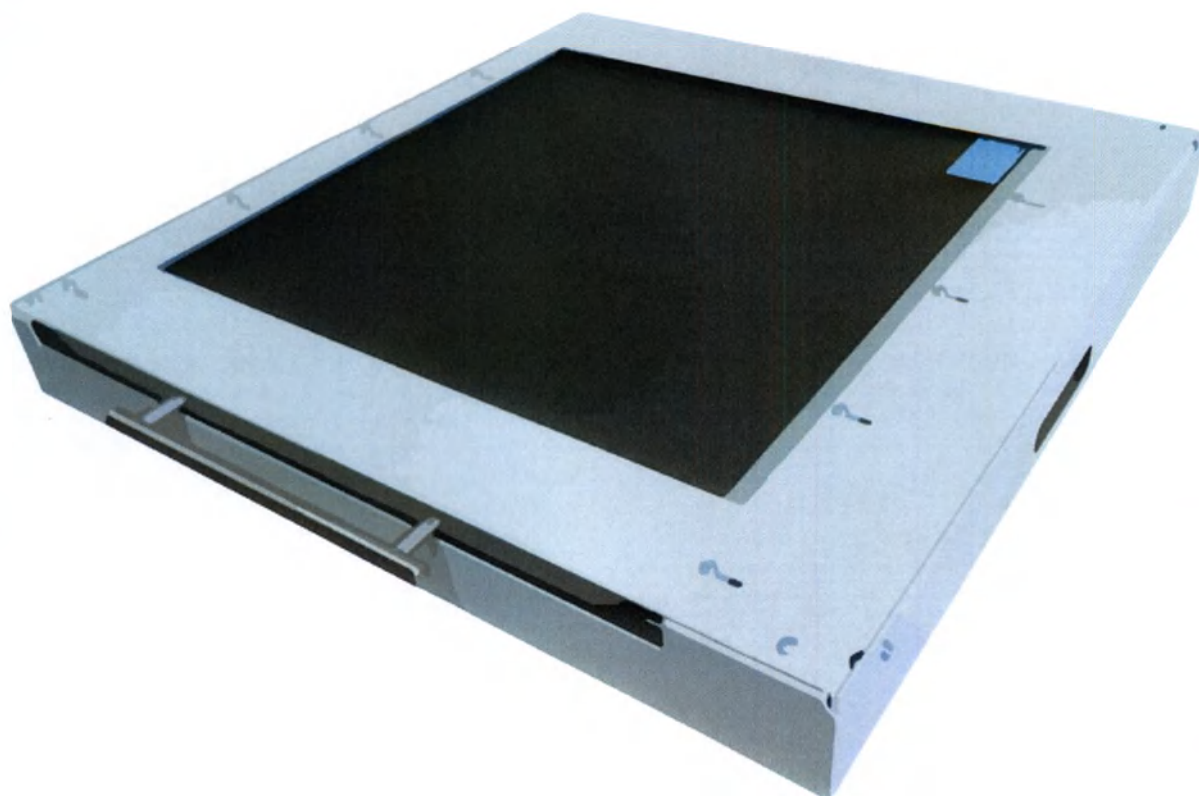

6. Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений
УЦОИ-«АККОРД»

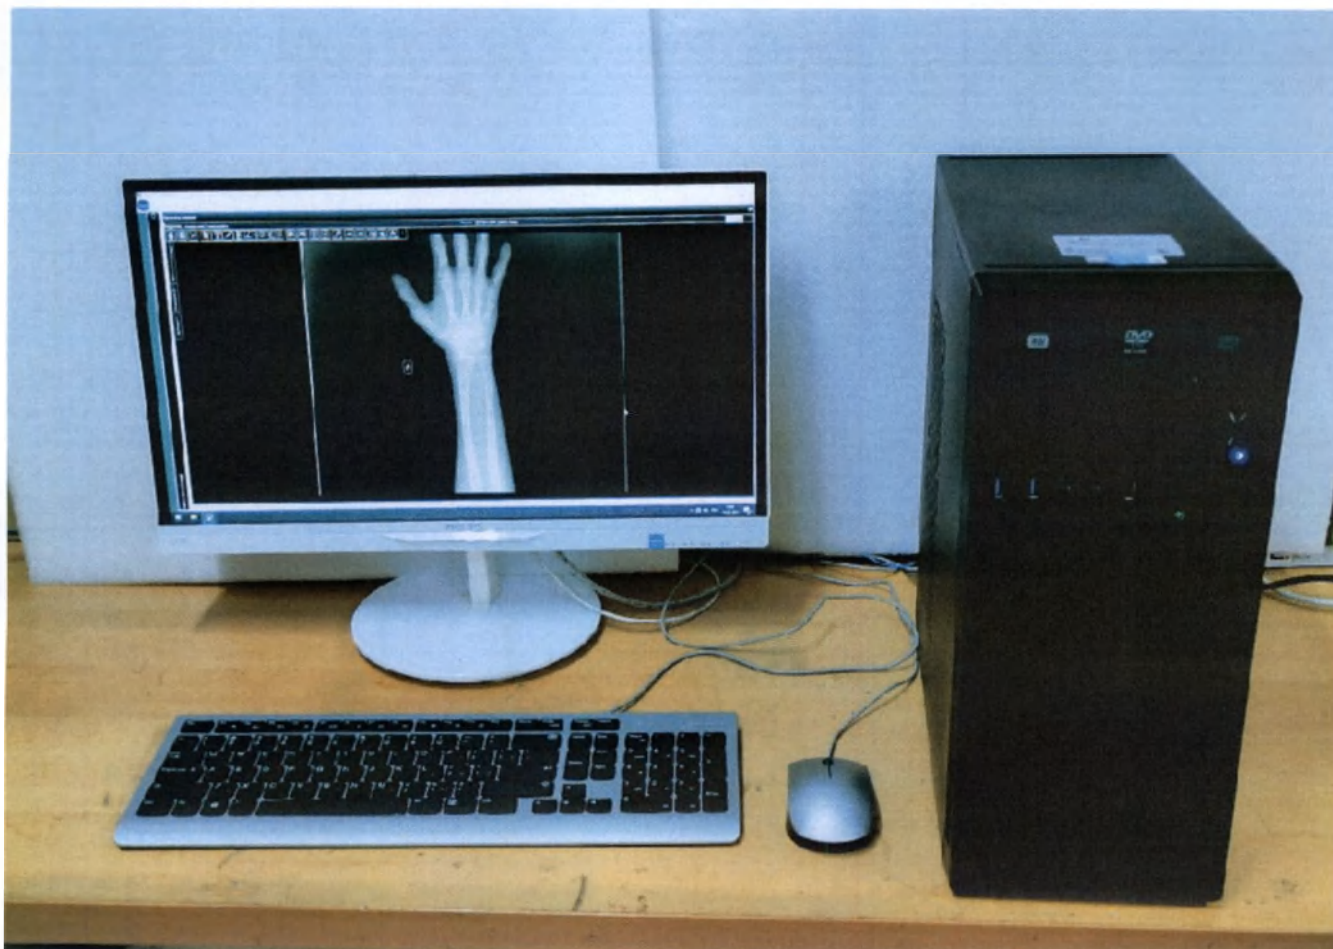

7. Дозиметр рентгеновского излучения клинический, исполнение ДРК-1




ИЛИ

Дозиметр рентгеновского излучения клинический, исполнение ДРК-1М



8. Излучатель рентгеновский E7242X

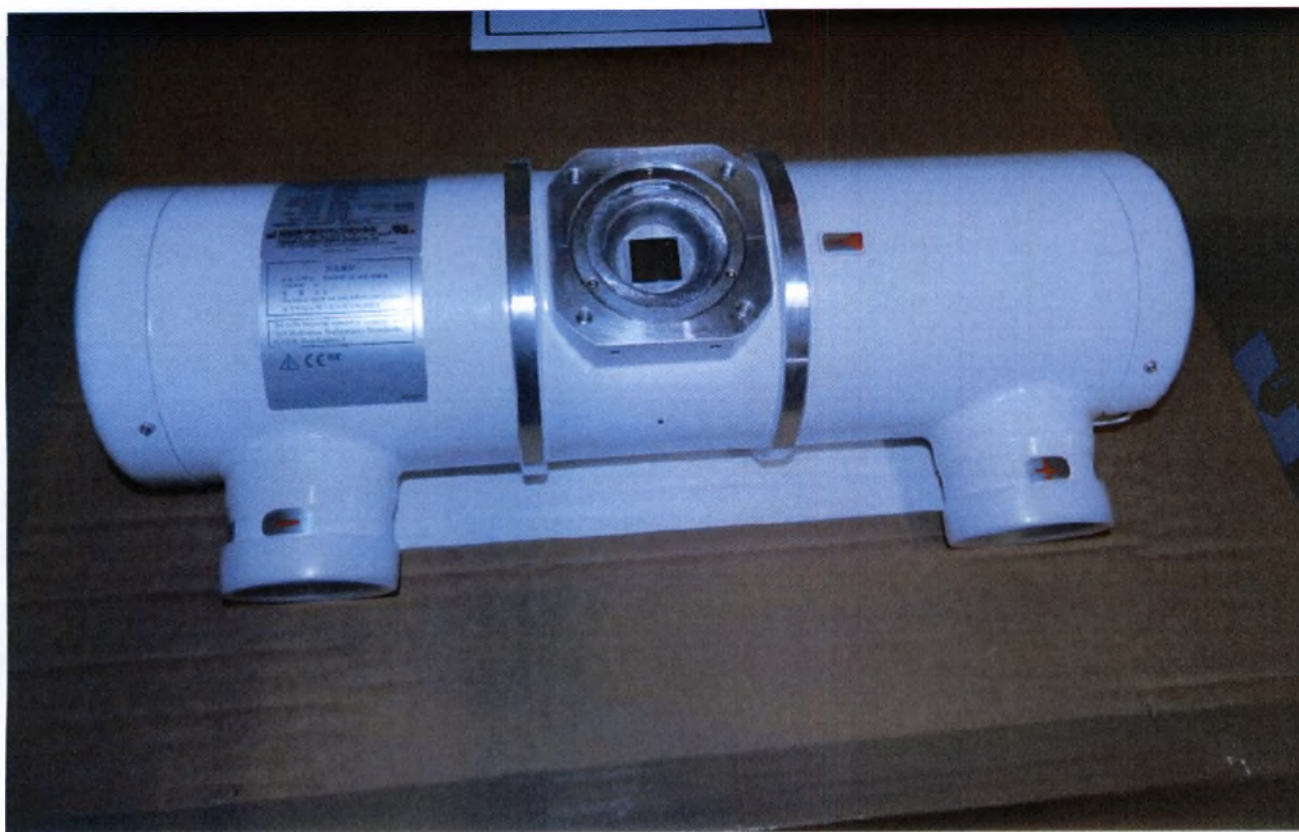

или

Излучатель с трубкой рентгеновской, RAY-12_1, RAY-12_3, RAY-12S_1, RAY-12S_3, RAY-14_1, RAY-14_3, RAY-14S_1, RAY-14S_3



или

Излучатель с трубкой рентгеновской, Optilix 154/30/50R-101S



или
Излучатель рентгеновский, C40/X42,



C52/RTM 782 HS, C352/RTM 782 HS




9. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ – «Р-К»:

или Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС»:



10. Растр рентгеновский отсеивающий JPI, Тип AAS, ACS, AAC, ACC

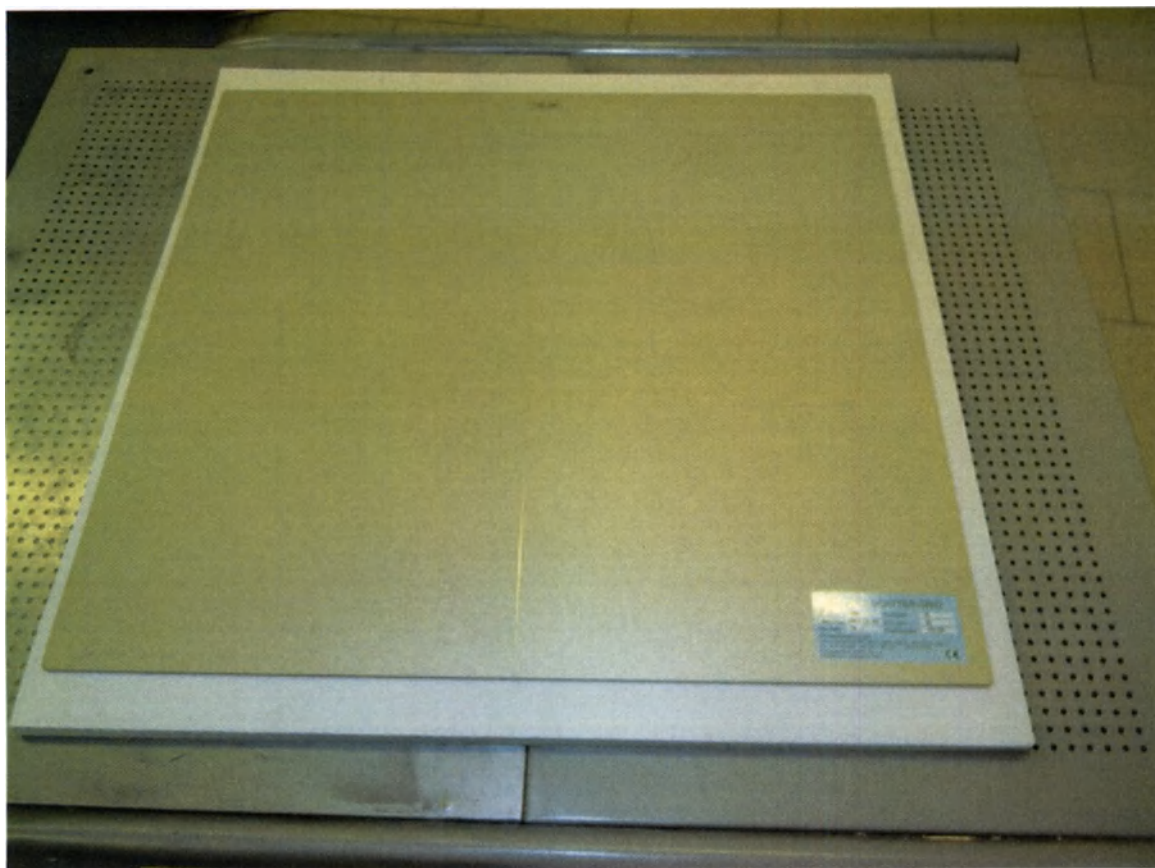

11. Принадлежности в составе:

11.1 Каталка рентгенографическая, АПРБ 941210.000.110.00



или
Стол-каталка, модель (MDZ)




или
Каталка рентгенопрозрачная, модель (MRX RAD)




или

Каталка рентгенопрозрачная с лифтом, модель (MRX RAD)

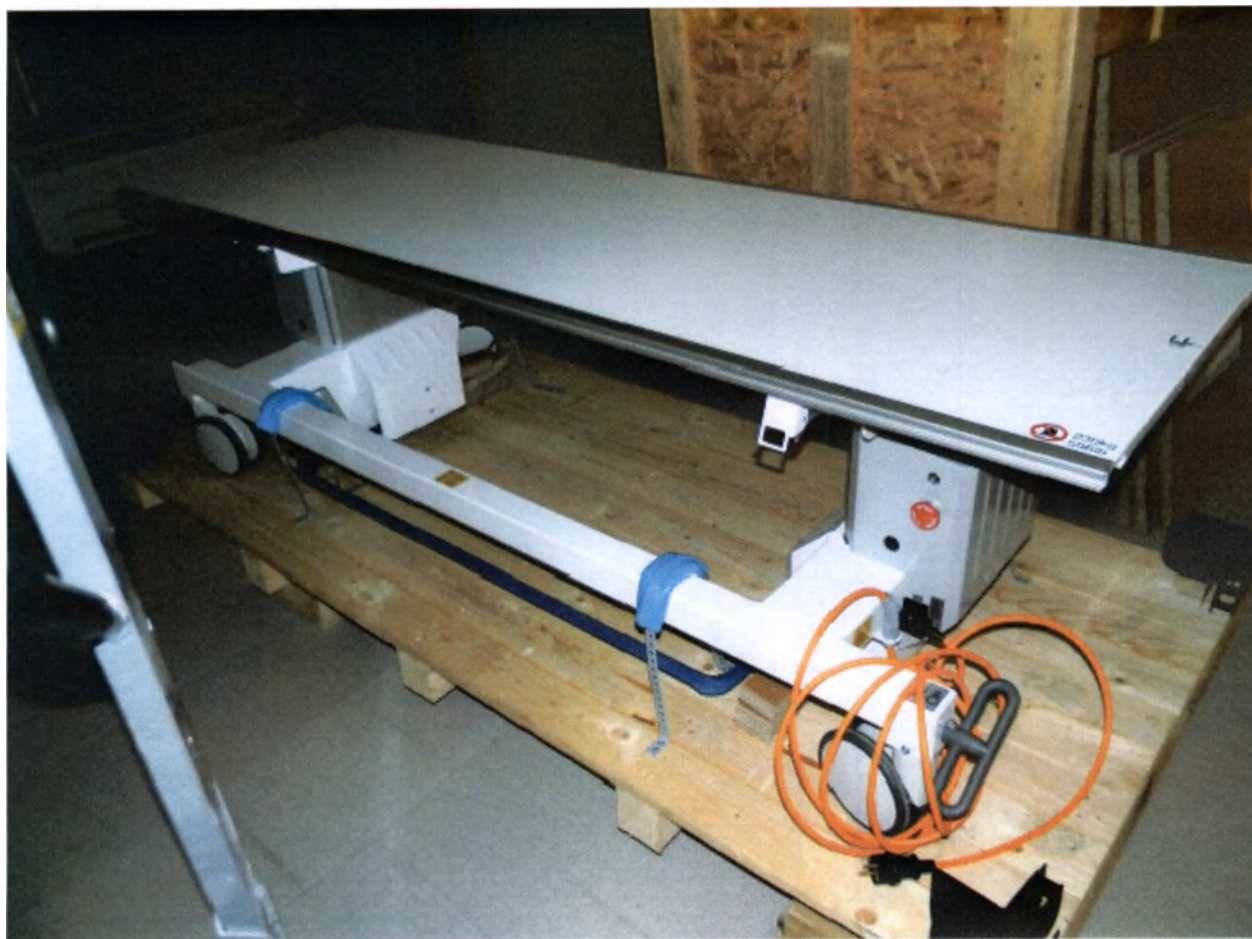

или


Каталка рентгенопрозрачная с лифтом с аккумуляторным питанием, модель (MRX RAD)

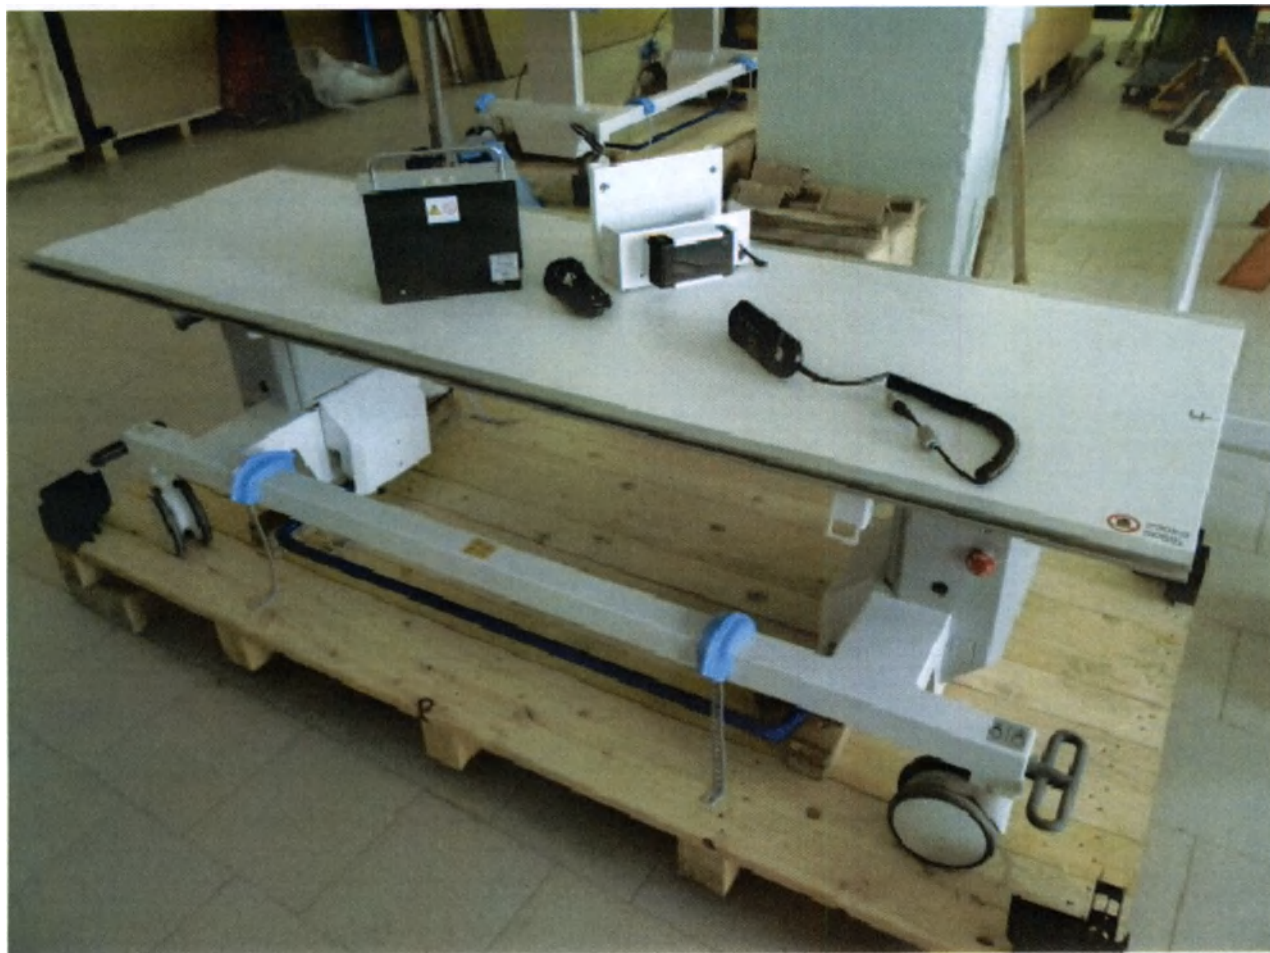

11.2 Система дистанционного видеонаблюдения, АПРБ 941210.000.220.00




11.3 Переговорное устройство, АПРБ 941210.000.210.00

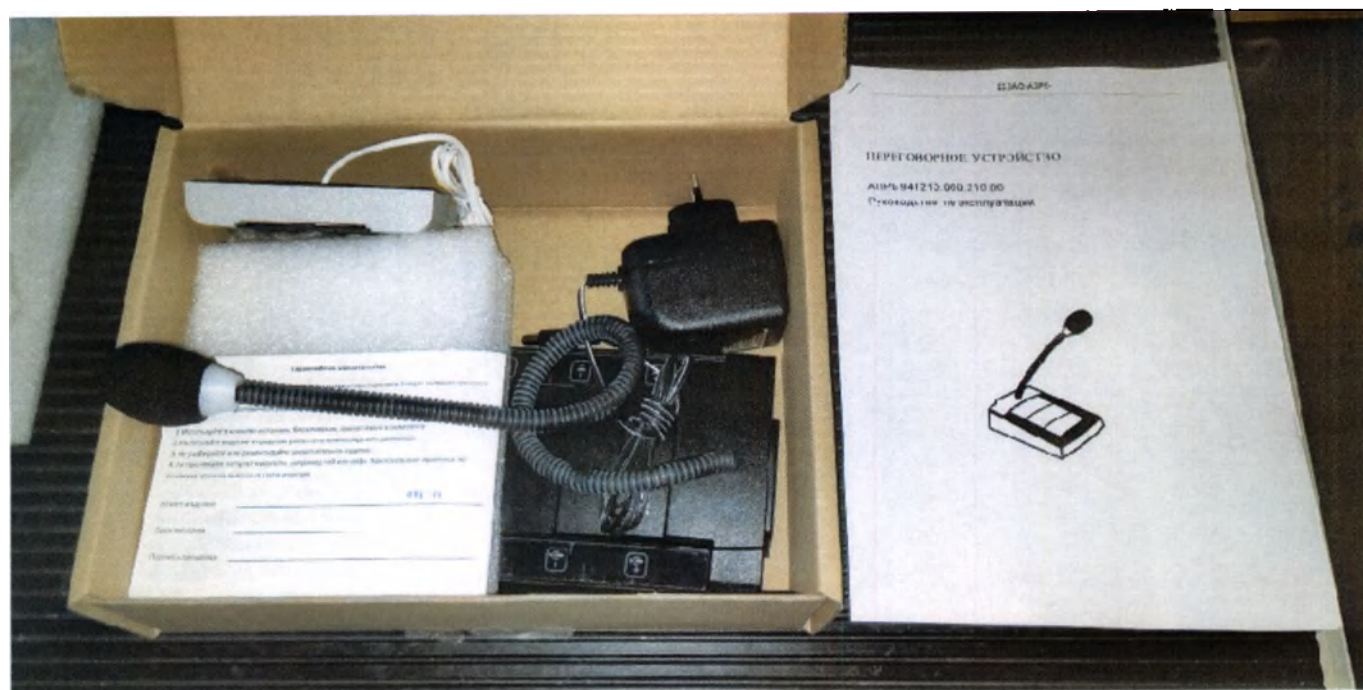


11.4 Стабилизатор напряжения переменного тока, марка «LIDER», модель PS30000W-30



или Стабилизатор напряжения серии «Сатурн», модель СНЭ-Т-90, СНЭ-Т-100

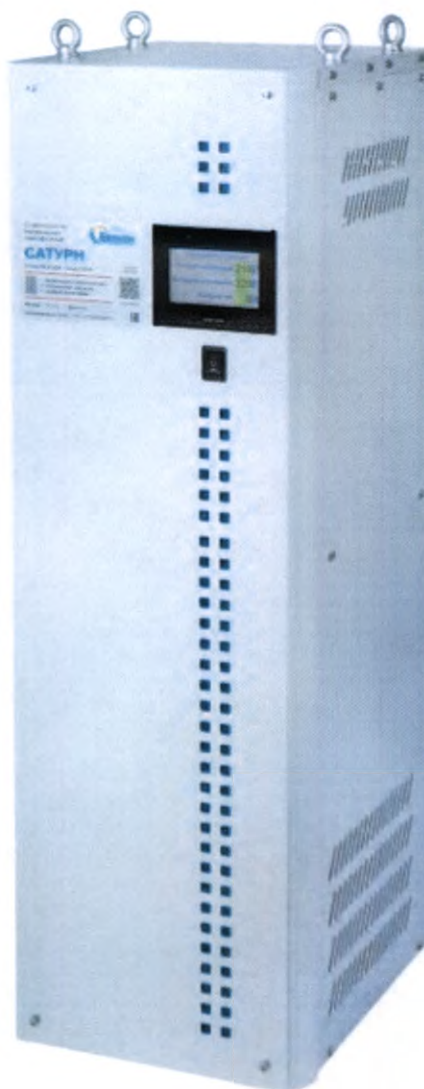

или Стабилизатор переменного напряжения трехфазный, марка Штиль, модель R81000-3,
R100K-3, R100K-3P,

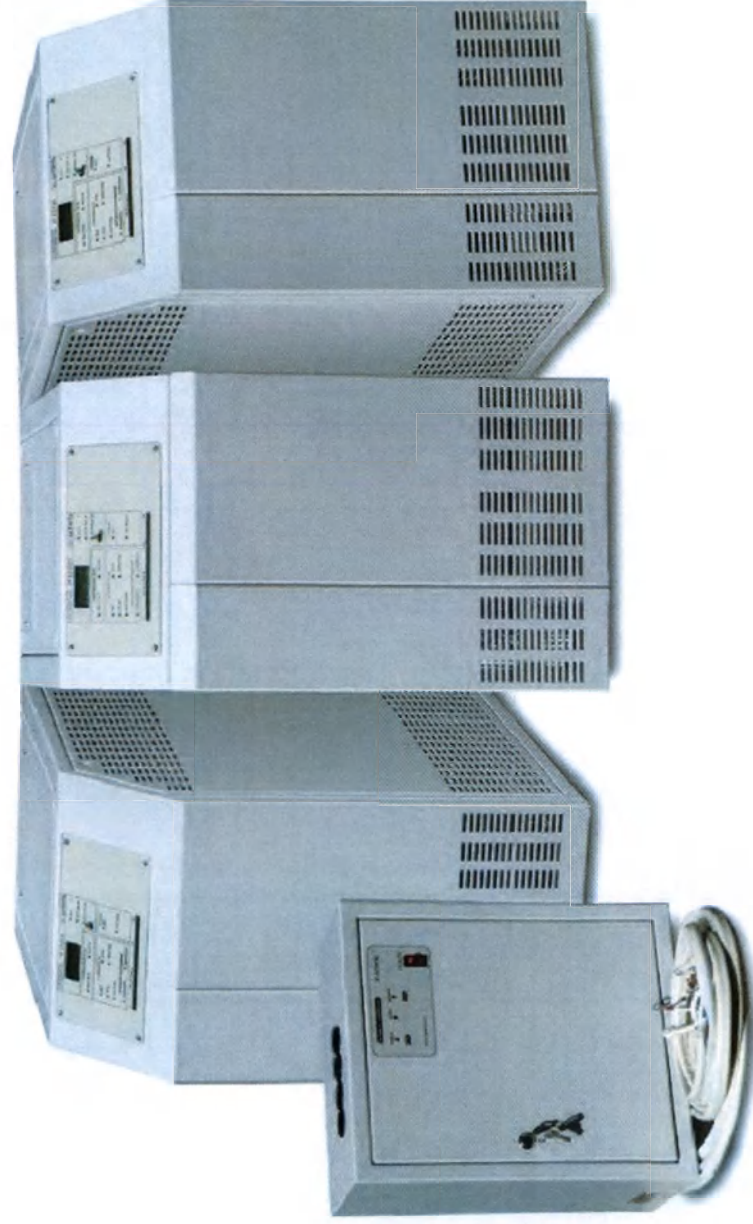



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 38 листов
(подпись)
Директор ЗАО «АЗРТ»

Н.Е. Станкевич

ЗАО «АЗРТ», РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Аппарат рентгеновский диагностический цифровой

«ГРАФИКС- Ц»


Макеты маркировки и упаковки

Фотографические изображения

**Макет маркировочной таблички аппарата
рентгеновского диагностического цифрового
«ГРАФИКС-Ц»**

 ЗАО «АЗРТ»	
 Россия, 143360, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул. Ленина, д.4	
Аппарат рентгеновский диагностический цифровой «ГРАФИКС-Ц»	
Исполнение _	
SN XX-07.XXX	 XX XXXX
380 В 50Гц 80кВ·А	  3N ~ IP20
ТУ 9442-005-99122688-2013	

Расположение маркировочной таблички аппарата «ГРАФИКС-Ц».

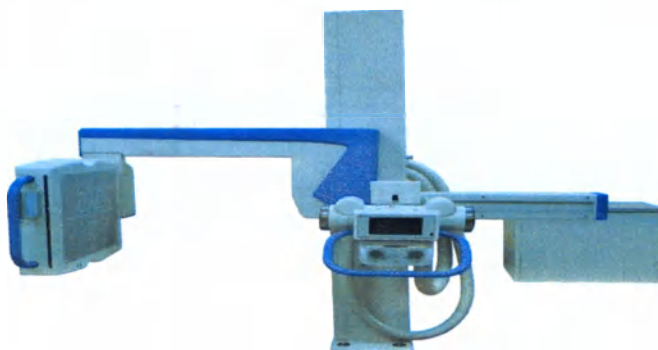

 ЗАО «АЗРТ»	
 Россия, 143360, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул. Ленина, д.4	
Аппарат рентгеновский диагностический цифровой «ГРАФИКС-Ц»	
Исполнение _	
SN XX-07.XXX	 XX XXXX
380 В 50Гц 80кВ·А	  3N ~ IP20
ТУ 9442-005-99122688-2013	

Макеты первичной и вторичной упаковки

Макеты первичной и вторичной упаковки составных частей аппарата рентгеновского диагностического цифрового «ГРАФИКС-Ц», (Исполнение 1).

Информационные манипуляционные знаки транспортной тары аппарата.

Информация с нумерацией, количеством упаковочных мест и их составом указаны на упаковочных листах каждого транспортного места аппарата.

Состав упаковочных мест согласно комплектации «ГРАФИКС-Ц» (Исполнение 1):

Место № 1

поз.1 Устройство рентгеновское питающее УРПвч-«АЗРТ»;

поз.7 Дозиметр рентгеновского излучения клинический;

поз.8 Излучатель рентгеновский;

поз.9 Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов;

поз.10 Растр рентгеновский отсеивающий;

поз.12 Комплект эксплуатационной документации на аппарат «ГРАФИКС-Ц» (Исполнение 1) в составе: руководство по эксплуатации, паспорт, ведомость эксплуатационных документов;

Место №2.

поз.2 Штатив снимков с Электронной системой управления(поз.4)

поз.3 Диафрагма;

Место №3.

поз.2 Штатив снимков

Место №4.

поз.11.1 Каталка рентгенографическая.

Место №5

поз.6 Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ-«АККОРД»

поз.11.2 Система дистанционного видеонаблюдения;

поз.11.3 Переговорное устройство.

Место №6.

поз.5 Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения с устройством обработки рентгеновского изображения: 1717 SCC.





Место №7

поз.11.4 Стабилизатор напряжения переменного тока.

Сводный упаковочный лист:

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (Сводный)		Номер документа	Дата составления
		A20-07.005	26.03.2020
АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ «ГРАФИКС-Ц» (исполнение 1) A20-07.005			
<u>Договор</u>			
<u>Продавец:</u>		ЗАО «АЗРТ» (г.Апрелевка)	
		(организация, адрес)	
<u>Покупатель:</u>			
		(организация, адрес)	

№№ упаковоч- ных мест	Состав упаковочных мест (наименование/обозначение)	НОМЕР серийный (заводской)	Ед. изм.	Кол-во
1	Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРПвч - "АЗРТ"	A20-013.001	шт.	1
	Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, 1 камера	1806	шт.	1
	Излучатель рентгеновский диагностический С40/Х42	24V010	шт.	1
	Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты КИРЗИ – «Р-К»:		компл	1
	Растр рентгеновский отсеивающий		шт.	1
	Комплект эксплуатационной документации "ГРАФИКС-Ц"		шт.	1
2	Штатив снимков		шт.	1
	Электронная система управления		компл	1
	Диафрагма		шт.	1
3	Штатив снимков		шт.	1
4	Каталка рентгенографическая		шт.	1
5	Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ- "АККОРД"	A20-05.035	компл	1
	Переговорное устройство		шт.	1
	Система дистанционного видеонаблюдения		компл	1
6	Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения	LRR020020066	шт.	1
7	Стабилизатор напряжения переменного тока		компл (шт.)	1 (3)

Упаковано,кладовщик	 (подпись)	 (расшифровка подписи)
Проверено,инженер ОТК	 (подпись)	 (расшифровка подписи)


Место № 1


Состав упаковочного места:

1. Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРПвч-«АЗРТ»;
 - 1.1 Пульт управления
 - 1.2 Блок генератора
 - 1.3 Кабель стыковки генератора с пультом управления
2. Излучатель рентгеновский диагностический С40/Х42
3. Растр рентгеновский отсеивающий
4. Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, 1 камера
5. Комплект соединительных кабелей, в составе:
 - 5.1 Силовой кабель ПВС 5Х10, длиной 15м
 - 5.2 Кабель разгон анода МКЭШ 3х0.75, длиной 13м
 - 5.3 Кабель заземления ПВ-3-6, длиной 10м
 - 5.4 Кабель термодатчика КСПЭВГ 2х0.2, длиной 13м
 - 5.5 Высоковольтные кабели с наконечниками МЭК/МЭК, длиной 12 м
6. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты КИРЗИ – «Р-К»:
 - 6.1 Воротник рентгенозащитный
 - 6.2 Фартук рентгеновский односторонний
 - 6.3 Комплект защитных пластин (4 пред.)
 - 6.4 Юбка рентгенозащитная
7. Комплект документов, в составе:
 - 7.1 Руководство по эксплуатации УРПвч-"АЗРТ"
 - 7.2 Паспорт Аппарат рентгеновский диагностический цифровой «Графикс-Ц»
 - 7.3 Руководство по эксплуатации Аппарат рентгеновский диагностический цифровой "Графикс-Ц"
 - 7.4 Схемы электрические подключения
 - 7.5 Протокол приемо-сдаточных испытаний
 - 7.6 Декларация о соответствии на Аппарат рентгеновский диагностический цифровой "Графикс-Ц"
 - 7.7 Руководство по эксплуатации УЦОИ "АККОРД"
 - 7.8 Паспорт УЦОИ "АККОРД"
 - 7.9 Журнал технического обслуживания на Аппарат рентгеновский диагностический цифровой "Графикс-Ц"



УРПвч-«АЗРТ»

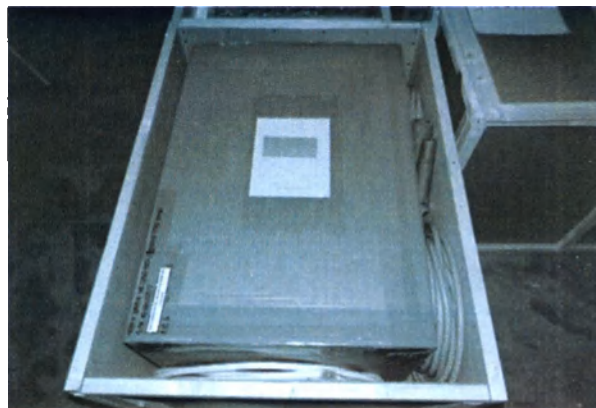

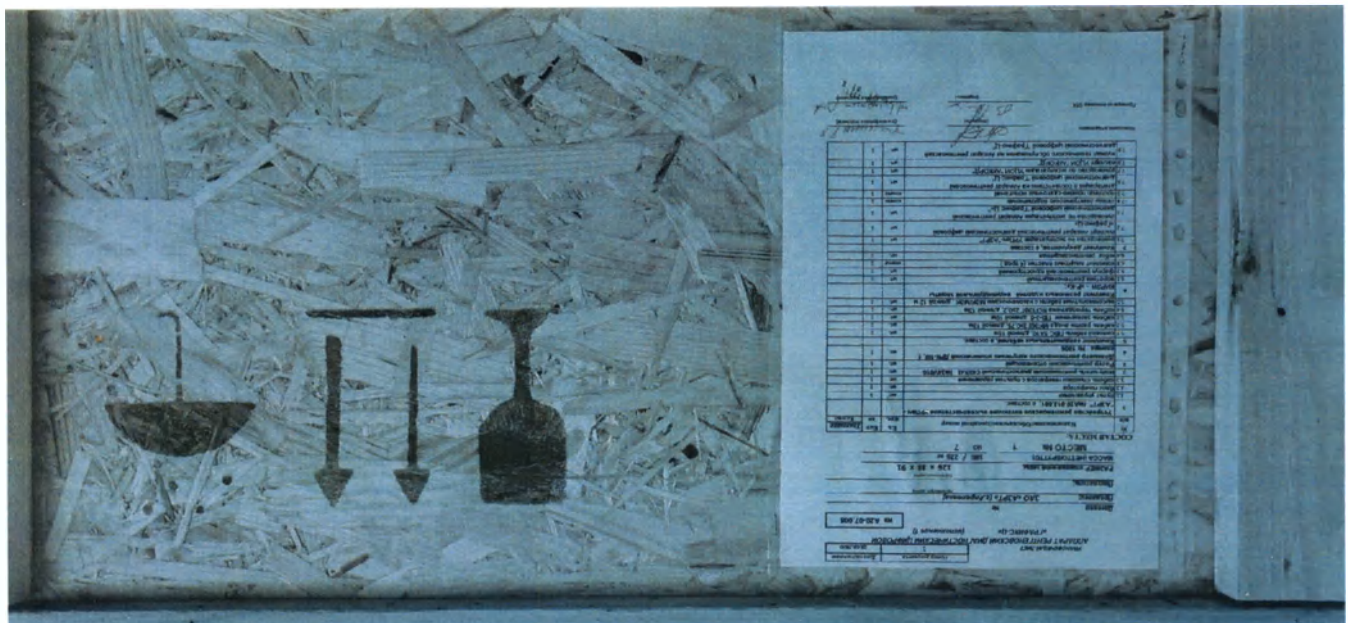

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ
АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ
«ГРАФИКС-Ц» (исполнение 1)

Номер документа	Дата составления
1	26.03.2020

№ А20-07.005

Договор № _____

Продавец: ЗАО «АЗРТ» (г.Апрелевка)
(организация, адрес)

Покупатель: _____
(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары 126 x 88 x 91

МАССА (НЕТТО/БРУТТО) 180 / 226 кг

МЕСТО № 1 **из** 7

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Наименование/Обозначение/заводской номер	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано Кол-во
1	Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРПвч - "АЗРТ" №А20-013.001, в составе:			
1.1	пульт управления	шт.	1	
1.2	блок генератора	шт.	1	
1.3	кабель стыковки генератора с пультом управления	шт.	1	
2	Излучатель рентгеновский диагностический С40/Х42 №24V010	шт.	1	
3	Растр рентгеновский отсеивающий	шт.	1	
4	Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, 1 камера № 1806	шт.	1	
5	Комплект соединительных кабелей, в составе:			
5.1	силовой кабель ПВС 5Х10, длиной 15м	шт.	1	
5.2	кабель разгон анода МКЭШ 3х0.75, длиной 13м	шт.	1	
5.3	кабель заземления ПВ-3-6, длиной 10м	шт.	1	
5.4	кабель термодатчика КСПЭВГ 2х0.2, длиной 13м	шт.	1	
5.5	высоковольтные кабели с наконечниками МЭК/МЭК, длиной 12 м	шт.	2	
6	Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты КИРЗИ - «Р-К»:			
6.1	воротник рентгенозащитный	шт.	1	
6.2	фартук рентгеновский односторонний	шт.	1	
6.3	комплект защитных пластин (4 пред.)	компл	1	
6.4	юбка рентгенозащитная	шт.	1	
7	Комплект документов, в составе:			
7.1	руководство по эксплуатации УРПвч-"АЗРТ"	шт.	1	
7.2	паспорт Аппарат рентгеновский диагностический цифровой «Графикс-Ц»	шт.	1	
7.3	руководство по эксплуатации Аппарат рентгеновский диагностический цифровой "Графикс-Ц"	шт.	1	
7.4	схемы электрические подключения	компл	1	
7.5	протокол приемо-сдаточных испытаний	компл	1	
7.6	декларация о соответствии на Аппарат рентгеновский диагностический цифровой "Графикс-Ц"	шт.	1	
7.7	руководство по эксплуатации УЦОИ "АККОРД"	шт.	1	
7.8	паспорт УЦОИ "АККОРД"	шт.	1	
7.9	журнал технического обслуживания на Аппарат рентгеновский диагностический цифровой "Графикс-Ц"	шт.	1	

Упаковано,кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено,инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Место №2.



Состав упаковочного места:

1. Штатив снимков:

- 1.1 Траверса (манипулятор);
- 1.2 Узел крепления блока источника рентгеновского излучения с пультом управления;
- 1.3 Решетка снимков с пультом дистанционного управления;
- 1.4 Т-шасси крепления траверсы (манипулятора);
- 1.5 Комплект соединительных кабелей;
- 1.6 Электронная система управления.

2. Диафрагма;

3. ЗИП

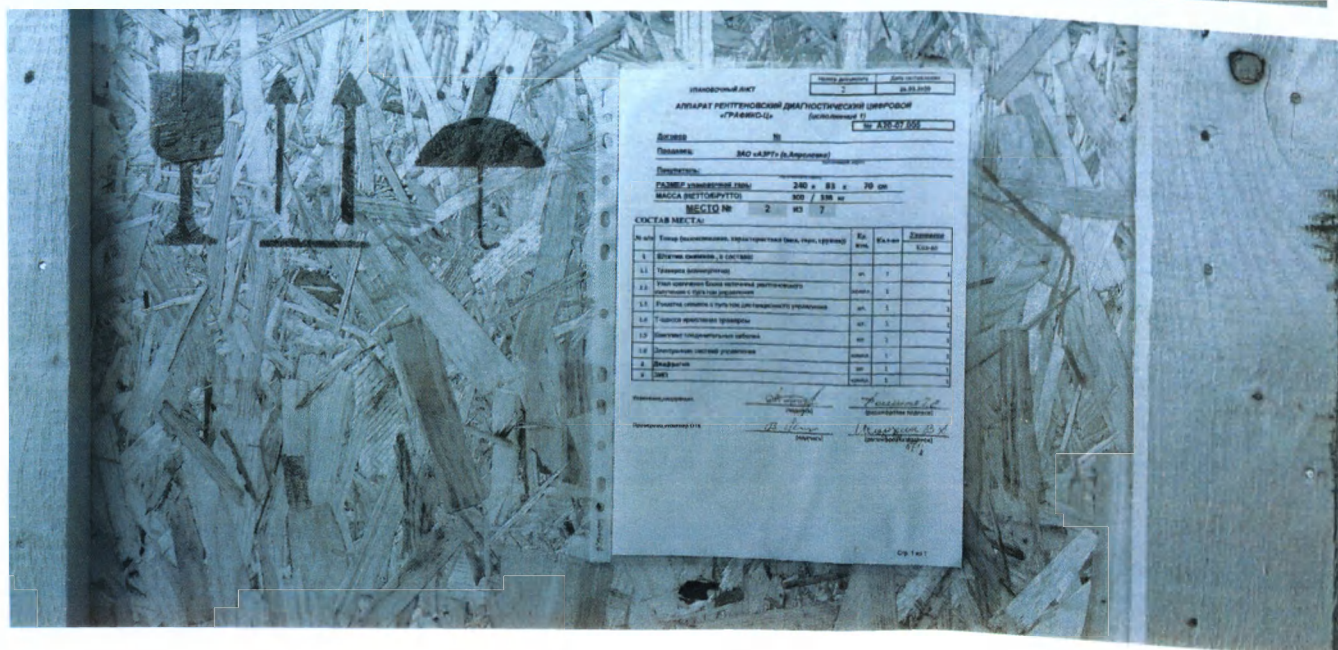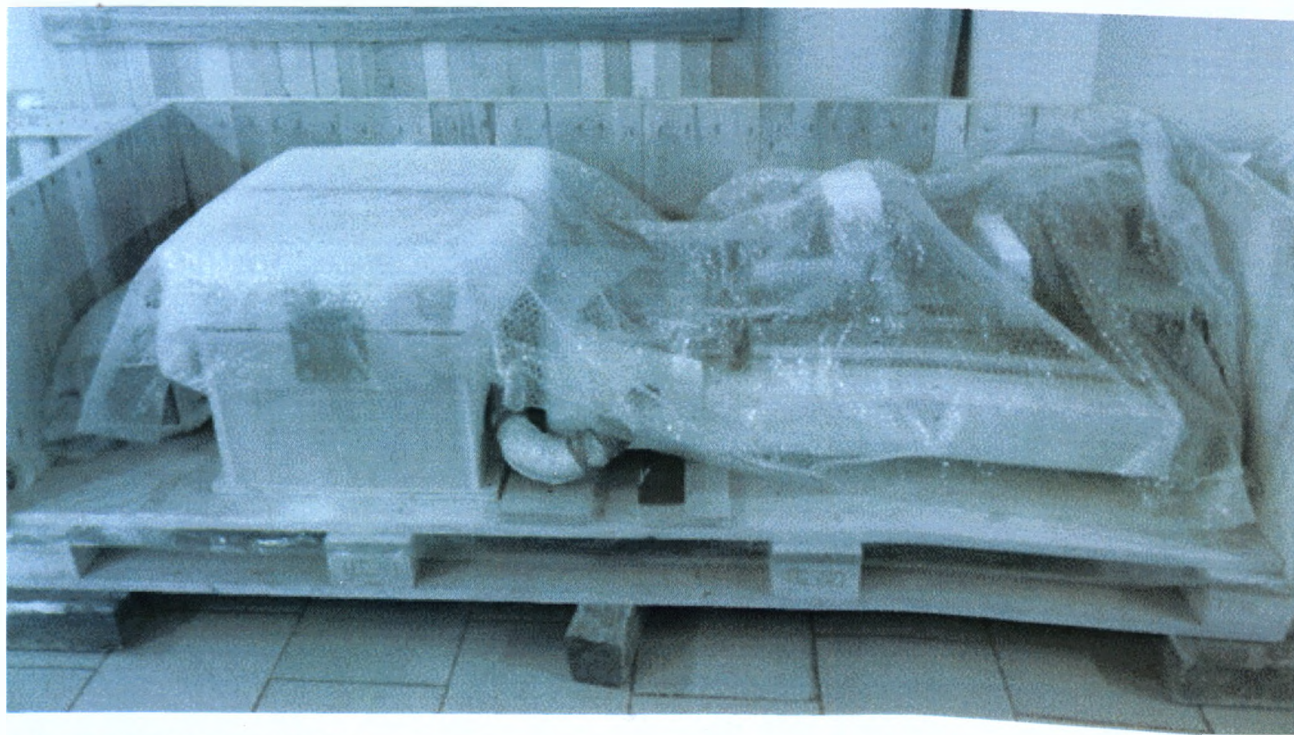

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
2	26.03.2020

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ
«ГРАФИКС-Ц» (исполнение 1)

№ А20-07.005

Договор

№

Продавец:

ЗАО «АЗРТ» (г.Апрелевка)

(организация, адрес)

Покупатель:

(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары

240 x 83 x 70 см

МАССА (НЕТТО/БРУТТО)

300 / 338 кг

МЕСТО №

2

из

7

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Штатив снимков, в составе:			
1.1	Траверса (манипулятор)	шт.	1	1
1.2	Узел крепления блока источника рентгеновского излучения с пультом управления	компл.	1	1
1.3	Решетка снимков с пультом дистанционного управления	шт.	1	1
1.4	Т-шасси крепления траверсы	шт.	1	1
1.5	Комплект соединительных кабелей	шт.	1	1
1.6	Электронная система управления	компл.	1	1
2	Диафрагма	шт.	1	1
3	ЗИП	компл.	1	1

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Стр. 1 из 1

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
3	26.03.2020

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ
«ГРАФИКС-Ц» (исполнение 1)

№ А20-07.005

Договор№Продавец:

ЗАО «АЗРТ» (г.Апрелевка)

(организация, адрес)

Покупатель:

(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары 219 х 89 х 62 см



МАССА (НЕТТО/БРУТТО) 238 / 298 кг

МЕСТО № 3 из 7



СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Штатив снимков, в составе:			
1.1	Колонна штатива снимков	шт.	1	1
1.2	Декоративный кожух	шт.	2	2
1.3	Задняя панель колонны	шт.	1	1
1.4	Плита монтажная 10x700x1000	шт.	1	1
2	Короб электромонтажный 2000x80x40 мм	шт.	2	2

Упаковано, кладовщик


(подпись)
(расшифровка подписи)


Проверено, инженер ОТК


(подпись)
(расшифровка подписи)

Место №4.

Состав упаковочного места:

1. Каталка рентгенографическая.

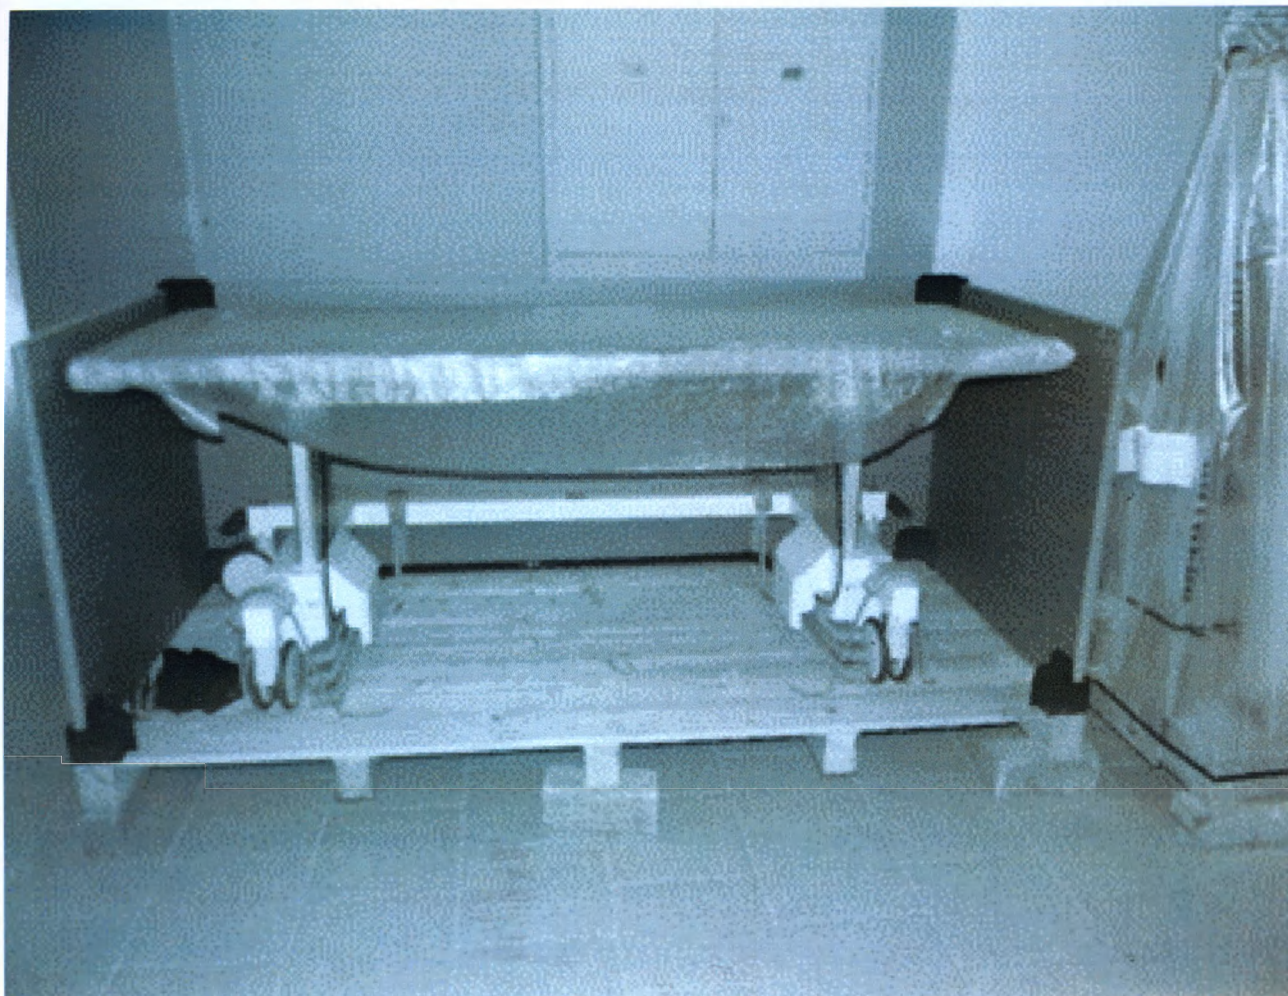

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
4	26.03.2020

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ
«ГРАФИКС-Ц» (исполнение 1) № А20-07.005

Договор №

Продавец: ЗАО «АЗРТ» (г.Апрелево)

Покупатель:

РАЗМЕР упаковочной тары 216 x 82 x 45 см

МАССА (НЕТТО/БРУТТО) 132 / 162 кг

МЕСТО № 4 ИЗ 7

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристики (мат. сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковка
1	Каталка рентгенографическая	шт.	1	1
ИТОГО			1	1

Уполномоченный:

Претензий, исключений нет

В. М. (подпись)

В. М. (подпись)



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
4	26.03.2020

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ
«ГРАФИКС-Ц» (исполнение 1)

№ А20-07.005

Договор№Продавец:

ЗАО «АЗРТ» (г.Апрелевка)

(организация, адрес)

Покупатель:

(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары 216 х 82 х 45 см



МАССА (НЕТТО/БРУТТО) 132 / 162 кг

МЕСТО № 4 из 7



СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Каталка рентгенографическая	шт.	1	1
ИТОГО			1	1

Упаковано, кладовщик


(подпись)
(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК


(подпись)
(расшифровка подписи)

Стр. 6 из 9

Место №5

Состав упаковочного места:



1. Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ-«АККОРД»:

- 1.1 Монитор (коробка №1);
- 1.2 Комплекс средств управления на базе РС компьютера (коробка №2);
- 1.3 ПО Аккорд-Амиго, версия 5,5;
- 1.4 Источник бесперебойного питания (коробка №3)

2. Комплект коммутационного оборудования;

3. Переговорное устройство;

4. Система дистанционного видеонаблюдения.

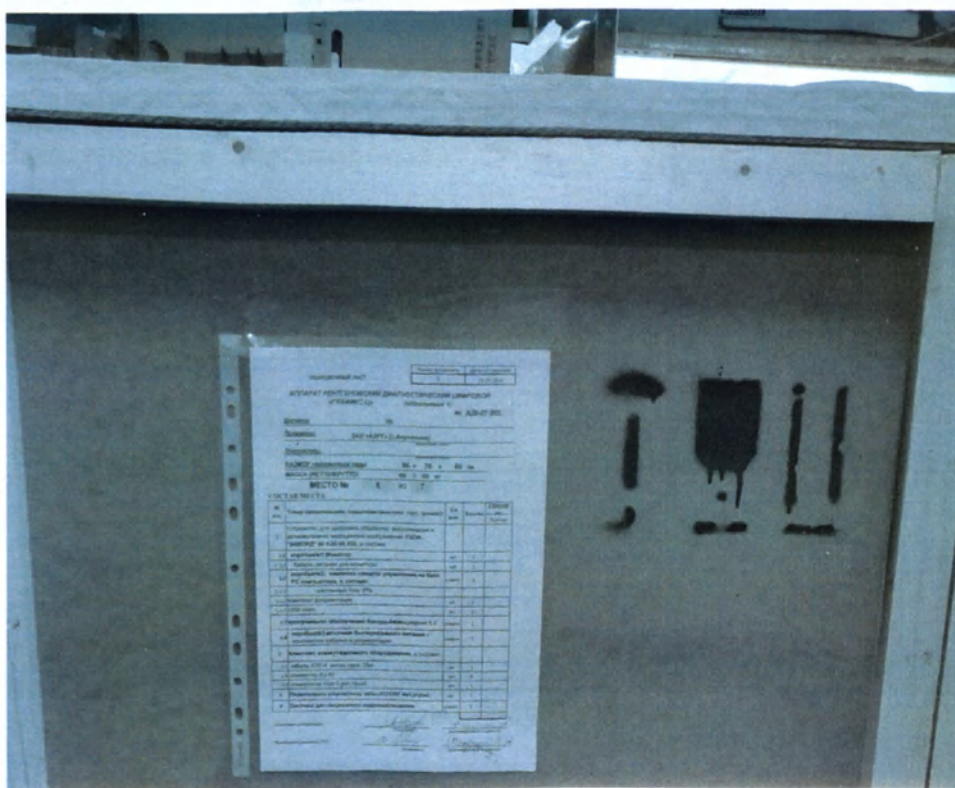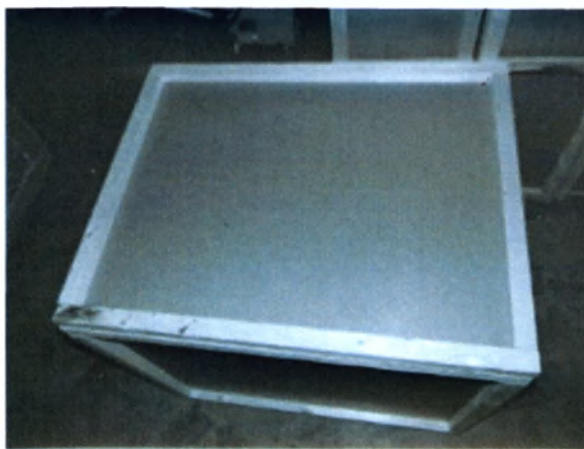

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
5	26.03.2020

**АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ
«ГРАФИКС-Ц»**

(исполнение 1)

№ А20-07.005

Договор№Продавец:

ЗАО «АЗРТ» (г.Апрелевка)

(организация, адрес)

Покупатель:

(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары

96 x 76 x 86 см

МАССА (НЕТТО/БРУТТО)

40 / 60 кг

МЕСТО №

5

из

7

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упакова на
				Кол-во
1	Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ- "АККОРД" № А20-05.035, в составе:			
1.1	коробка №1: Монитор	шт.	1	
1.1.1	Кабель питания для монитора	шт.	1	
1.2	коробка №2: комплекс средств управления на базе РС компьютера, в составе:	компл.	1	
1.2.1	системный блок 2Тb			
1.2.2	комплект документации	шт.	1	
1.2.3	USB ключ	шт.	1	
1.3	программное обеспечение Аккорд-Амиго, версия 5.5	компл.	1	
1.4	коробка №3: источник бесперебойного питания с комплект кабелей и документации	компл.	1	
2	Комплект коммутационного оборудования, в составе:			
2.1	кабель STP-4 витая пара, 25м	шт.	1	
2.2	коннектор RJ-45	шт.	8	
2.3	коммутатор Hub 5 port Upvel	шт.	1	
3	Переговорное устройство (с кабел. КСПЭВГ 4х0,2=20м)	шт.	1	
4	Система дистанционного видеонаблюдения	компл.	1	

Упаковано, кладовщик

Проверено, инженер ОТК


(подпись)
(подпись)

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Место №6.

Состав упаковочного места:

1. Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения с устройством обработки рентгеновского изображения: 1717 SCC.

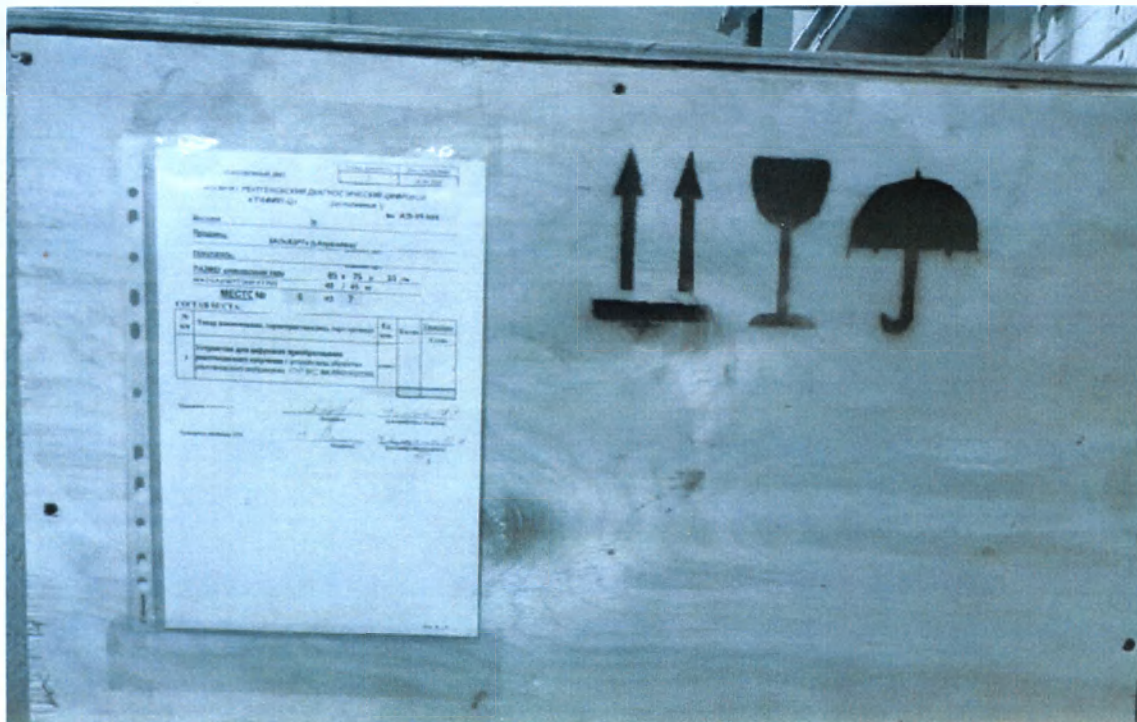

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
7	26.03.2020

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ
«ГРАФИКС-Ц» (исполнение 1)

№ А20-07.005

Договор №

Продавец: ЗАО «АЗРТ» (г.Апрелевка)

(организация, адрес)

Покупатель:

(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары 85 x 75 x 33 см

МАССА (НЕТТО/БРУТТО) 40 / 45 кг

МЕСТО № 6 ИЗ 7

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковано
				Кол-во
1	Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения с устройством обработки рентгеновского изображения: 1717 SCC №LRR020020066	компл	1	1

Упаковано, кладовщик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Стр. 8 из 9

Место №7

Состав упаковочного места:

1. Стабилизатор напряжения переменного тока.





УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
8	26.03.2020

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ
«ГРАФИКС-Ц» (исполнение 1)
№ A20-07.005

Договор № _____

Продавец: ЗАО «АЗРТ» (г.Апрелевка)
(организация, адрес)

Покупатель: _____
(организация, адрес)

РАЗМЕР упаковочной тары _____

МАССА (НЕТТО/БРУТТО) _____

МЕСТО № 7 из 7

СОСТАВ МЕСТА:

№ п/п	Товар (наименование, характеристика (вид, сорт, группа))	Ед. изм.	Кол-во	Упаковка
				Кол-во
1	Стабилизатор напряжения переменного тока	компл	1	3
ИТОГО			1	3

Упаковано, кладовщик _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Проверено, инженер ОТК _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 19 листов
(св. 1-19)
Директор ЗАО «ЗРТ»

Н.Е. Станкевич