

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»

Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1

Комплект 1 (общий вид)



Набор реагентов
«ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»

Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1
Комплект 1 (вид сбоку)

"Для профессионального применения". "Не стерильно".
"Реагенты, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы. Антитела к ВИЧ-1,2 (за исключением реагента К⁺_{АТ}), вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют".

Состав набора

Комплект 1



1 планшет	
1 Иммуносорбент	
2 Конъюгат - 1	1 фл. 1,2 мл
3 Конъюгат - 2	1 фл. 2,0 мл
4 РРК - 1	1 фл. 12,0 мл
5 РРК - 2	1 фл. 20,0 мл
6 К ⁺ _{АТ} , инаktivированный	1 фл. 2,0 мл
7 К ⁺ _{АТ} , инаktivированный	1 фл. 2,0 мл
8 К-, инаktivированный	1 фл. 2,5 мл
9 ПР	1 фл. 50,0 мл
10 Стоп-реагент	1 фл. 25,0 мл
11 СБ	1 фл. 25,0 мл
12 ТМБ	1 фл. 2,5 мл

Принадлежности

Крышка к полистироловым 96-луночным планшетам (1 шт.) или пленки защитные для ИФА планшетов (2 шт.), наконечники одноразовые (10 шт.), ванночки пластиковые для жидких реагентов (2 шт.), пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.).




Набор реагентов

«ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»

Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека

1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1

Комплект 1 (вид сбоку)

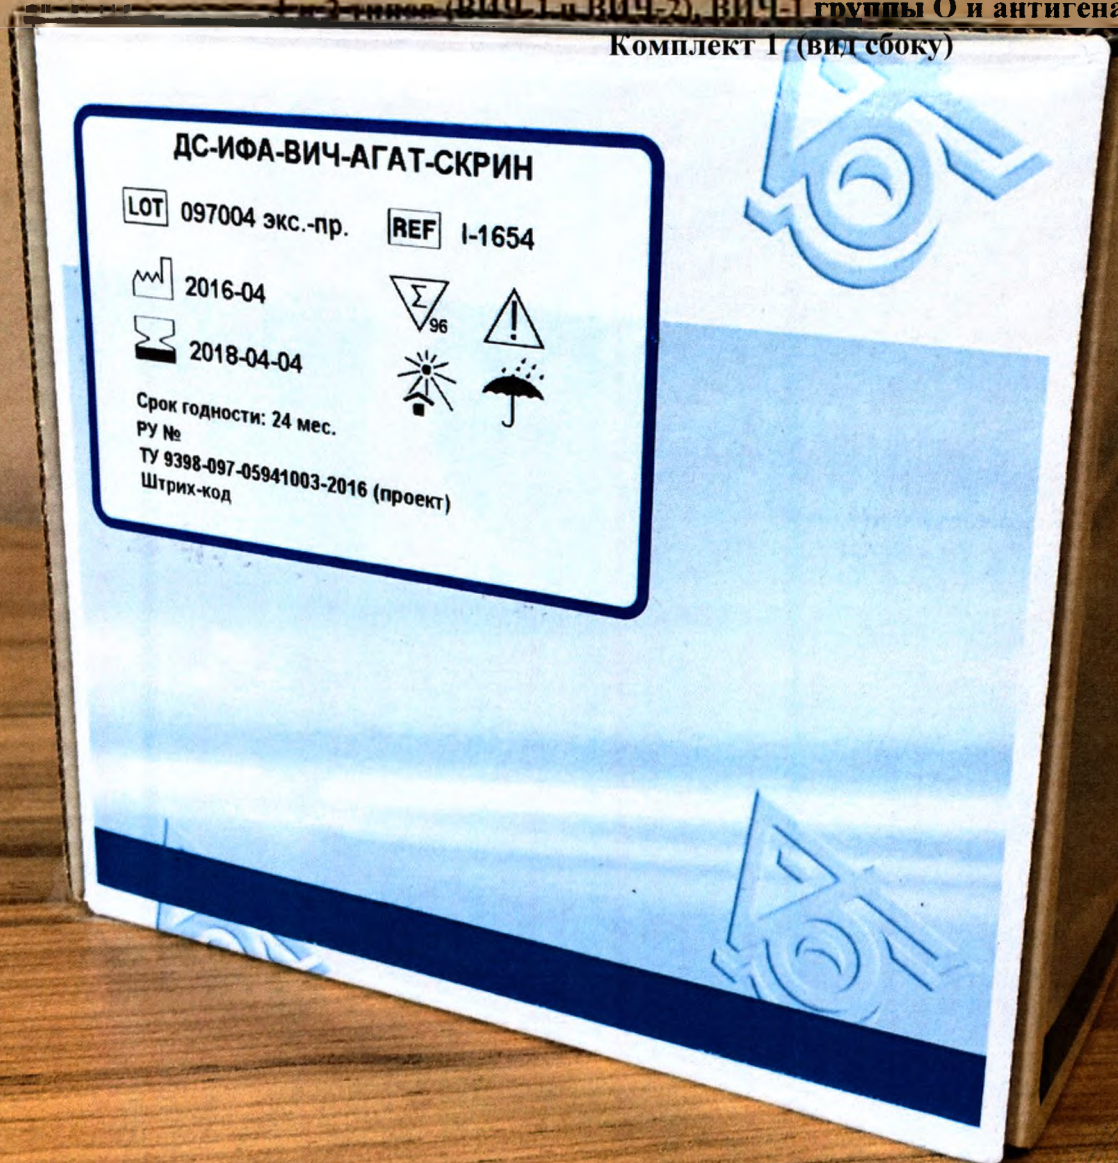

ООО «НПО «Диагностические системы»
Набор реагентов
«ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»
Тест-система иммуноферментная
для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2),
ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1
Комплект 1 (вид сбоку)



Набор реагентов
«ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»

Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1
Комплект 2 (общий вид)



**Набор реагентов
«ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»**

**Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1
Комплект 2 (вид сбоку)**

"Для профессионального применения". "Не стерильно".
"Реагенты, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инактивированы. Антитела к ВИЧ-1,2 (за исключением реагента К_{АТ}), вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют".

Состав набора

Комплект 2



		2 планшета	
1	Иммуносорбент		
2	Конъюгат - 1	1 фл.	1,2 мл
3	Конъюгат - 2	1 фл.	2,0 мл
4	РРК - 1	1 фл.	12,0 мл
5	РРК - 2	1 фл.	20,0 мл
6	К _{АТ} , инактивированный	1 фл.	2,0 мл
7	К _{АГ} , инактивированный	1 фл.	2,0 мл
8	К-, инактивированный	1 фл.	2,5 мл
9	ПР	1 фл.	120,0 мл
10	Стоп-реагент	2 фл.	25,0 мл
11	СБ	1 фл.	25,0 мл
12	ТМБ	1 фл.	2,5 мл

Принадлежности:

Крышки к полистироловым 96-луночным планшетах (2 шт.) или пленки защитные для ИФА-планшетов (4 шт.), наконечники одноразовые (32 шт.), ванночки пластиковые для жидких реагентов (4 шт.), пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock (2 шт.).

Набор реагентов
«ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»

Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека
1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1

Комплект 2 (вид сбоку)



ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов
«ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»

Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека
1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1
Комплект 2 (вид сбоку)



Набор реагентов

«ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»

Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1

Комплект 3 (общий вид)



**Набор реагентов
«ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»**

**Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека
1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1
Комплект 3 (вид сбоку)**

Состав набора

Комплект 3


5 планшетов	
1 Иммуносорбент	1 фл. 3,6 мл
2 Конъюгат - 1	или 3 фл. 1,2 мл
3 Конъюгат - 2	1 фл. 4,0 мл
4 РРК - 1	или 2 фл. 2,0 мл
5 РРК - 2	3 фл. 12,0 мл
6 К _{ag} , инактивированный	2 фл. 20,0 мл
7 К _{ag} , инактивированный	1 фл. 4,0 мл
8 К-, инактивированный	или 2 фл. 2,0 мл
9 ПР	1 фл. 5,0 мл
10 Стоп-реагент	или 2 фл. 2,5 мл
11 СБ	2 фл. 120,0 мл
12 ТМБ	2 фл. 50,0 мл
	или 4 фл. 25,0 мл
	2 фл. 50,0 мл
	или 3 фл. 25,0 мл
	2 фл. 3,5 мл
	или 3 фл. 2,5 мл

Приведенности

Крышки к полистироловым 96-луночным планшетам (5 шт.) или пленки защитные для ИФА-плашетов (10 шт.); изопропиловый одноразовый (90 шт.), флакончик пластиковые для индент-реагентов (10 шт.); пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock (3 шт.).

Набор реагентов
«ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»

Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека
1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1
Комплект 3 (вид сбоку)

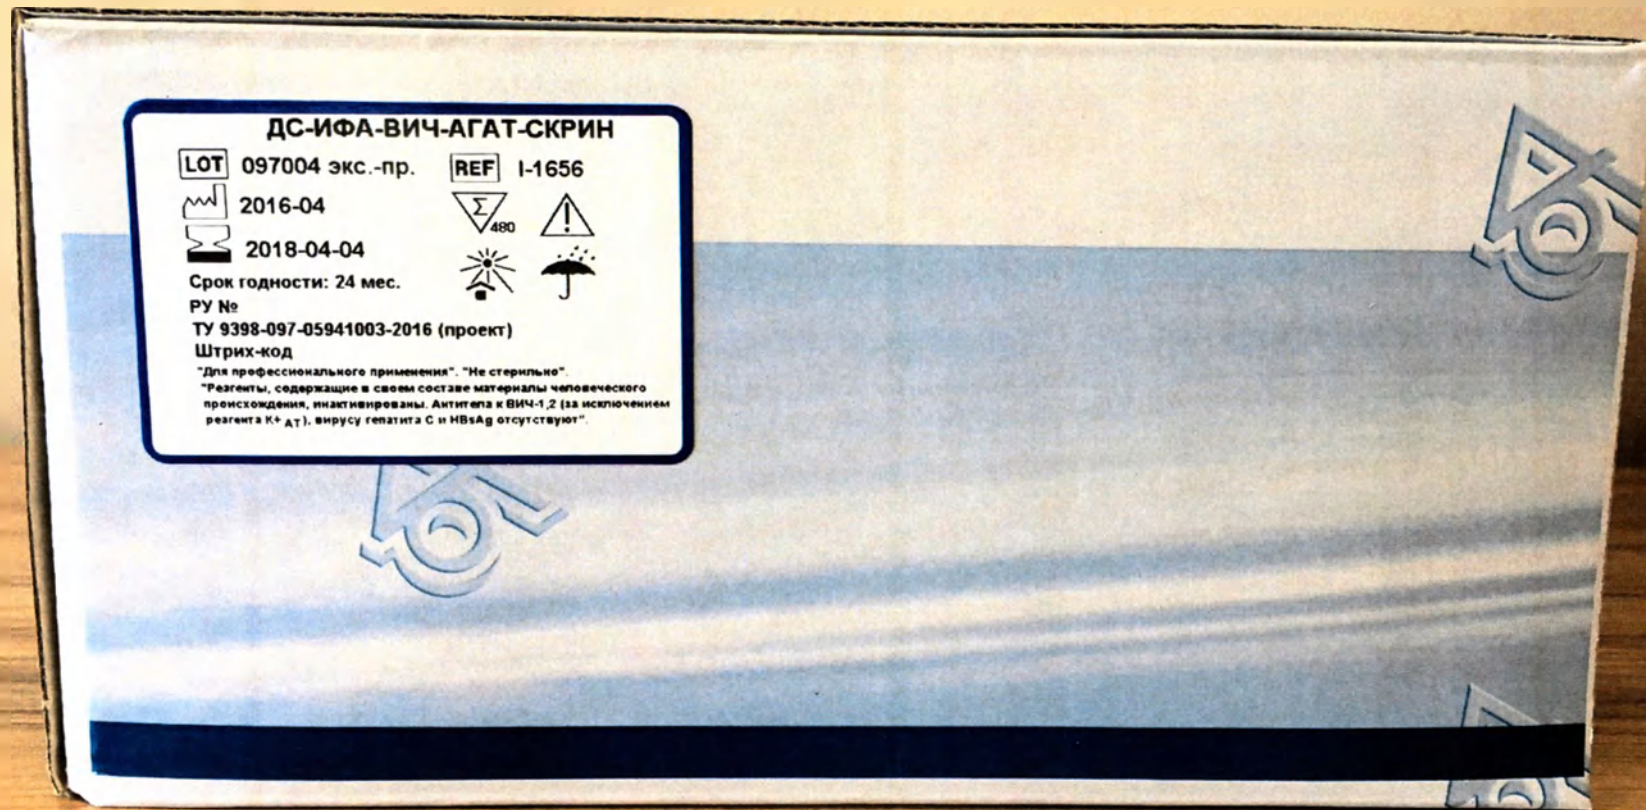

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»

Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1

Комплект 3 (вид сбоку)



Набор реагентов

«ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»

Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1

Вскрытый иммуносорбент



Набор реагентов
«ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»

Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1

Принадлежности

