


**Набор реагентов  
«ДС-ВЛК-анти-ЛЮИС»**

**Контрольный образец для внутрилабораторного контроля  
качества исследований на наличие антител  
к возбудителю сифилиса (*Treponema pallidum*)**

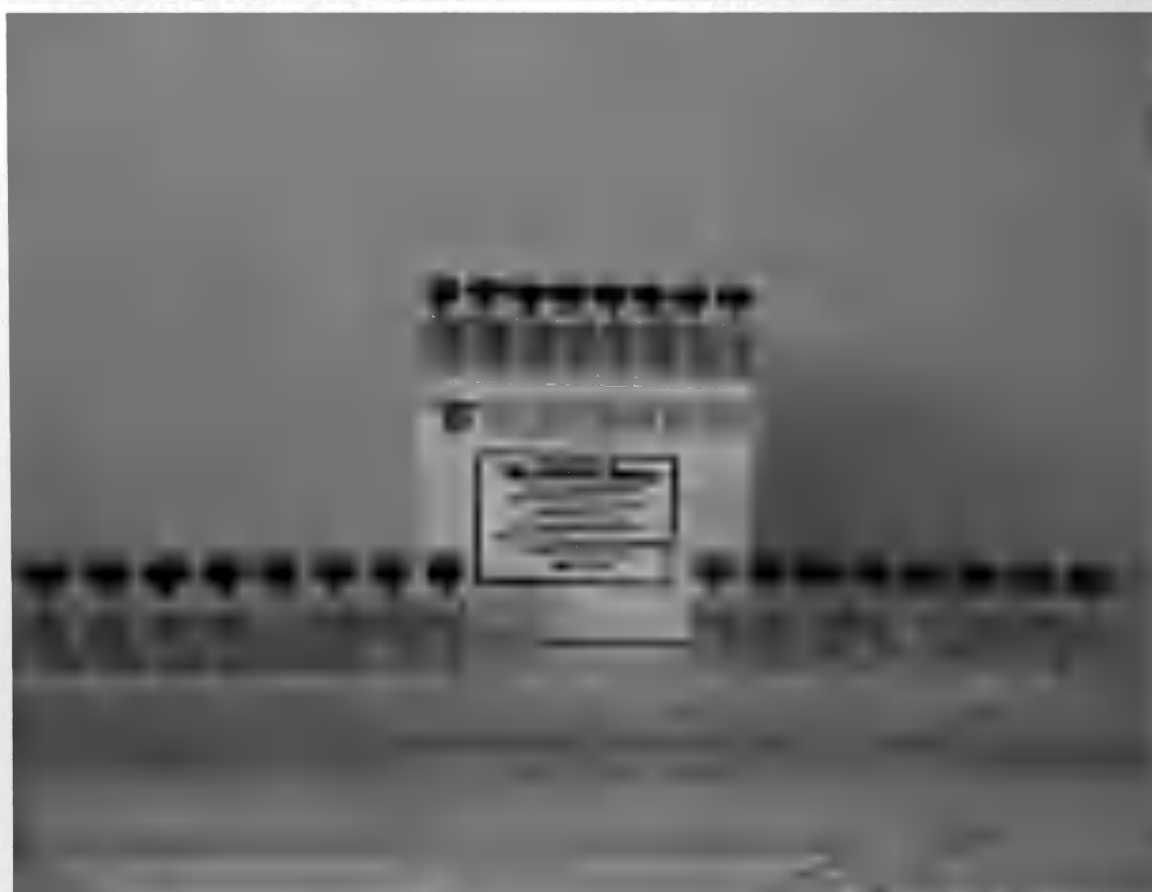

Заместитель генерального директора  
ООО «Научно производственное объединение

«Диагностические системы»  
О. Н. Шлюндин  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012г.