



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 сентября 2021 года № РЗН 2021/15318

На медицинское изделие

Печь стоматологическая компьютеризированная для синтеризации

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Аманн Гиррбах АГ", Австрия,

Amann Girrbach AG, Herrschaftswiesen 1, 6842 Koblach, Austria

Производитель

"Аманн Гиррбах АГ", Австрия,

Amann Girrbach AG, Herrschaftswiesen 1, 6842 Koblach, Austria

Место производства медицинского изделия

Amann Girrbach AG, Schweizerstrasse 96, 6830 Rankweil, Austria

Номер регистрационного досье № РД-43056/52197 от 30.07.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.22.140**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 17 сентября 2021 года № 8785
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0058786

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 сентября 2021 года № РЗН 2021/15318

Лист 1

На медицинское изделие

**Печь стоматологическая компьютеризированная для синтеризации,
в вариантах исполнения:**

I. Печь для синтеризации диоксида циркония Ceramill Therm 3, в составе:

1. Печь для синтеризации диоксида циркония Ceramill Therm 3.
2. Стержень нагревательный - 4 шт.
3. Чаша агломерационная.
4. Щипцы.
5. Бисер циркониевый, 200 г/уп.
6. Кабель, 3 м.
7. Ключ для монтажа шестигранный - 2 шт.
8. Инструкция.

II. Печь для синтеризации диоксида циркония Straumann Therm, в составе:

1. Печь для синтеризации диоксида циркония Straumann Therm.
2. Стержень нагревательный - 4 шт.
3. Чаша агломерационная.
4. Щипцы.
5. Бисер циркониевый, 200 г/уп.
6. Кабель, 3 м.
7. Ключ для монтажа шестигранный - 2 шт.
8. Инструкция.


III. Печь для синтеризации диоксида циркония IDC T1 Zi, в составе:

1. Печь для синтеризации диоксида циркония IDC T1 Zi.
2. Стержень нагревательный - 4 шт.
3. Чаша агломерационная.
4. Щипцы.
5. Бисер циркониевый, 200 г/уп.
6. Кабель, 3 м.
7. Ключ для монтажа шестигранный - 2 шт.
8. Инструкция.

IV. Печь для синтеризации кобальт-хромового сплава Ceramill Argotherm 2, в составе:

1. Печь для синтеризации кобальт-хромового сплава Ceramill Argotherm 2.
2. Стержень нагревательный - 4 шт.
3. Регулятор давления.
4. Кабель, 3 м.
5. Ключ для монтажа шестигранный - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

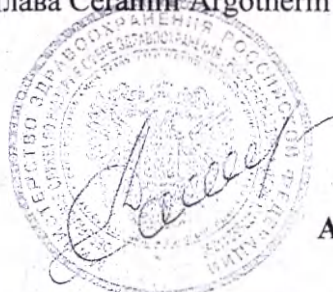

А.В. Самойлова

0089838

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 сентября 2021 года № РЗН 2021/15318

Лист 2

6. Набор для камеры Ceramill Argovent 2, в составе:

- основание для камеры;
- основа агломерационная;
- чаша агломерационная;
- диск сепарационный;
- диск для обжига;
- крышка для обжига;
- реторта агломерационная;
- груз реторты;
- щипцы;
- бисер циркониевый, 150 г/уп.;
- порошок циркониевый, 10 г/уп.;
- шланг для подачи газа внутри печи;
- шланг для подачи газа/сжатого воздуха - 2 шт.

7. Инструкция.

V. Печь для синтеризации кобальт-хромового сплава Straumann Argotherm, в составе:

1. Печь для синтеризации кобальт-хромового сплава Straumann Argotherm.

2. Стержень нагревательный - 4 шт.

3. Регулятор давления.

4. Кабель, 3 м.

5. Ключ для монтажа шестигранный - 2 шт.

6. Набор для камеры Ceramill Argovent 2, в составе:

- основание для камеры;
- основа агломерационная;
- чаша агломерационная;
- диск сепарационный;
- диск для обжига;
- крышка для обжига;
- реторта агломерационная;
- груз реторты;
- щипцы;
- бисер циркониевый, 150 г/уп.;
- порошок циркониевый, 10 г/уп.;
- шланг для подачи газа внутри печи;
- шланг для подачи газа/сжатого воздуха - 2 шт.

7. Инструкция.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0089339

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 сентября 2021 года № РЗН 2021/15318

Лист 3

VI. Печь для синтеризации кобальт-хромового сплава IDC T2 CoCr, в составе:

1. Печь для синтеризации кобальт-хромового сплава IDC T2 CoCr.

2. Стержень нагревательный - 4 шт.

3. Регулятор давления.

4. Кабель, 3 м.

5. Ключ для монтажа шестигранный - 2 шт.

6. Набор для камеры Ceramill Argovent 2, в составе:

- основание для камеры;

- основа агломерационная;

- чаша агломерационная;

- диск сепарационный;

- диск для обжига;

- крышка для обжига;

- реторта агломерационная;

- груз реторты;

- щипцы;

- бисер циркониевый, 150 г/уп.;

- порошок циркониевый, 10 г/уп.;

- шланг для подачи газа внутри печи;

- шланг для подачи газа/сжатого воздуха - 2 шт.

7. Инструкция.

≡

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0089340