


**Набор реагентов
«ДС-ВЛК-ВИЧ-Ag(p24)»**

Контрольный образец для внутрилабораторного контроля качества исследований на наличие антигена p24 вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1)

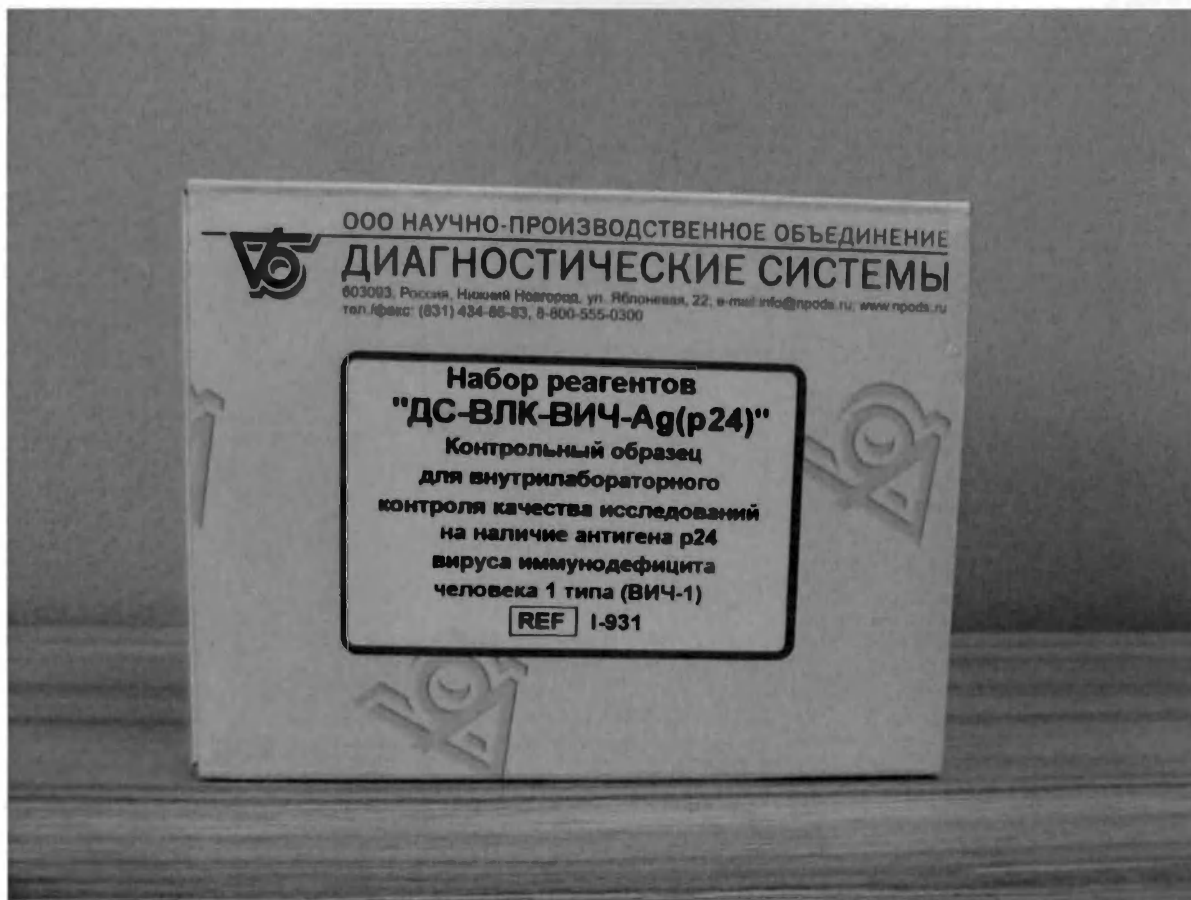

Заместитель генерального директора
ООО «Научно-производственное объединение

О. Н. Шлюндин
« » 2012г.