

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат физиотерапевтический для диатермии и текар-терапии

T-PLUS

производства

WHTcare SA, via Giuseppe Motta 10, 6830 Chiasso, Switzerland (Швейцария)

Общий вид медицинского изделия вместе с принадлежностями




Аппарат физиотерапевтический для диатермии и текар-терапии T-PLUS



Кабель питания




Держатель для электродов САР, со съемным экранированным кабелем и разъемом

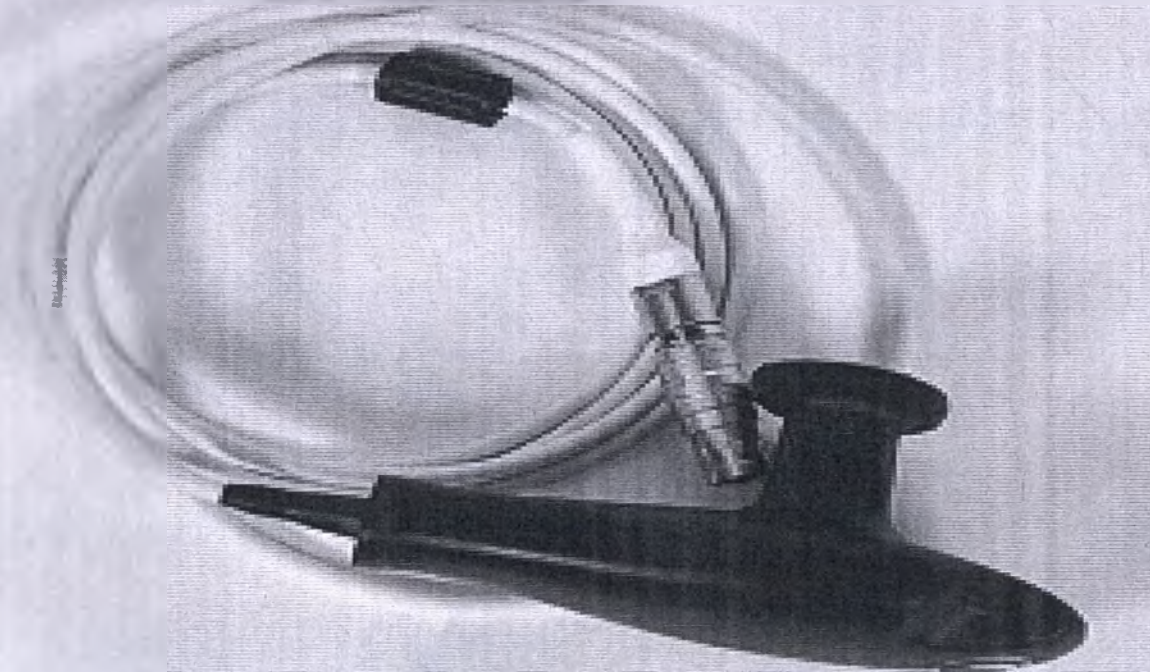


Держатель для электродов RES, со съемным экранированным кабелем и разъемом




Плоский, индифферентный электрод со съемным экранированным кабелем и разъемом

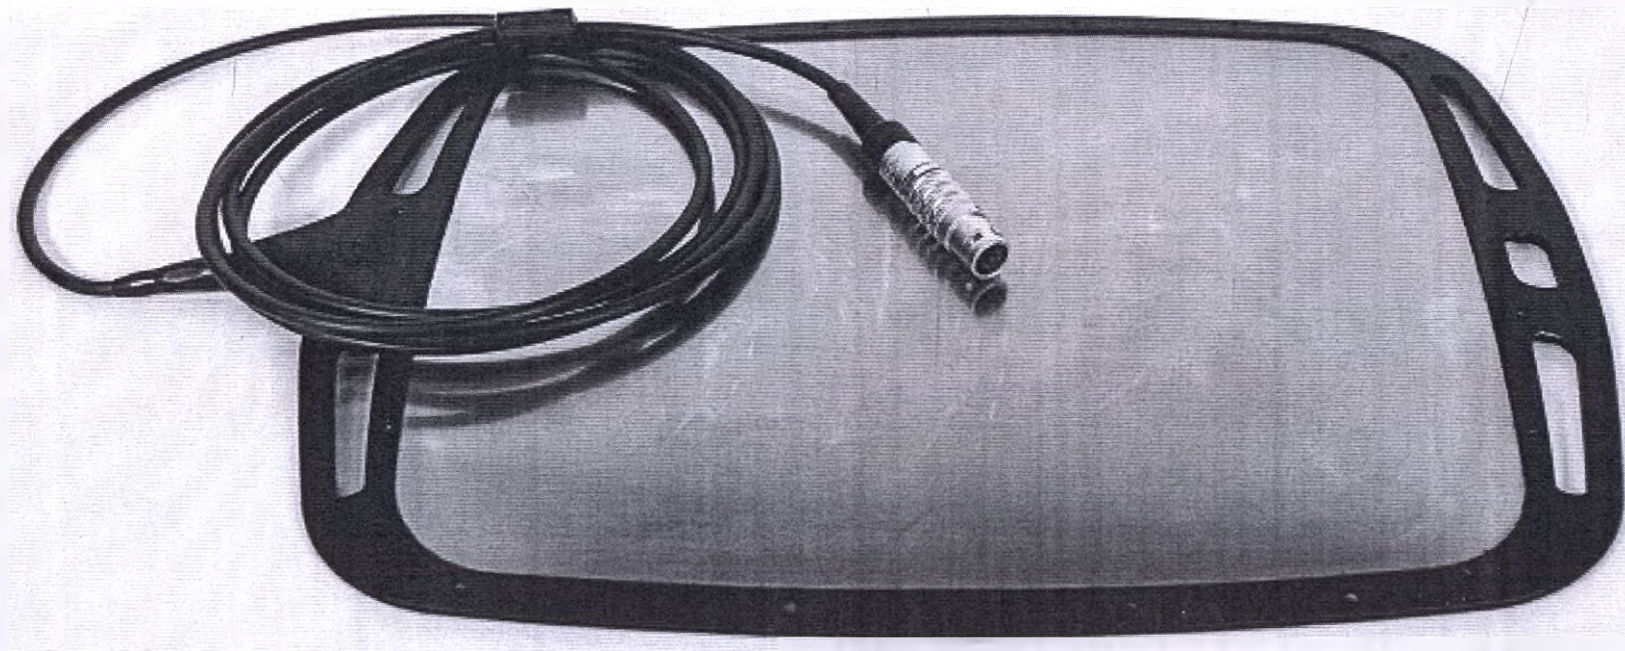


Электрод САР, высокоимпедансный, плоский, термодинамический, Ø 30

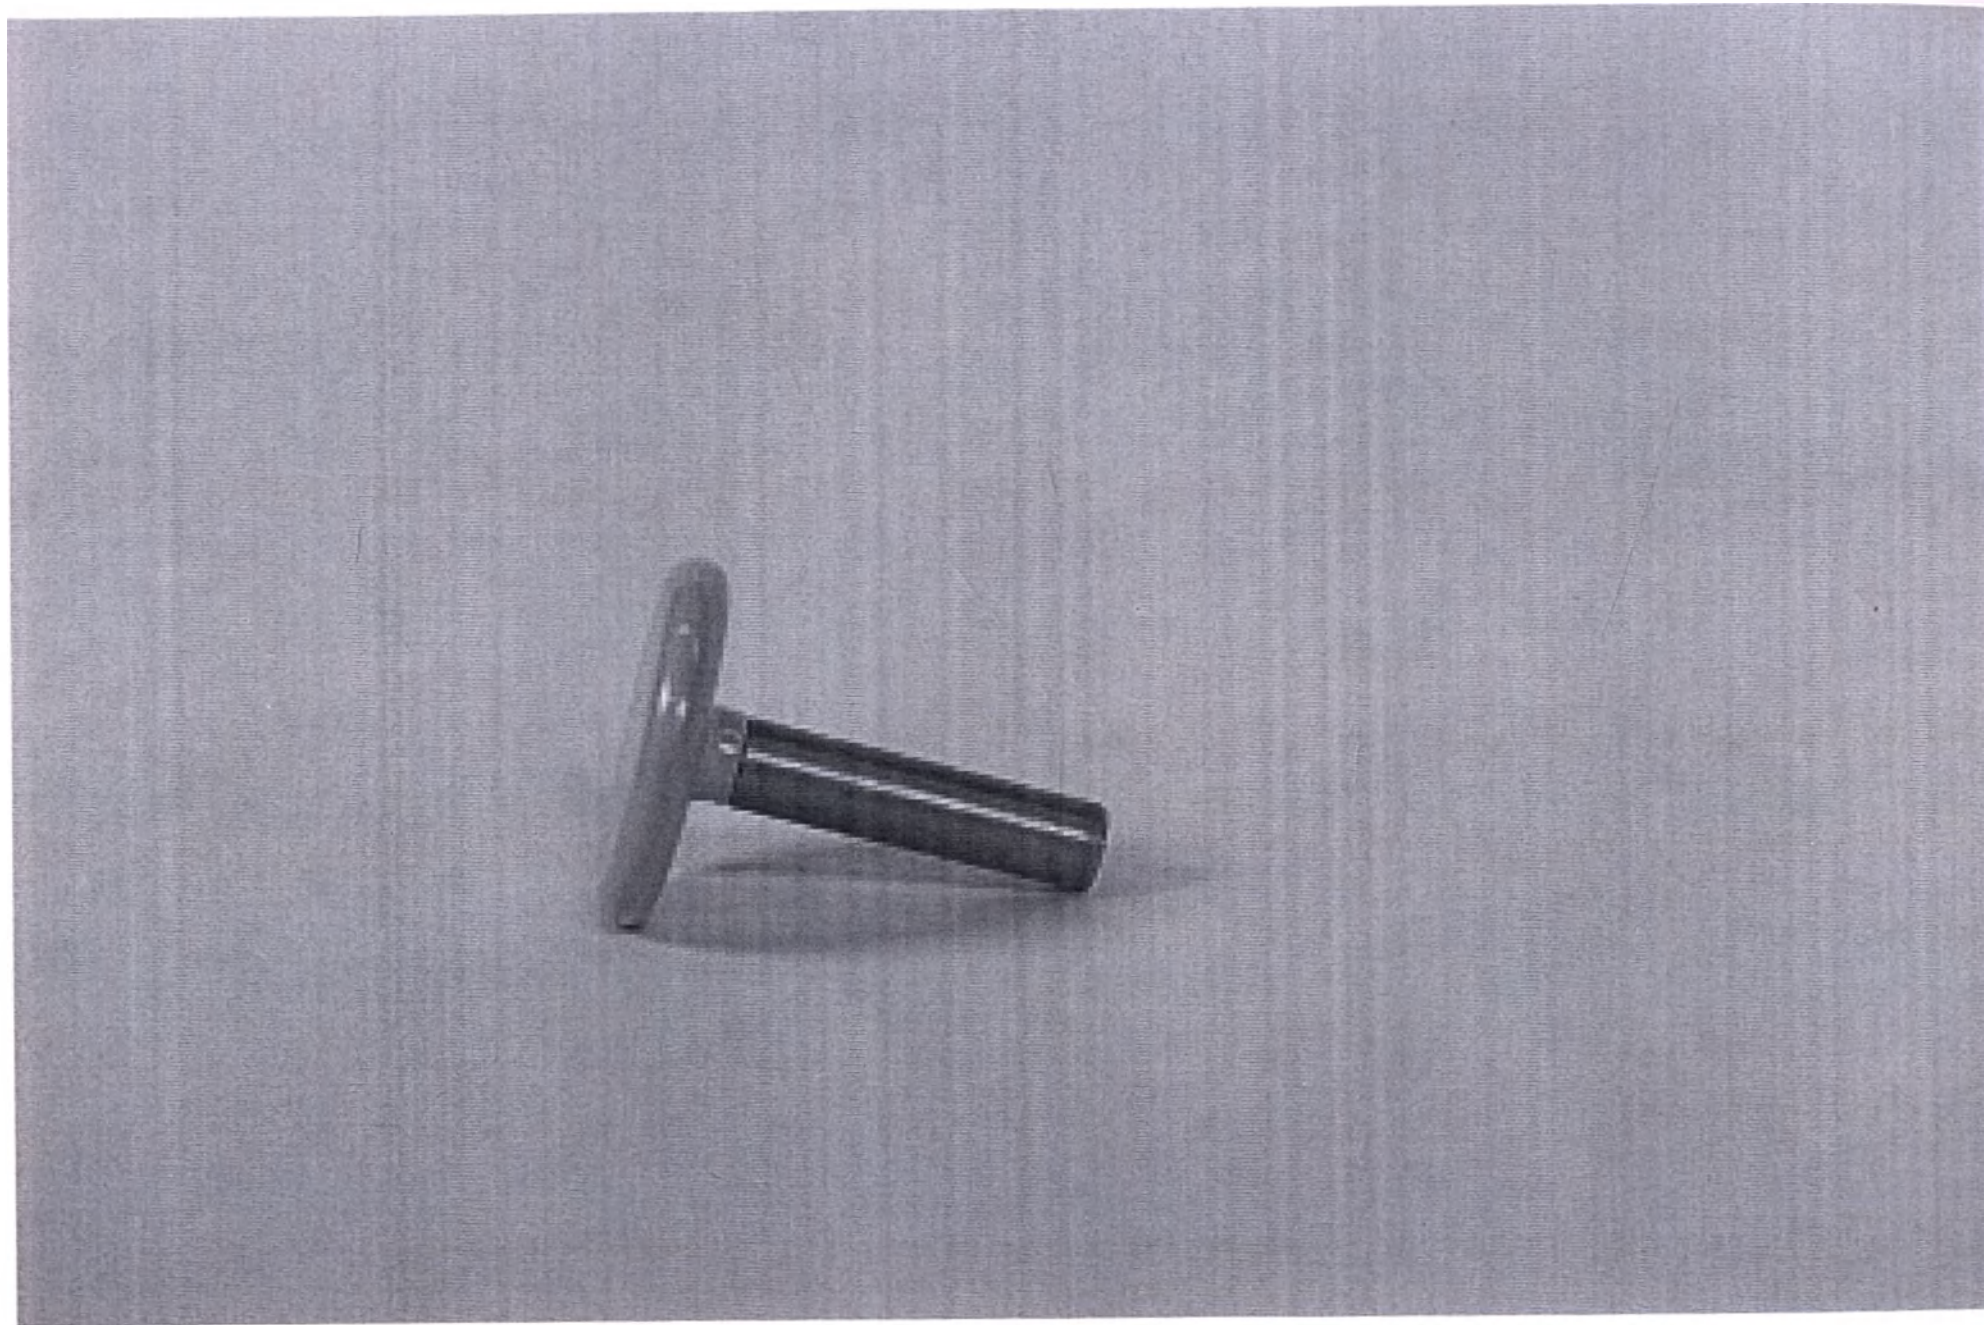


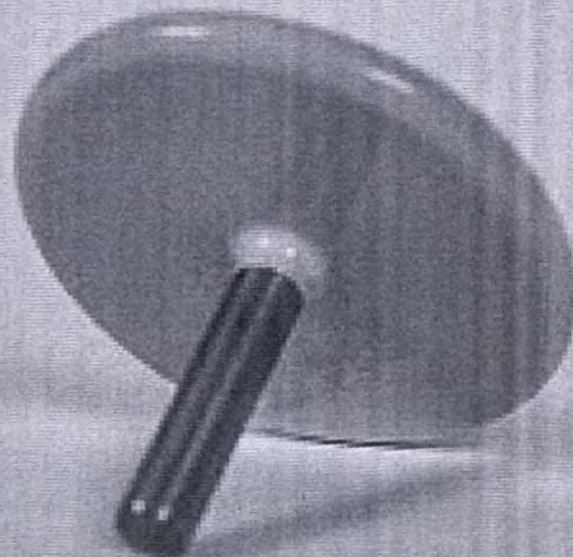


Электрод САР, высокоимпедансный, плоский, термодинамический, $\varnothing 80$

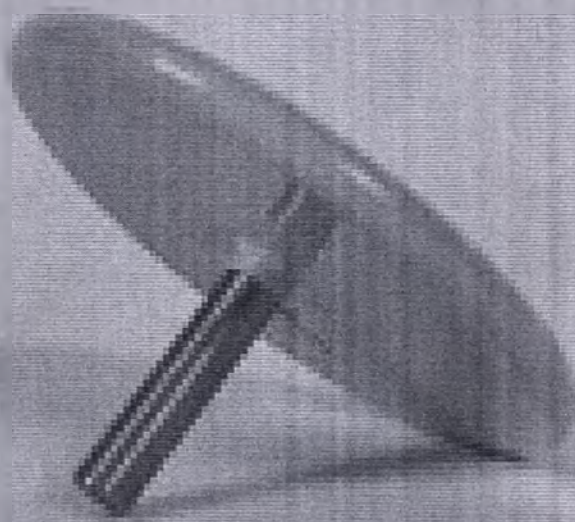


Электрод САР, высокоимпедансный, выпуклый, термодинамический, $\varnothing 55$

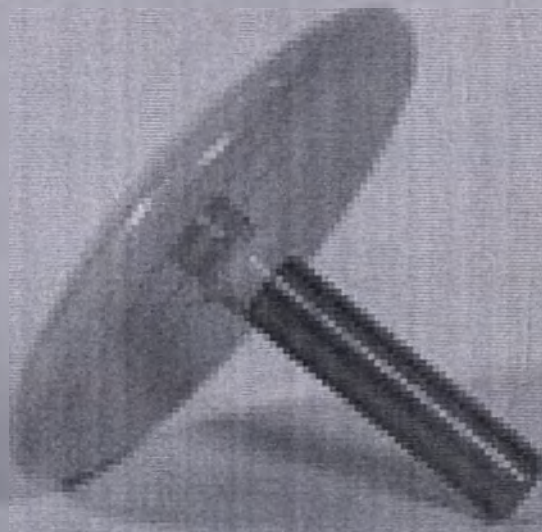



Электрод САР, высокоимпедансный, выпуклый, термодинамический, Ø 65

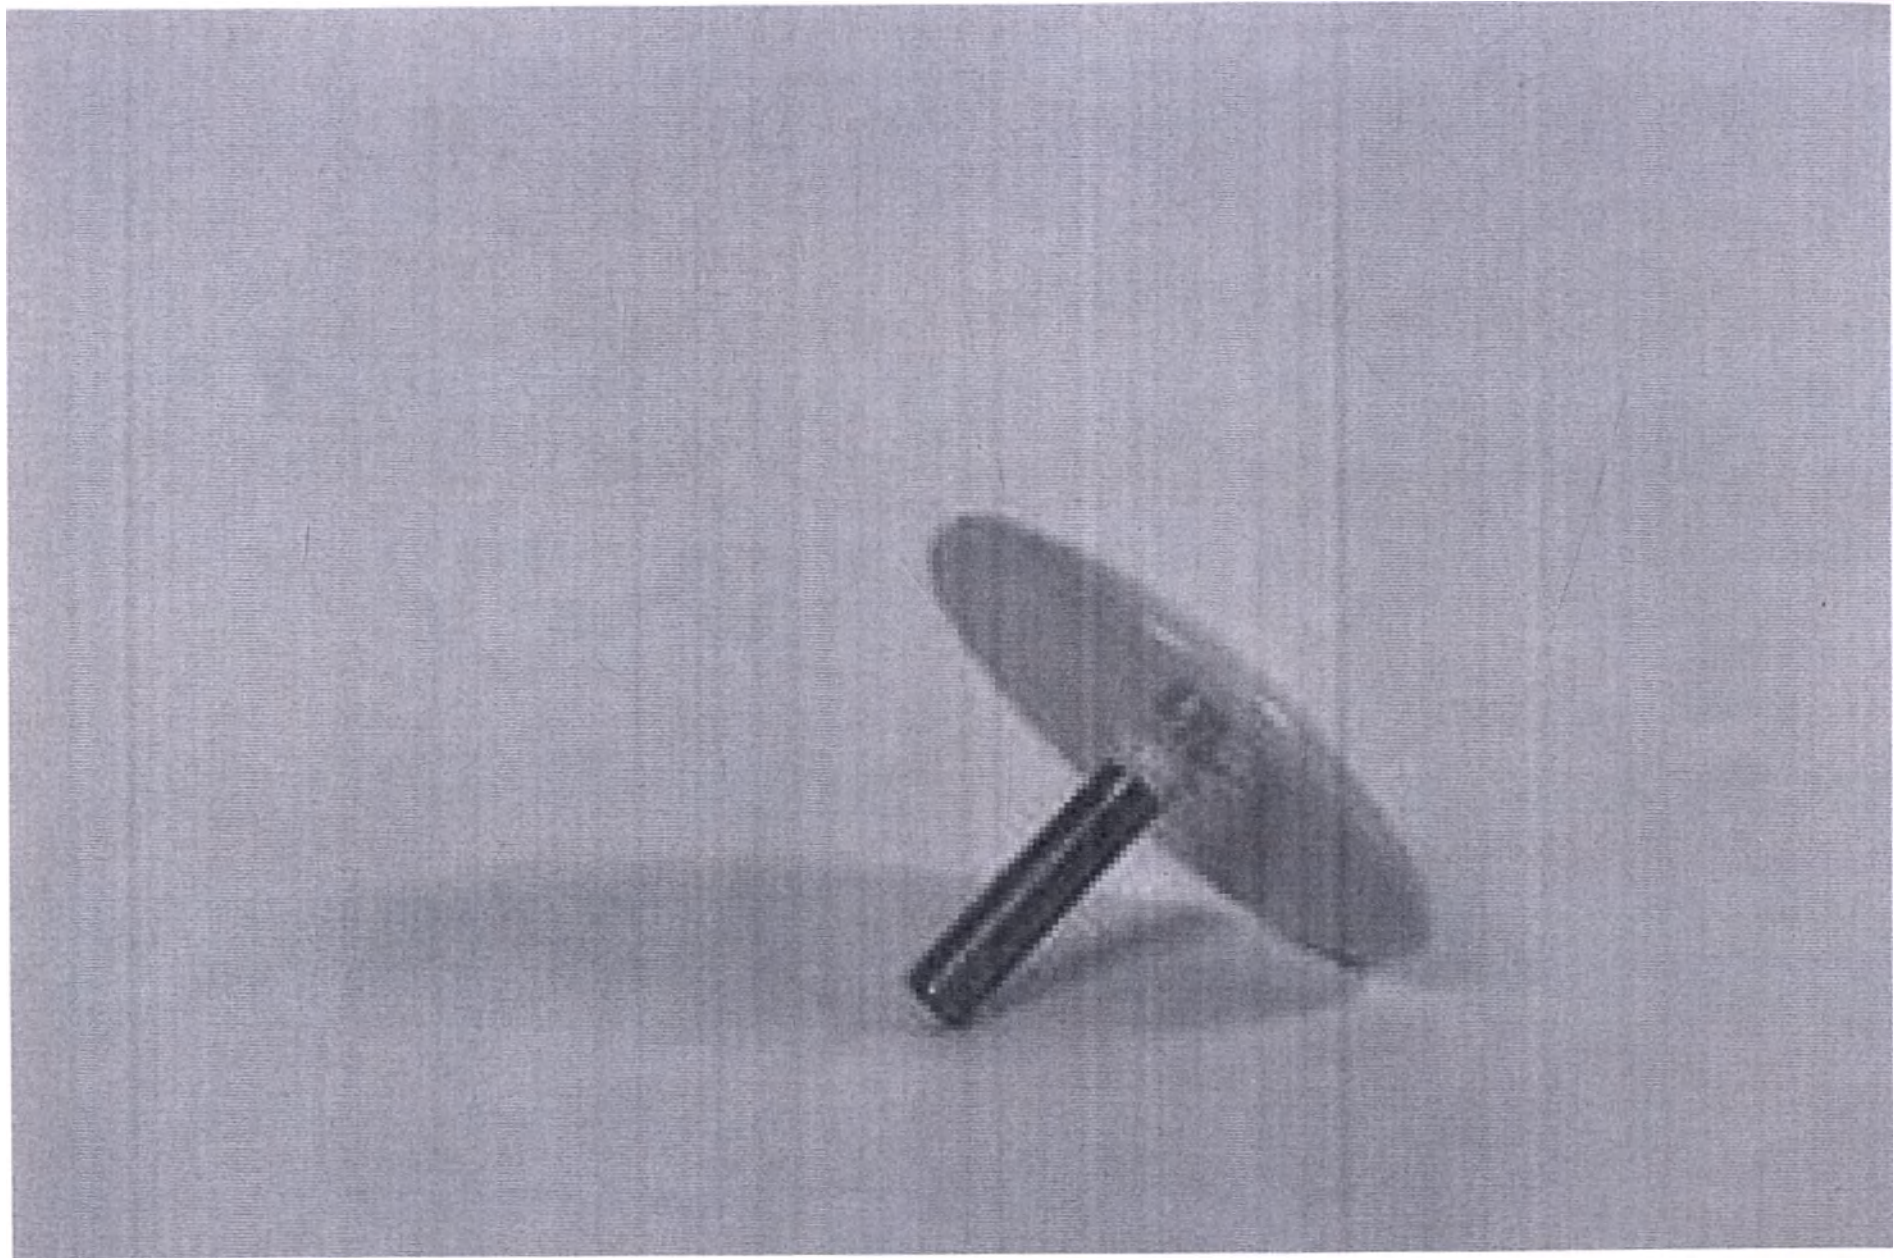


Электрод САР, высокоимпедансный, плоский, утолщенный и лимфодинамический (для лица), $\varnothing 55$

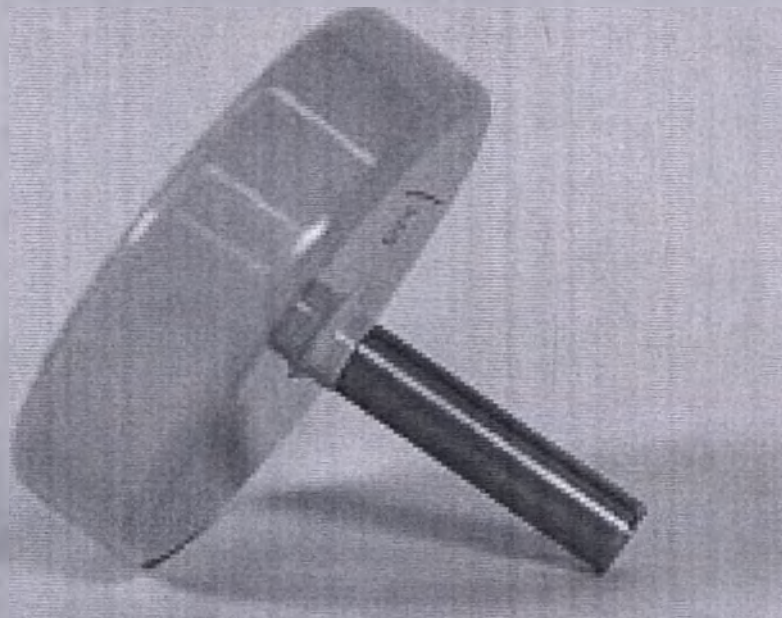

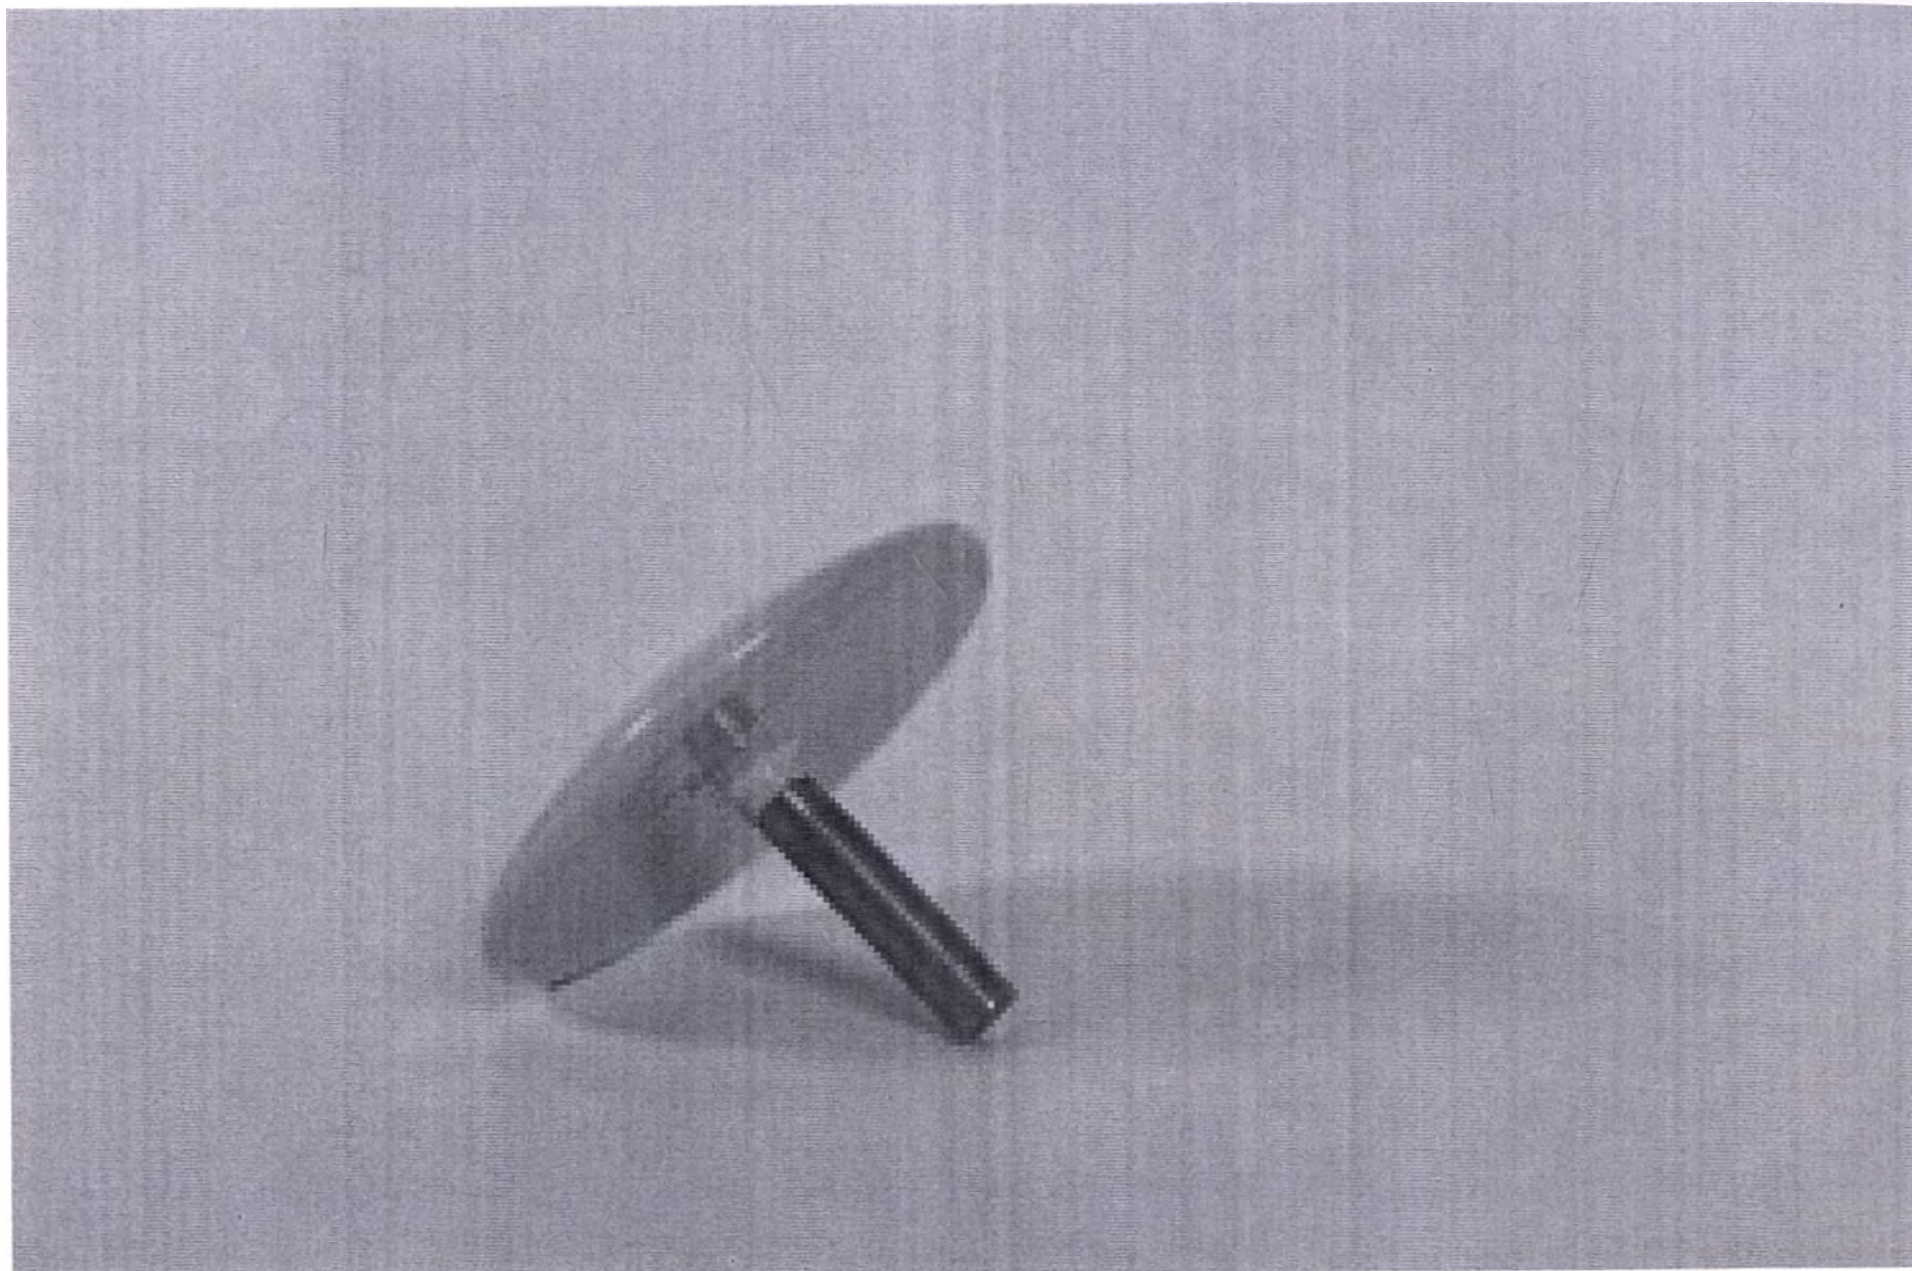


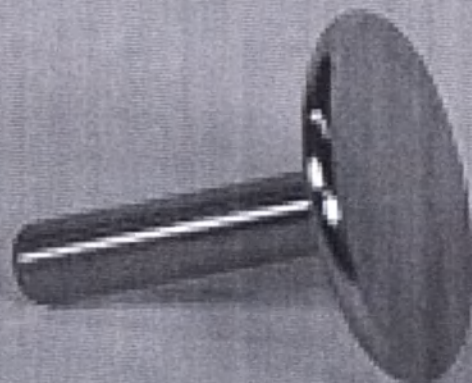


Низкоимпедансный RES-электрод, $\varnothing$ 50

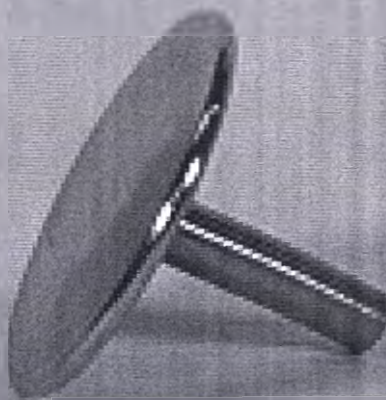


Низкоимпедансный RES-электрод, ø 65

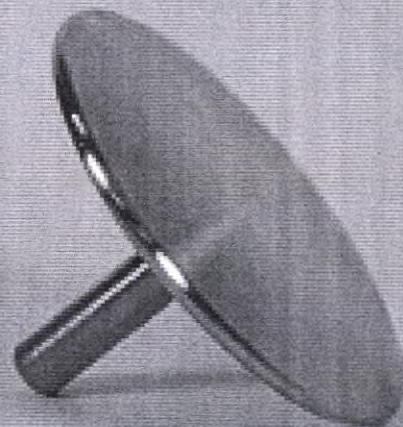


Низкоимпедансный RES-электрод, $\varnothing$ 90

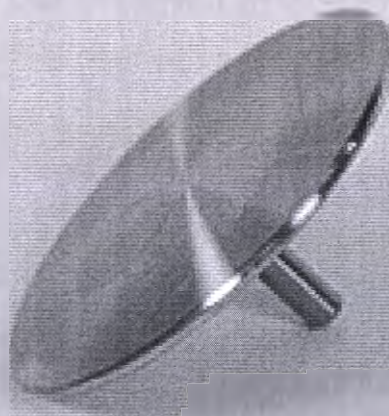

Пульт дистанционного управления

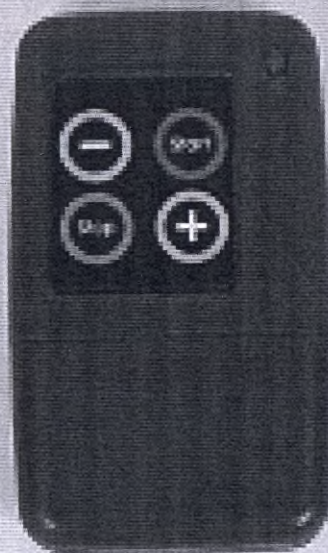

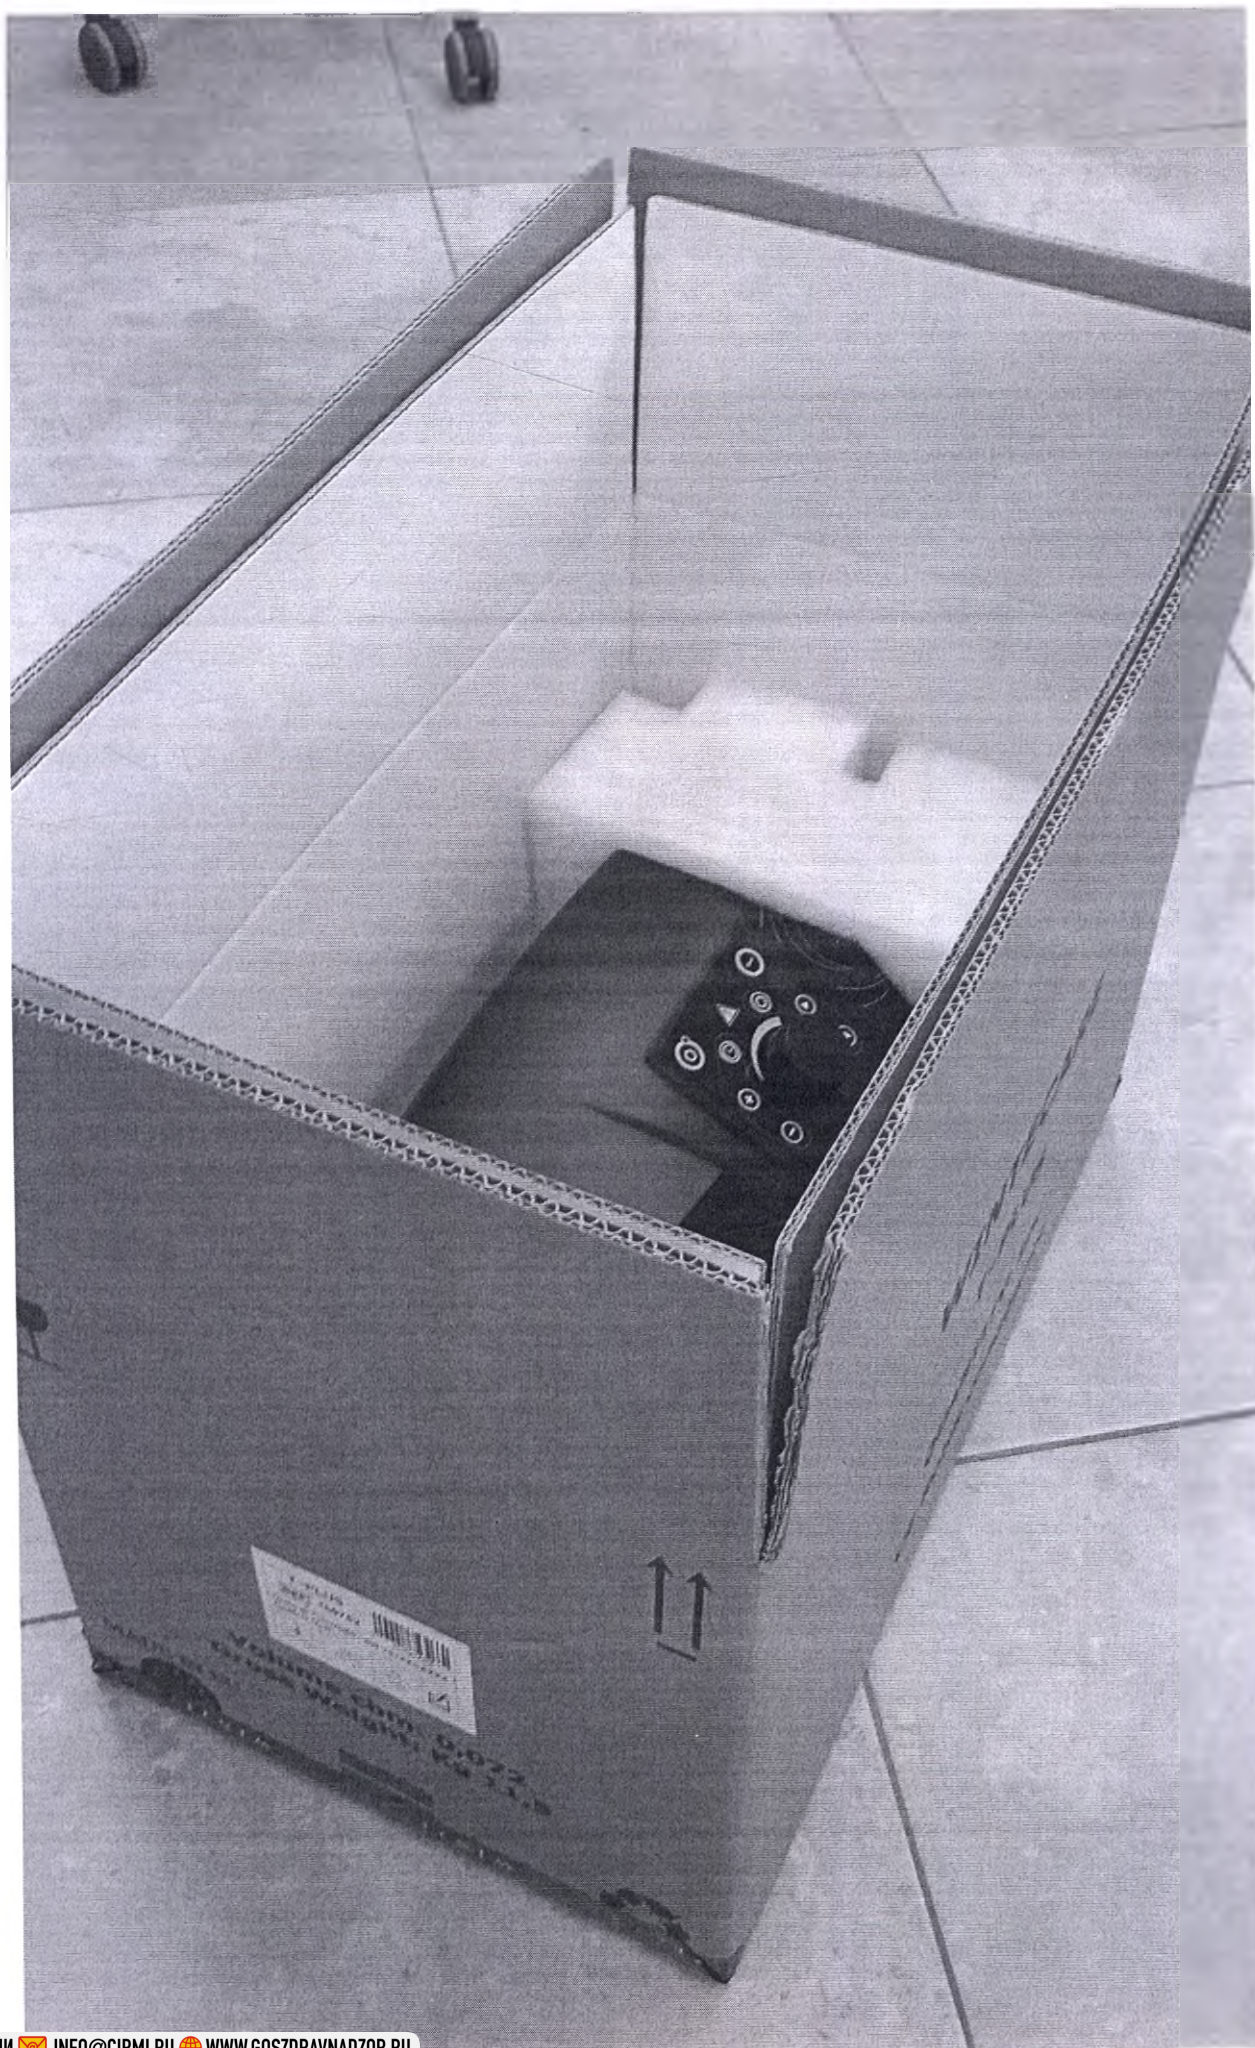

Проект маркировки

Наименование: Аппарат физиотерапевтический для диатермии и текар-терапии T-PLUS
Предназначение: для термообработки / текаротерапии, применяемое для реабилитационной физиотерапии

Срок эксплуатации: 5 лет.

Значение символов на упаковке:



- Изготовитель;



- Дата изготовления;

REF

- Номер по каталогу;

SN

- серийный номер;



- Обратитесь к сопроводительным документам (требуемым для ознакомления с

мерами безопасности); **CE** ¹⁹³⁶ - Соответствие стандартам ЕС;  - Этот логотип означает, что аппарат нельзя выбрасывать в обычные места сбора твердых бытовых отходов. Он должен утилизироваться в соответствии с Европейской директивой 2012/19/CE.

Условия транспортирования и хранения от -40 °С до + 70 °С. и влажности от 10% до 75%;

Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «АЛЬТА-ПРО», 350020, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 290, офис 9.

Производитель: WHTcare SA, via Giuseppe Motta 10, 6830 Chiasso, Switzerland

