

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»



Н.А. Горшкова
2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор реагентов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических
серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin (Atellica IM BRAHMS PCT))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикакс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

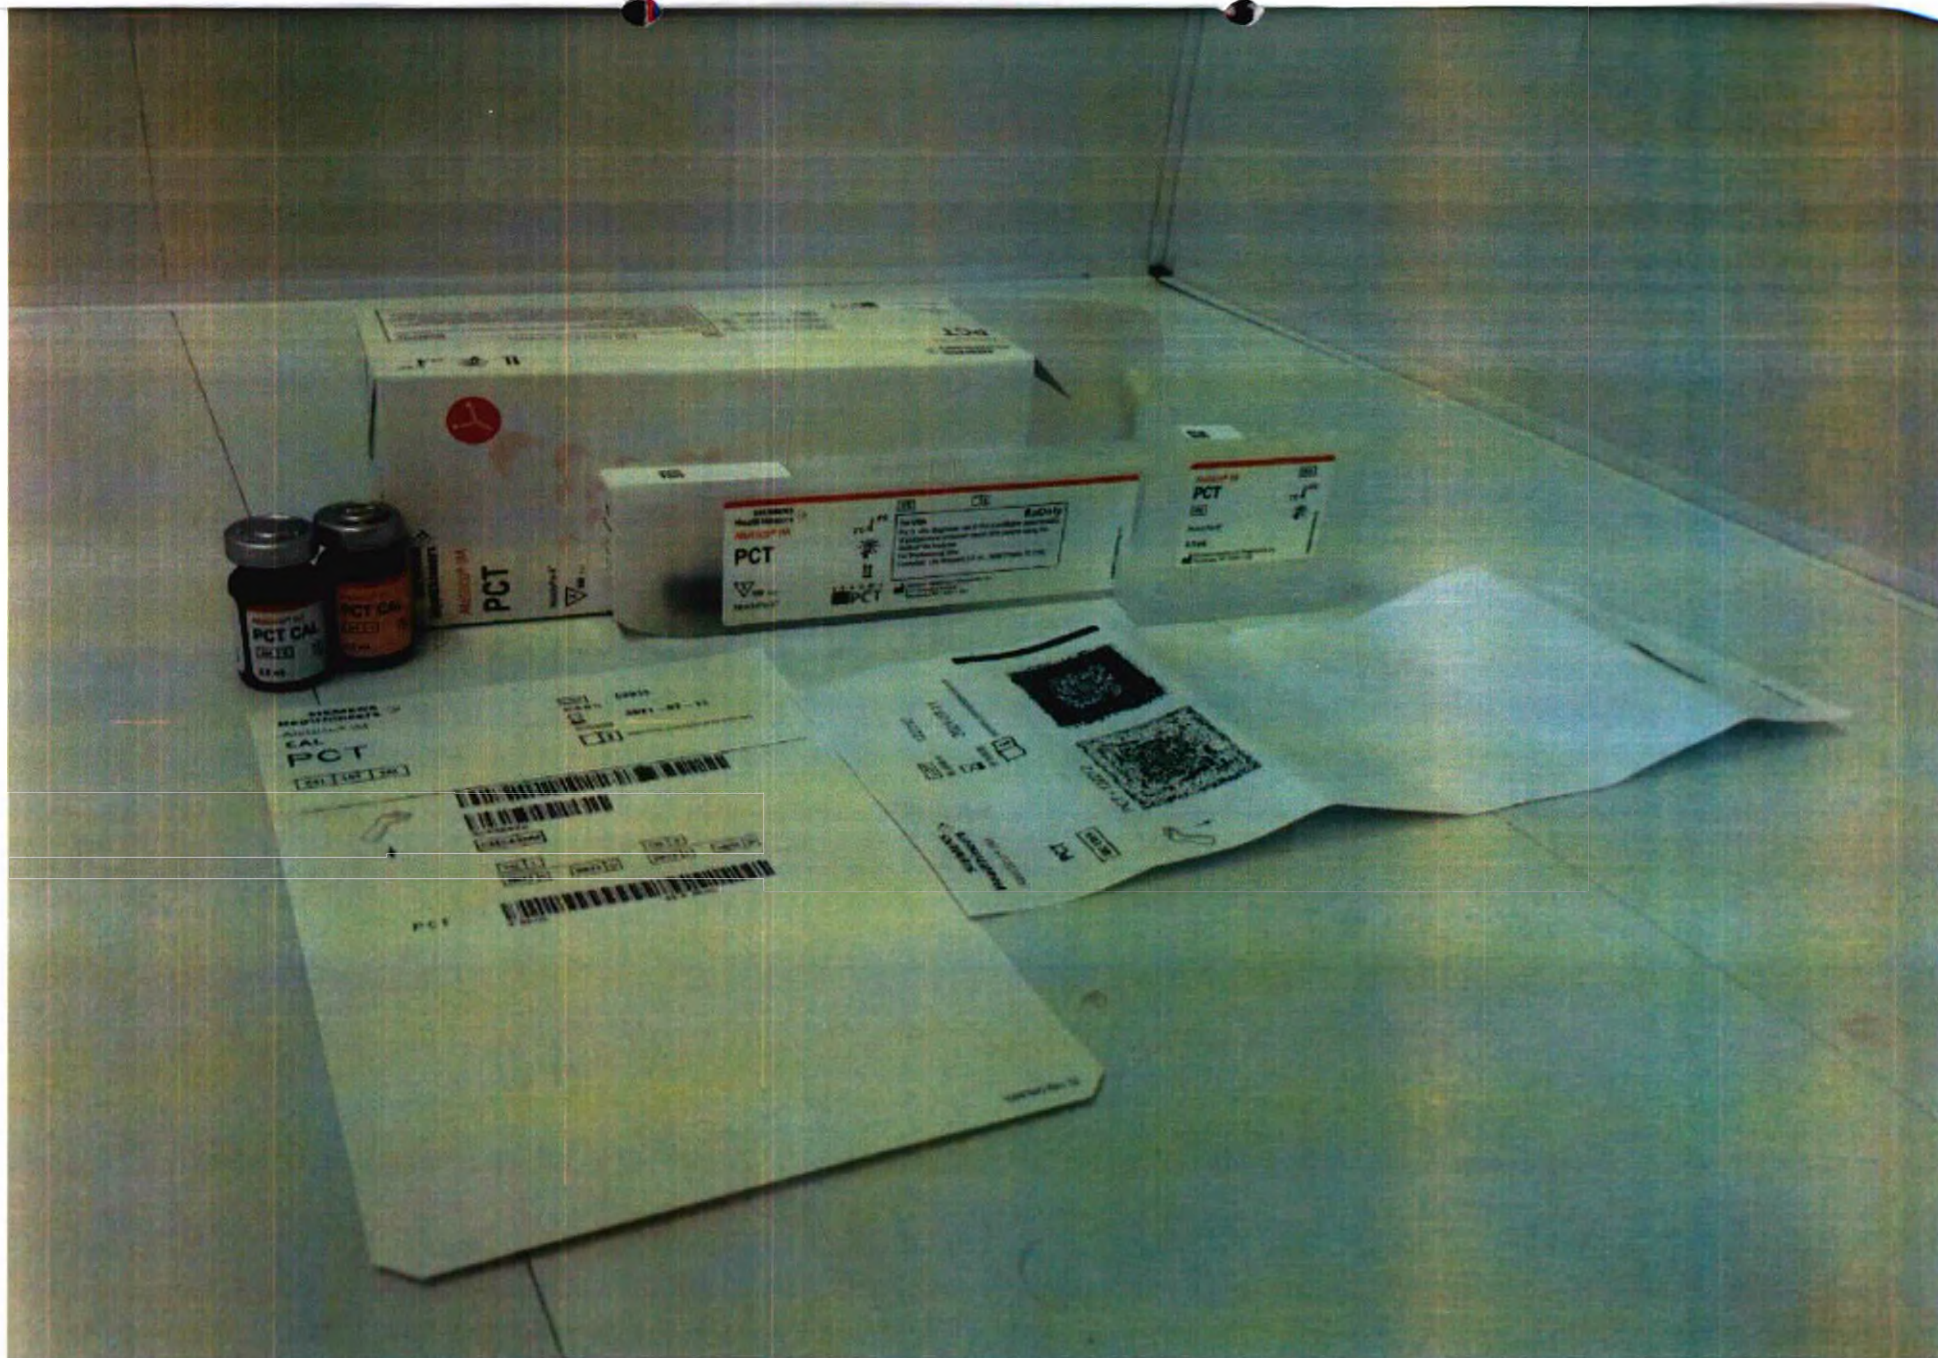


Рисунок 1. Набор реагентов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin (Atellica IM BRAHMS PCT)). Общий вид

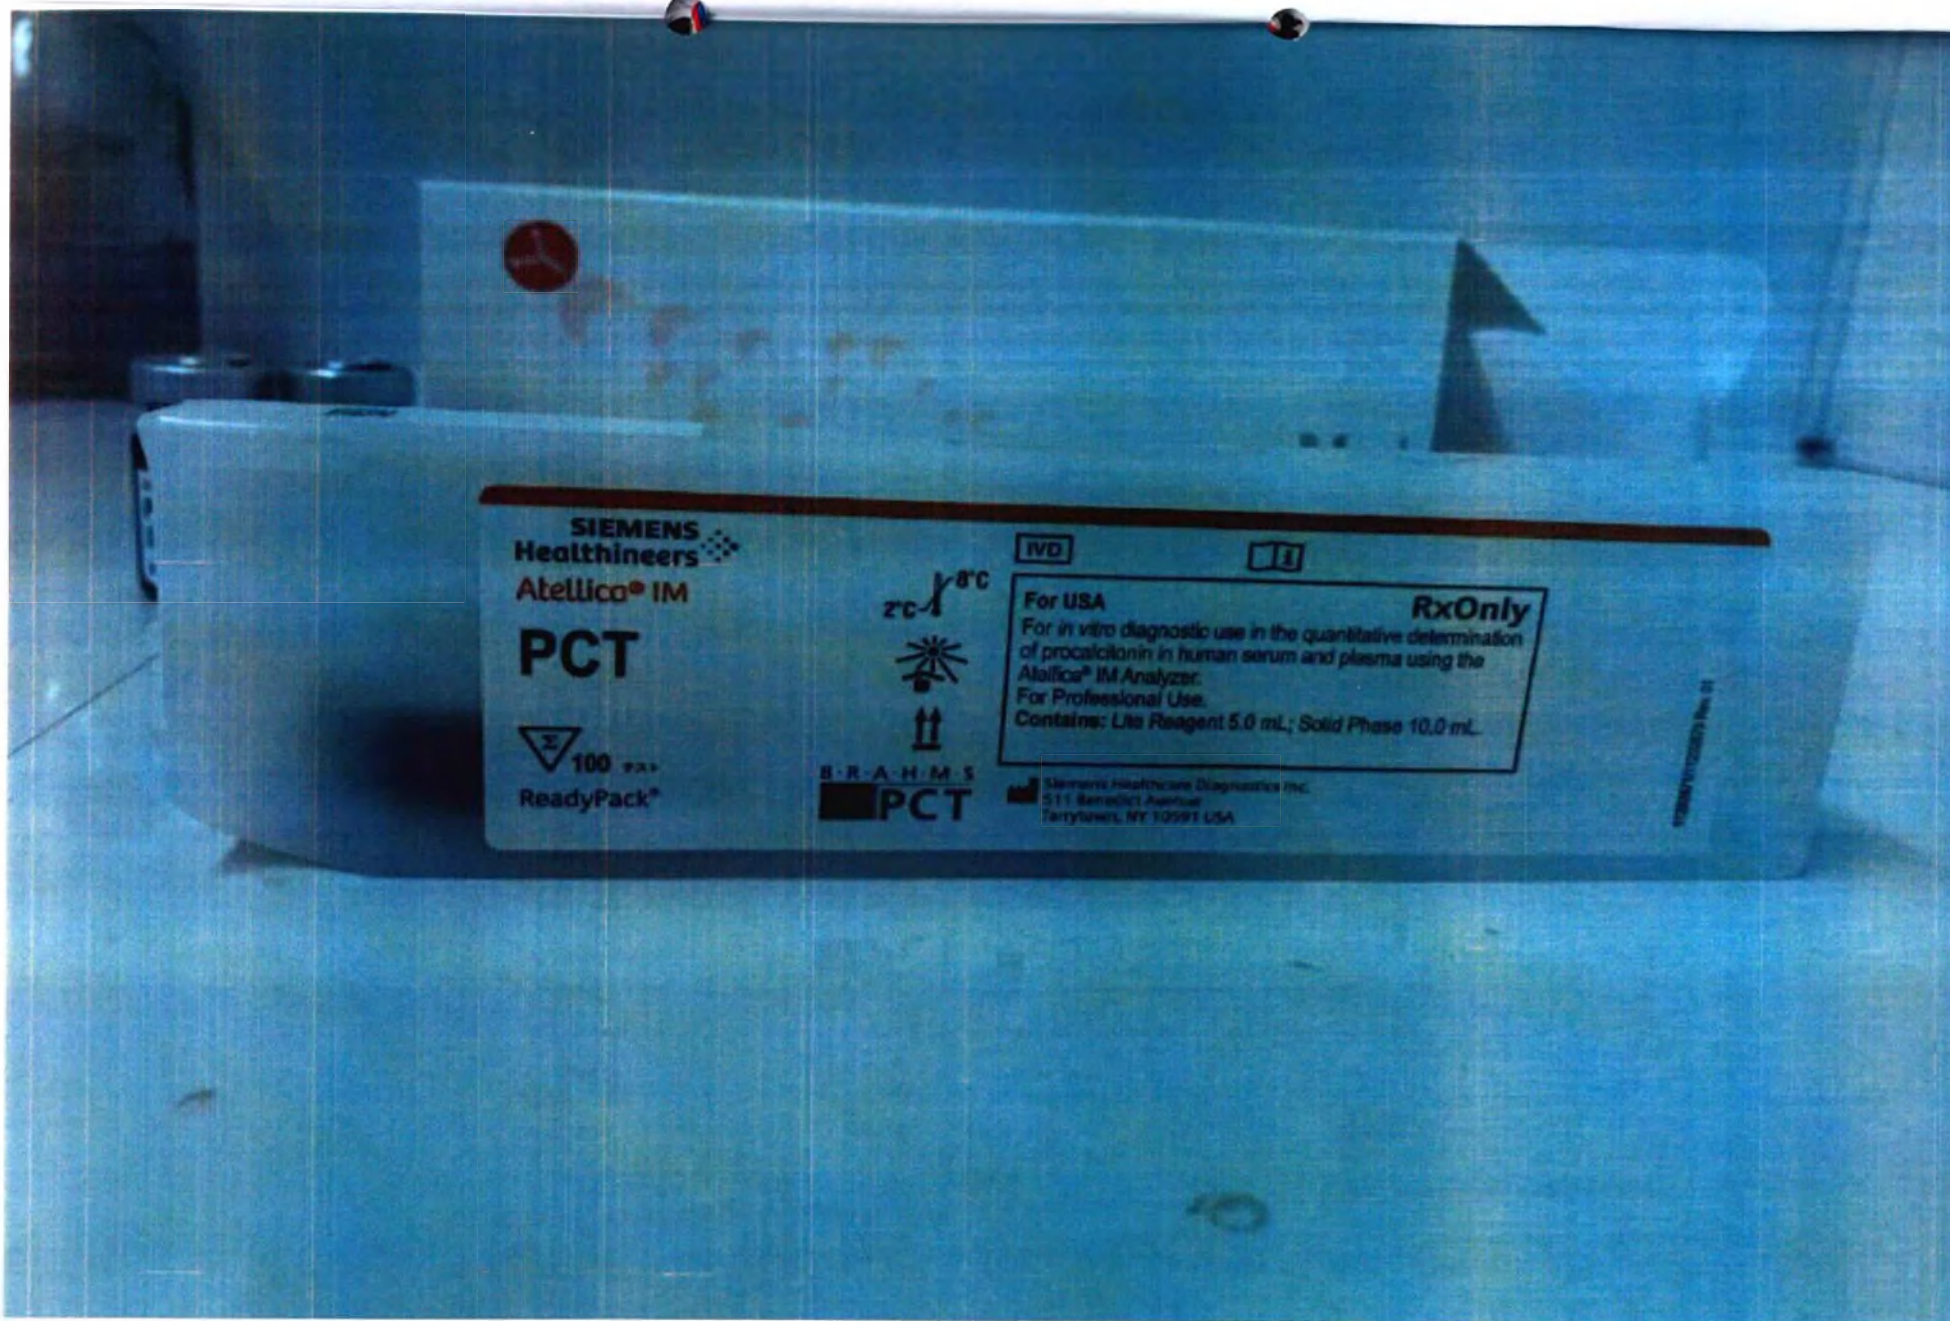


Рисунок 2. Набор реагентов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin (Atellica IM BRAHMS PCT)): Основной реагент Atellica IM BRAHMS PCT.

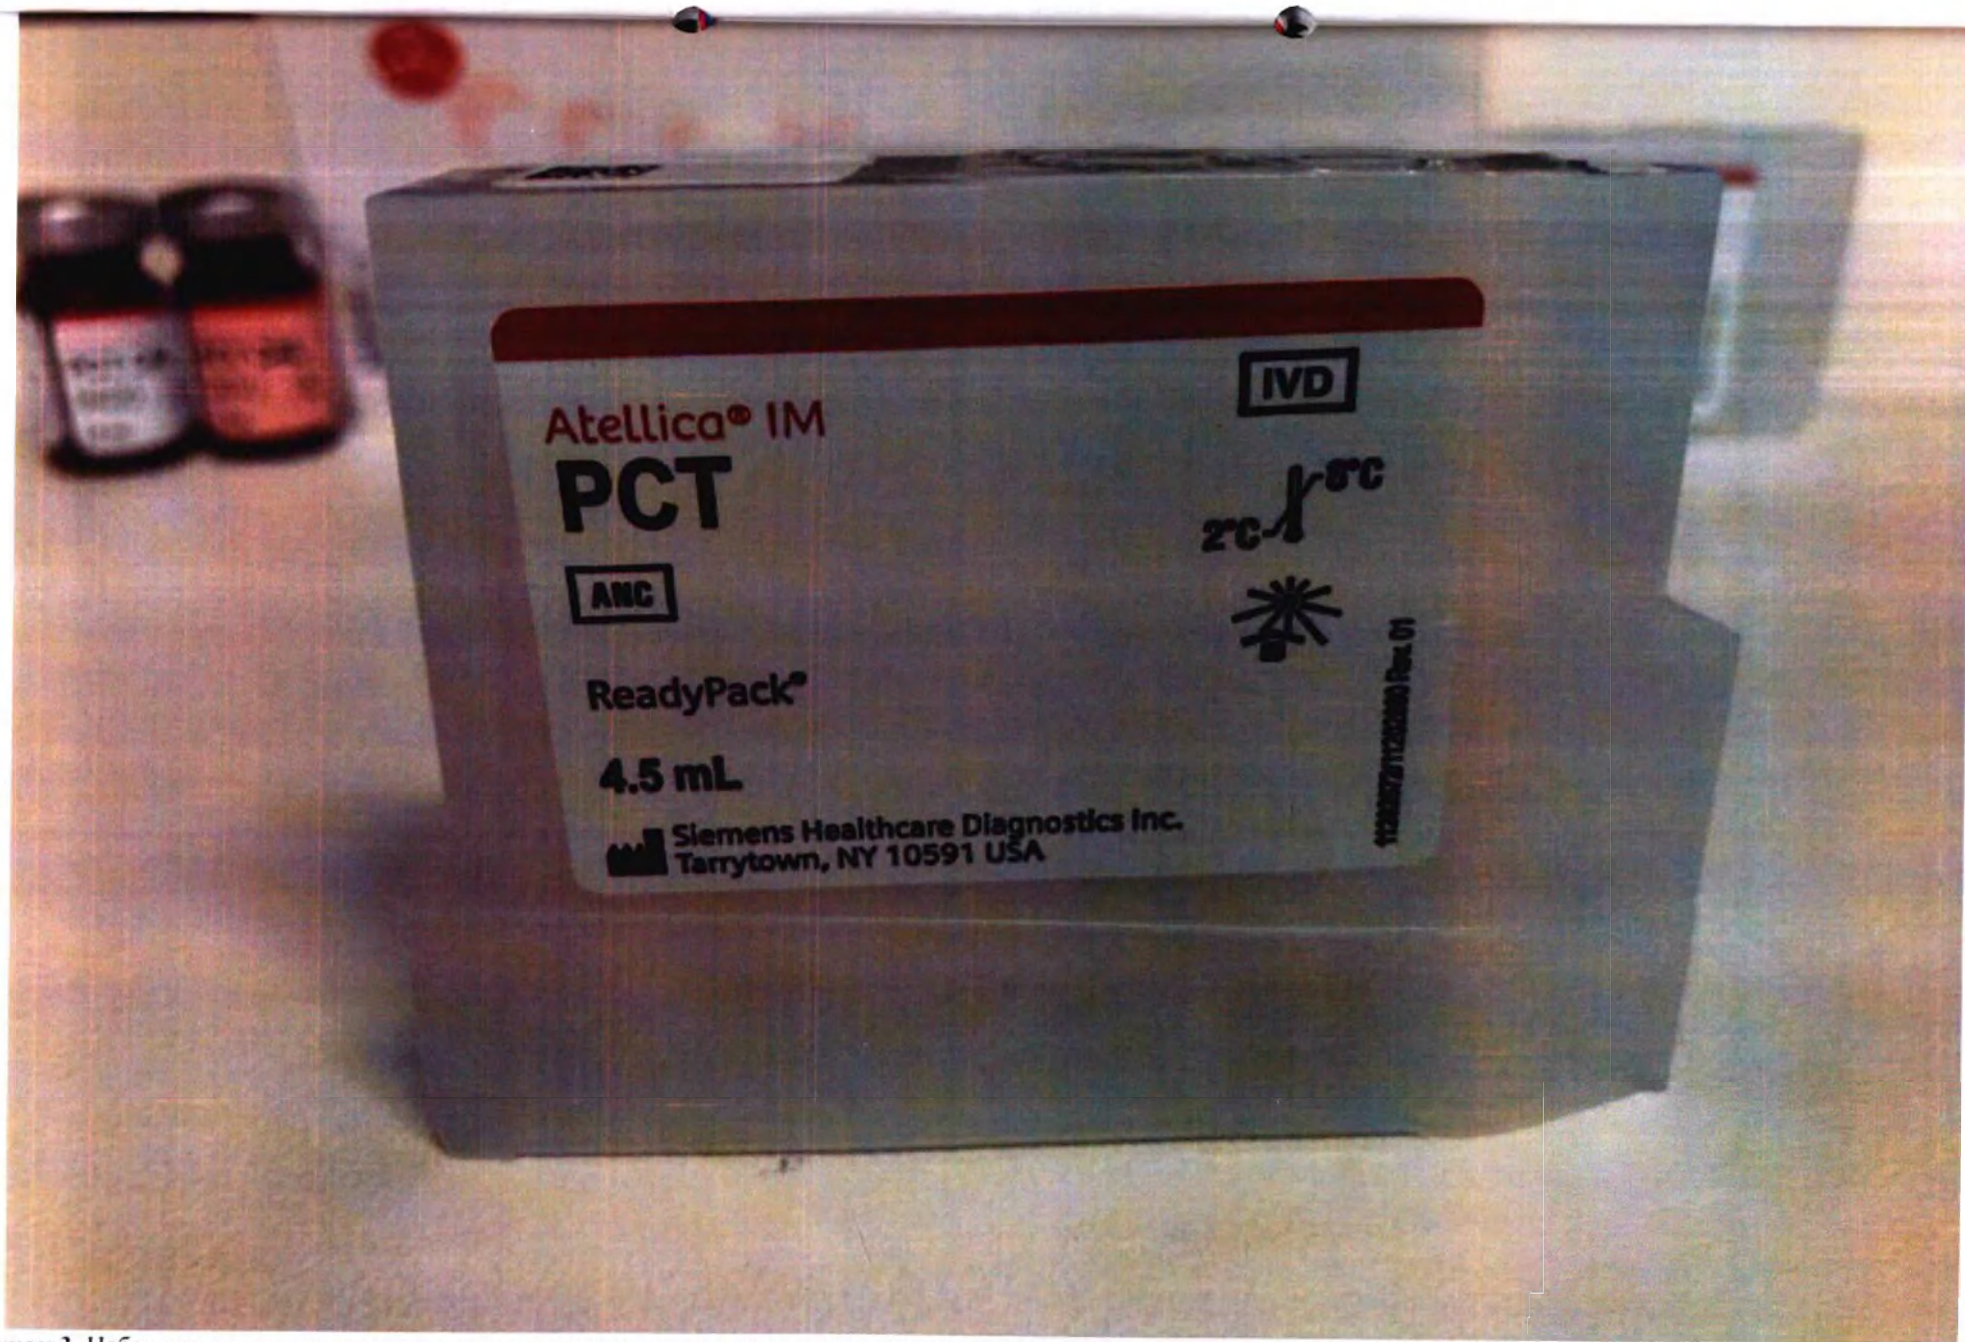
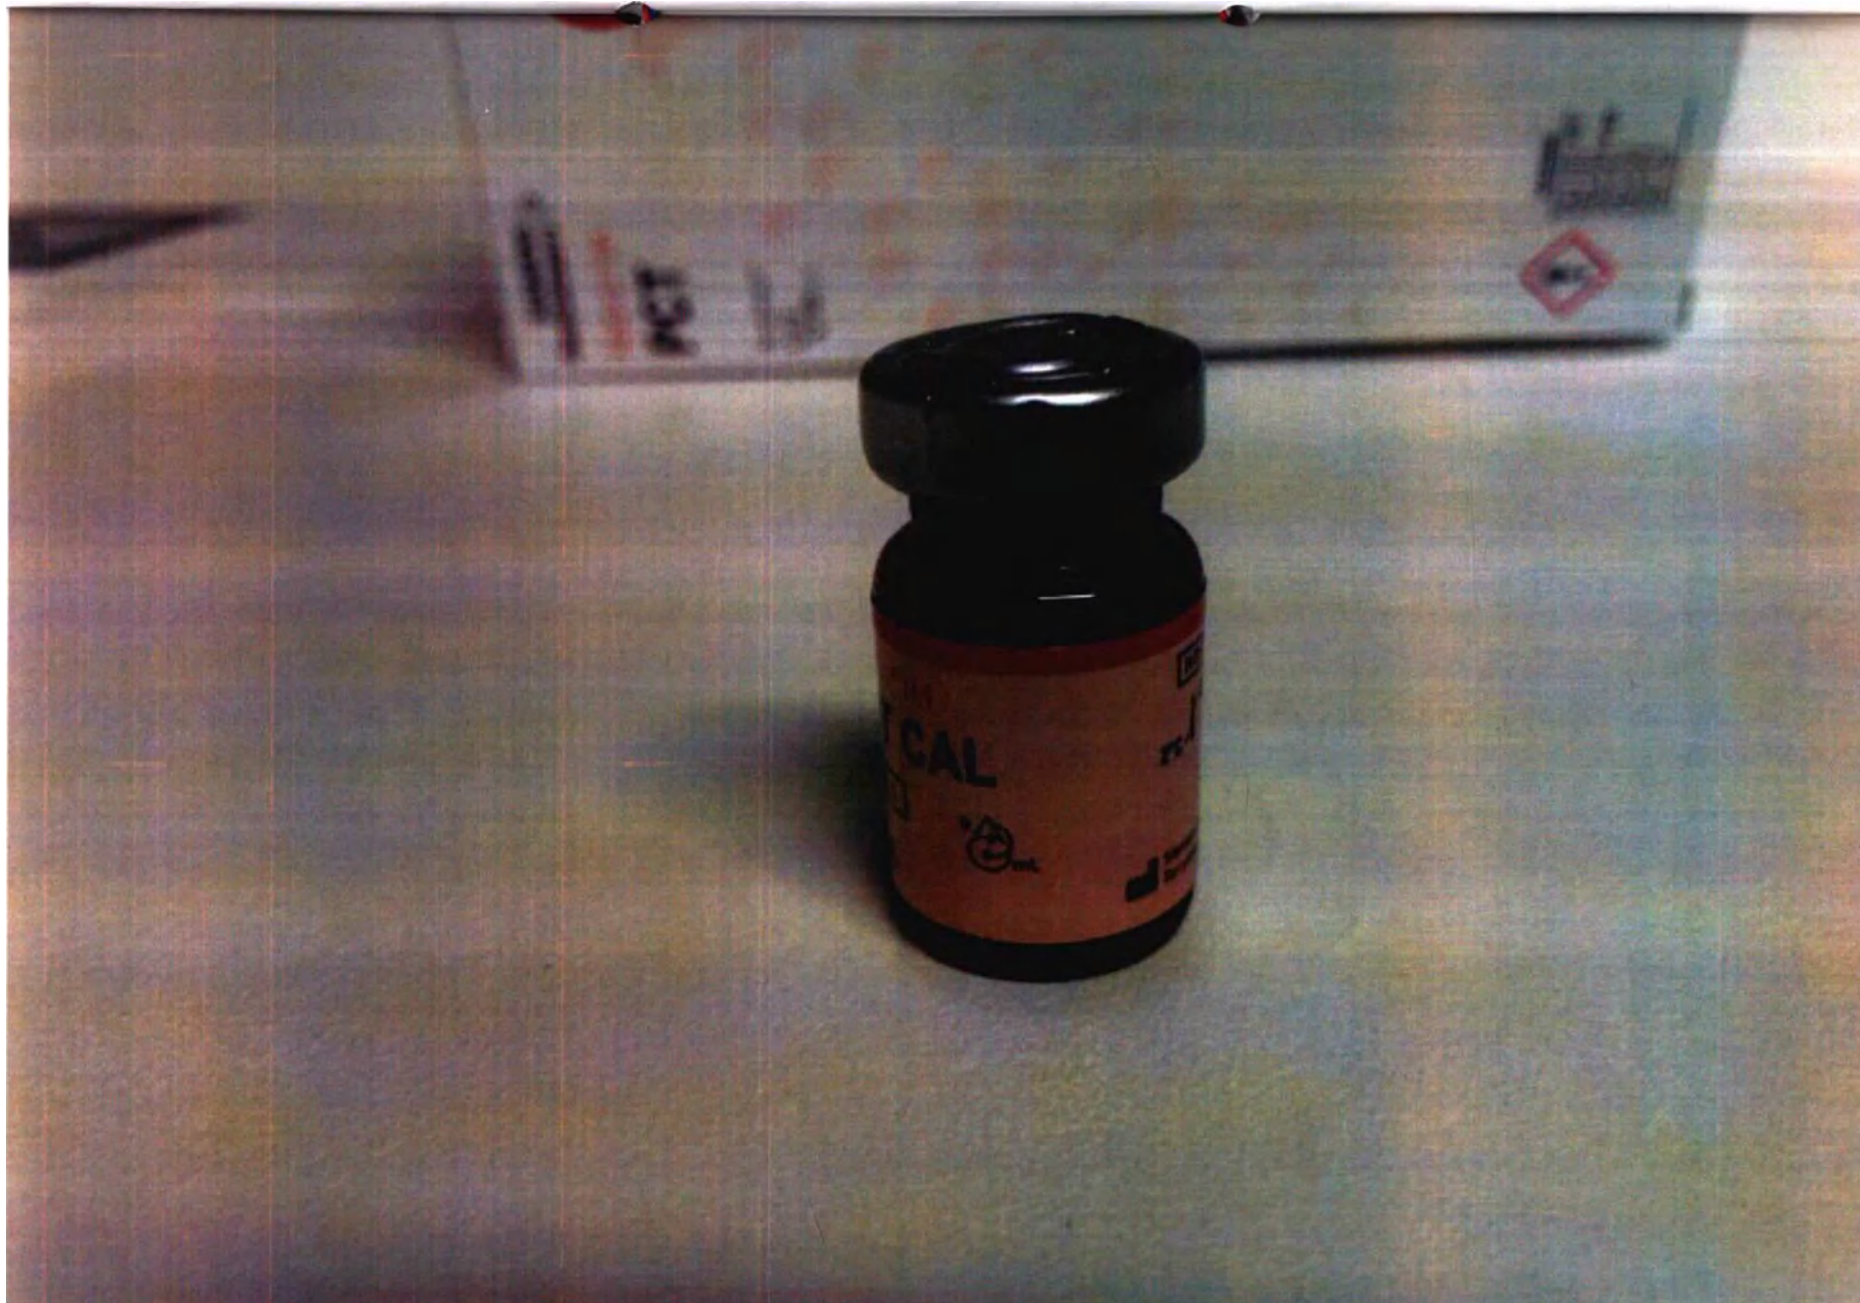


Рисунок 3. Набор реагентов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin (Atellica IM BRAHMS PCT)):
Дополнительный реагент Atellica IM BRAHMS PCT ANC, 4,5 мл



Рисунок 4. Набор реагентов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin (Atellica IM BRAHMS PCT)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM BRAHMS PCT CAL L, 2,0 мл



**Рисунок 5. Набор реагентов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin (Atellica IM BRAHMS PCT)):
Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM BRAHMS PCT CAL L, 2,0 мл**

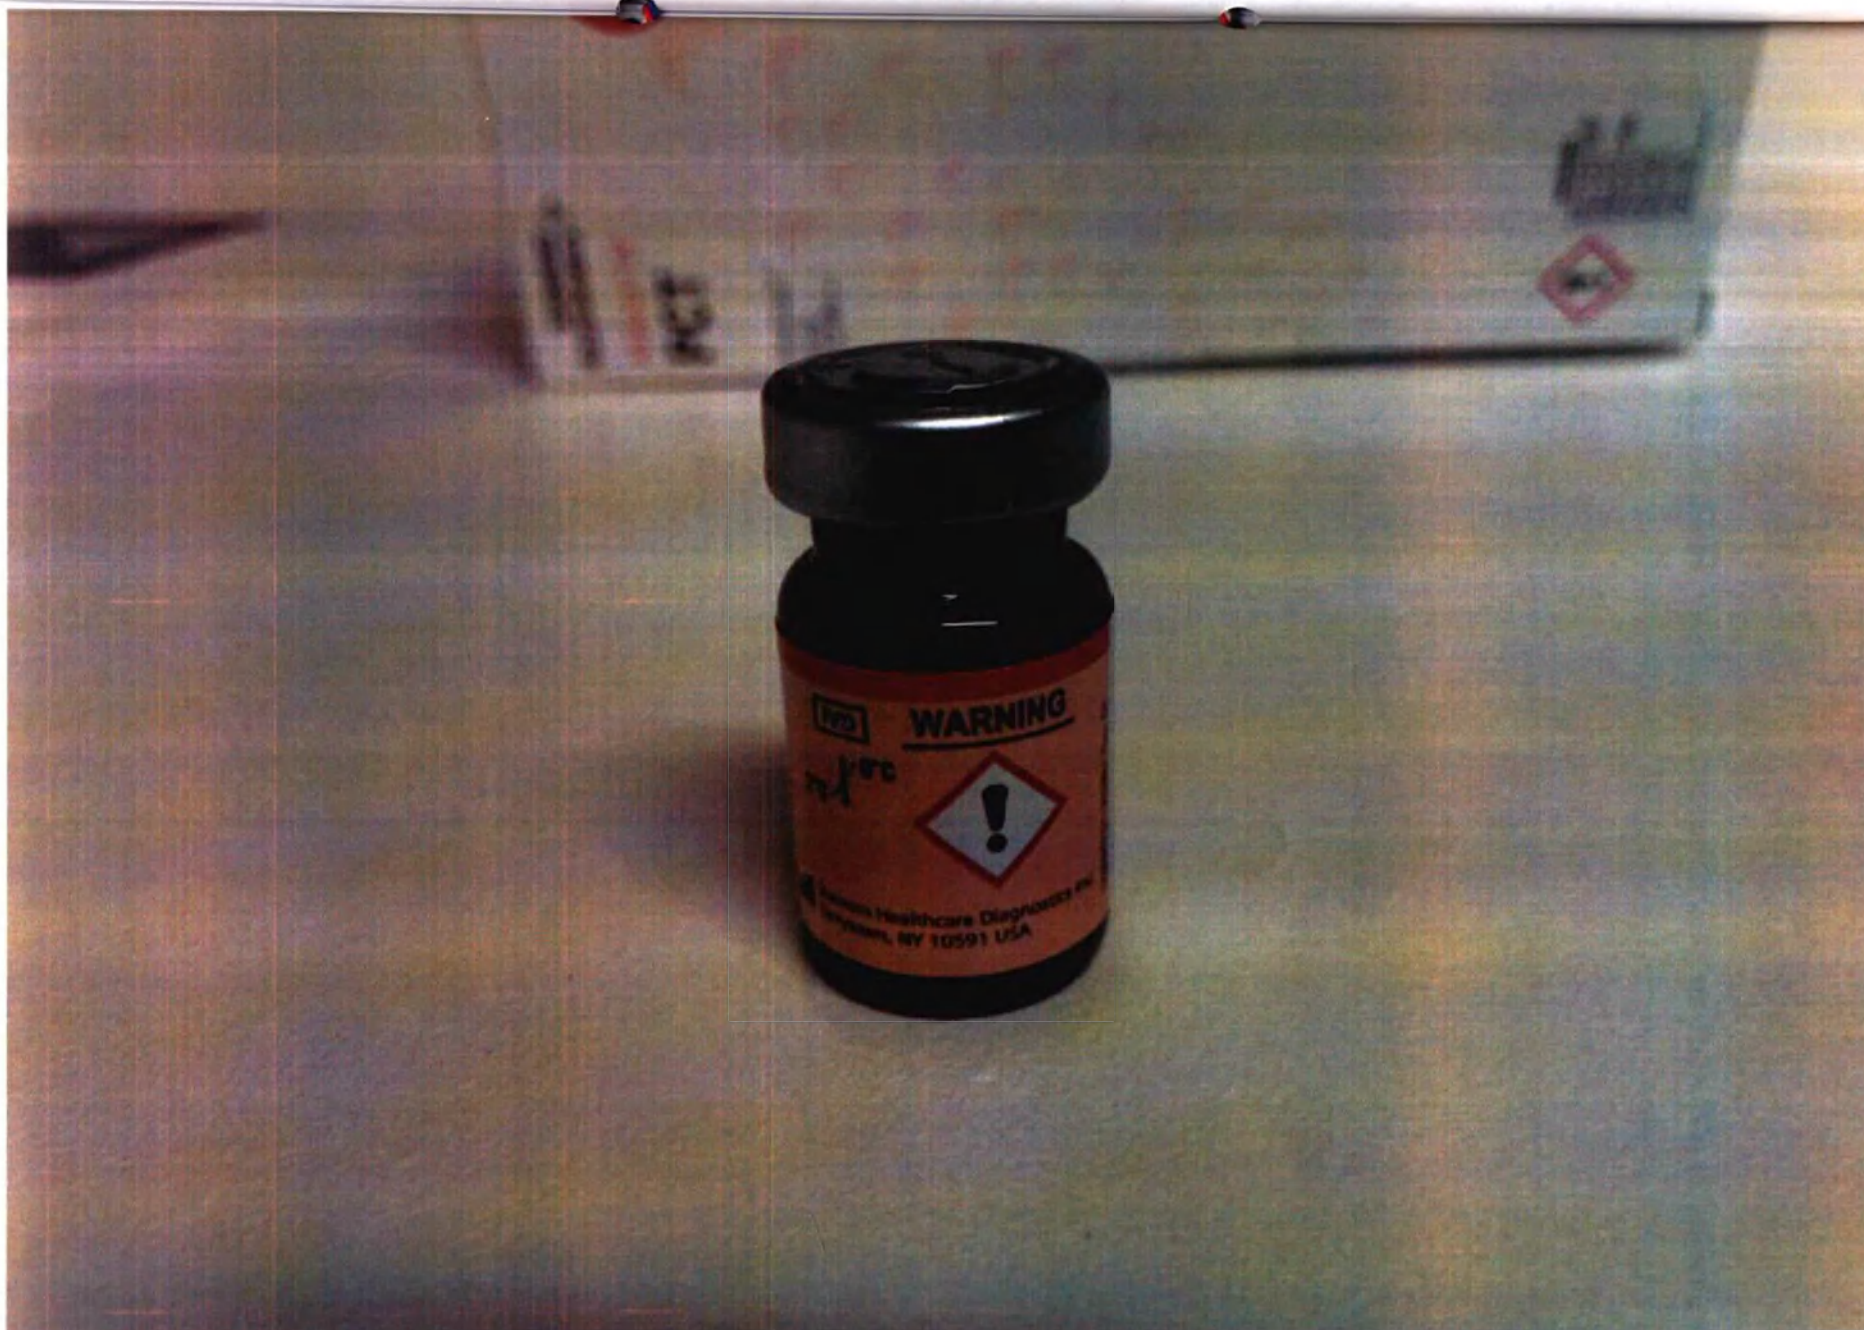


Рисунок 6. Набор реагентов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin (Atellica IM BRAHMS PCT)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM BRAHMS PCT CAL L, 2,0 мл

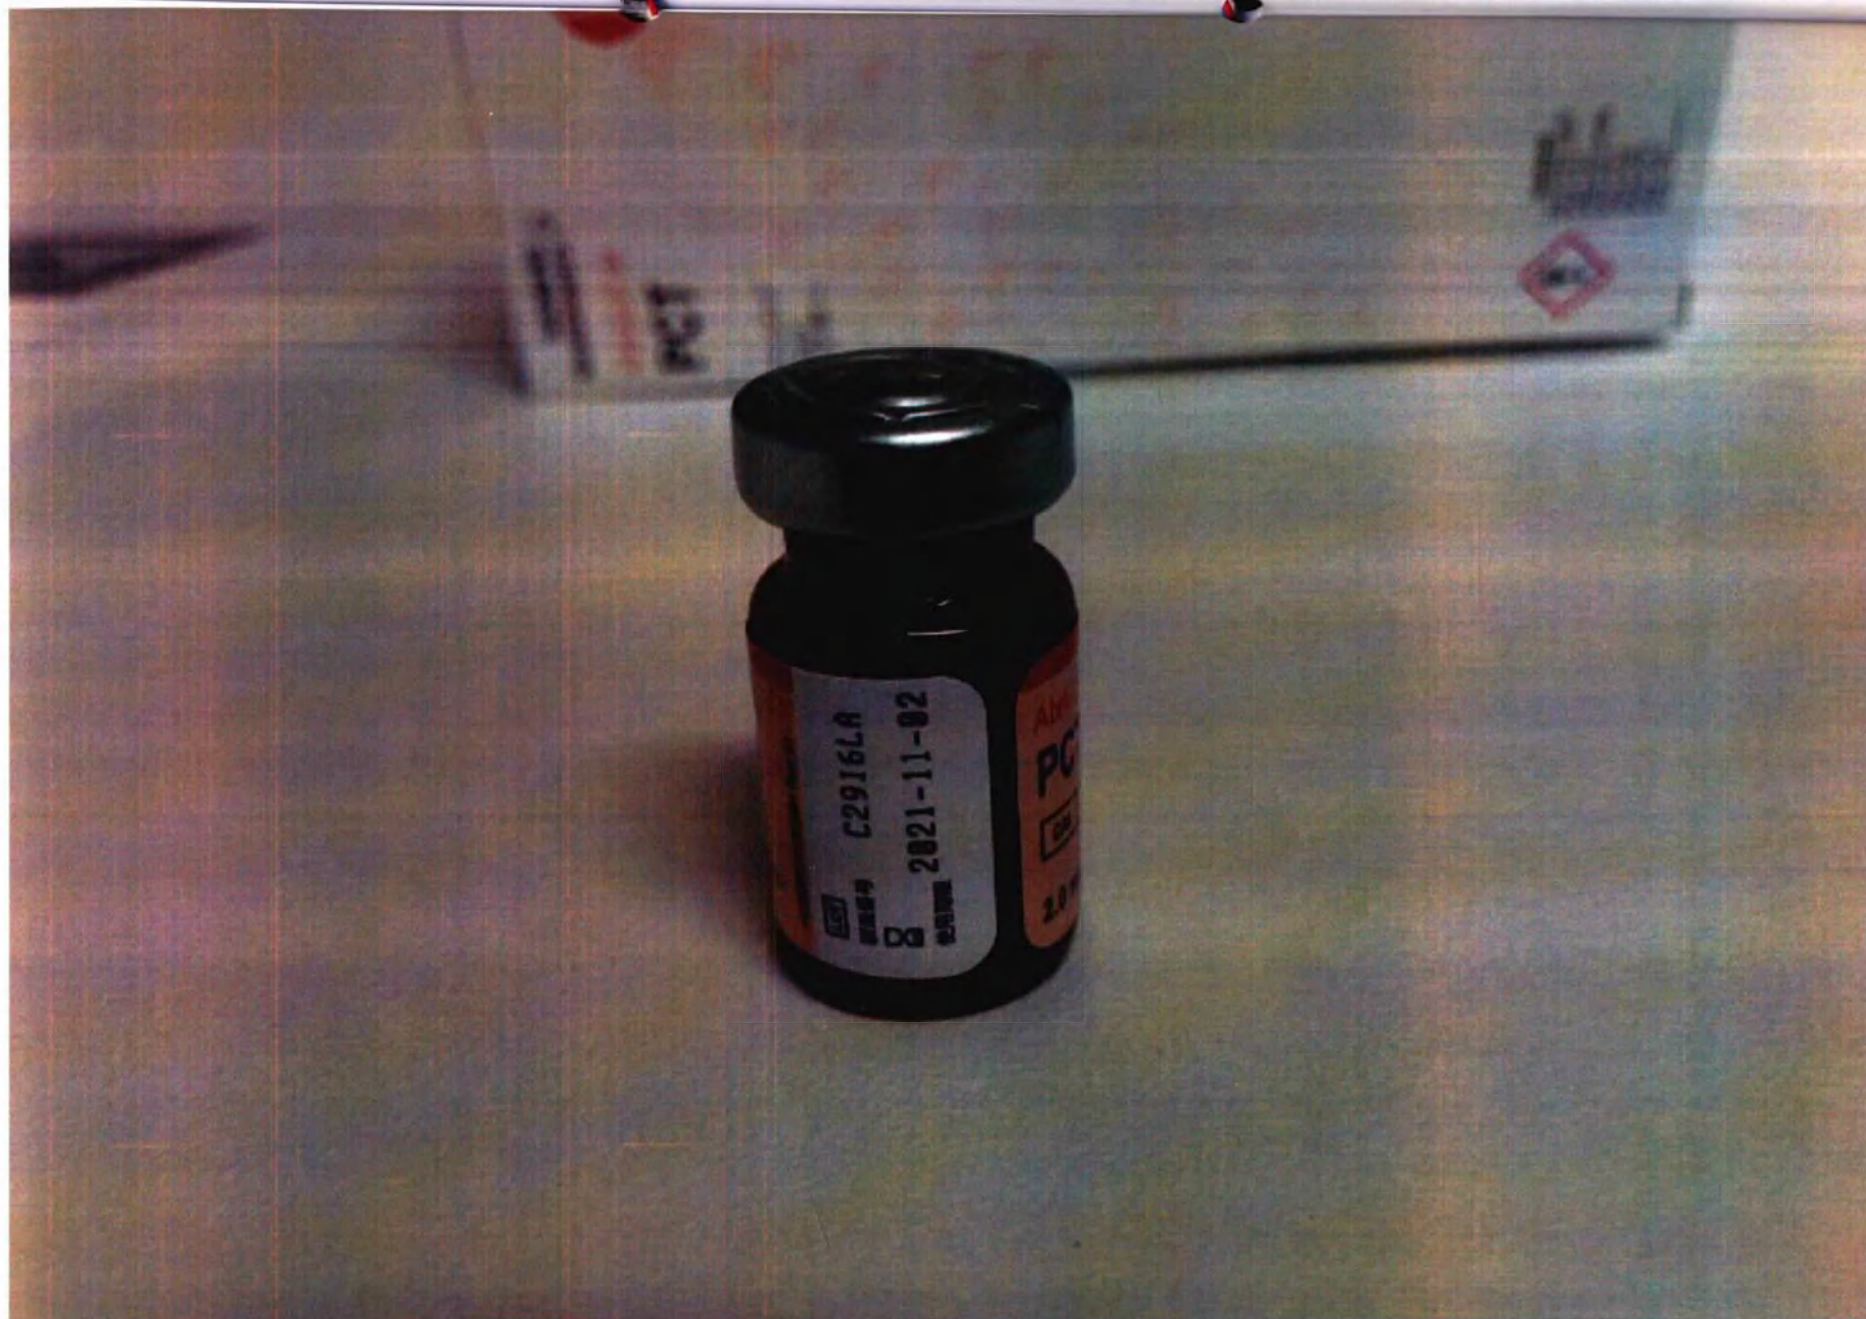


Рисунок 7. Набор реагентов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin (Atellica IM BRAHMS PCT)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM BRAHMS PCT CAL L, 2,0 мл

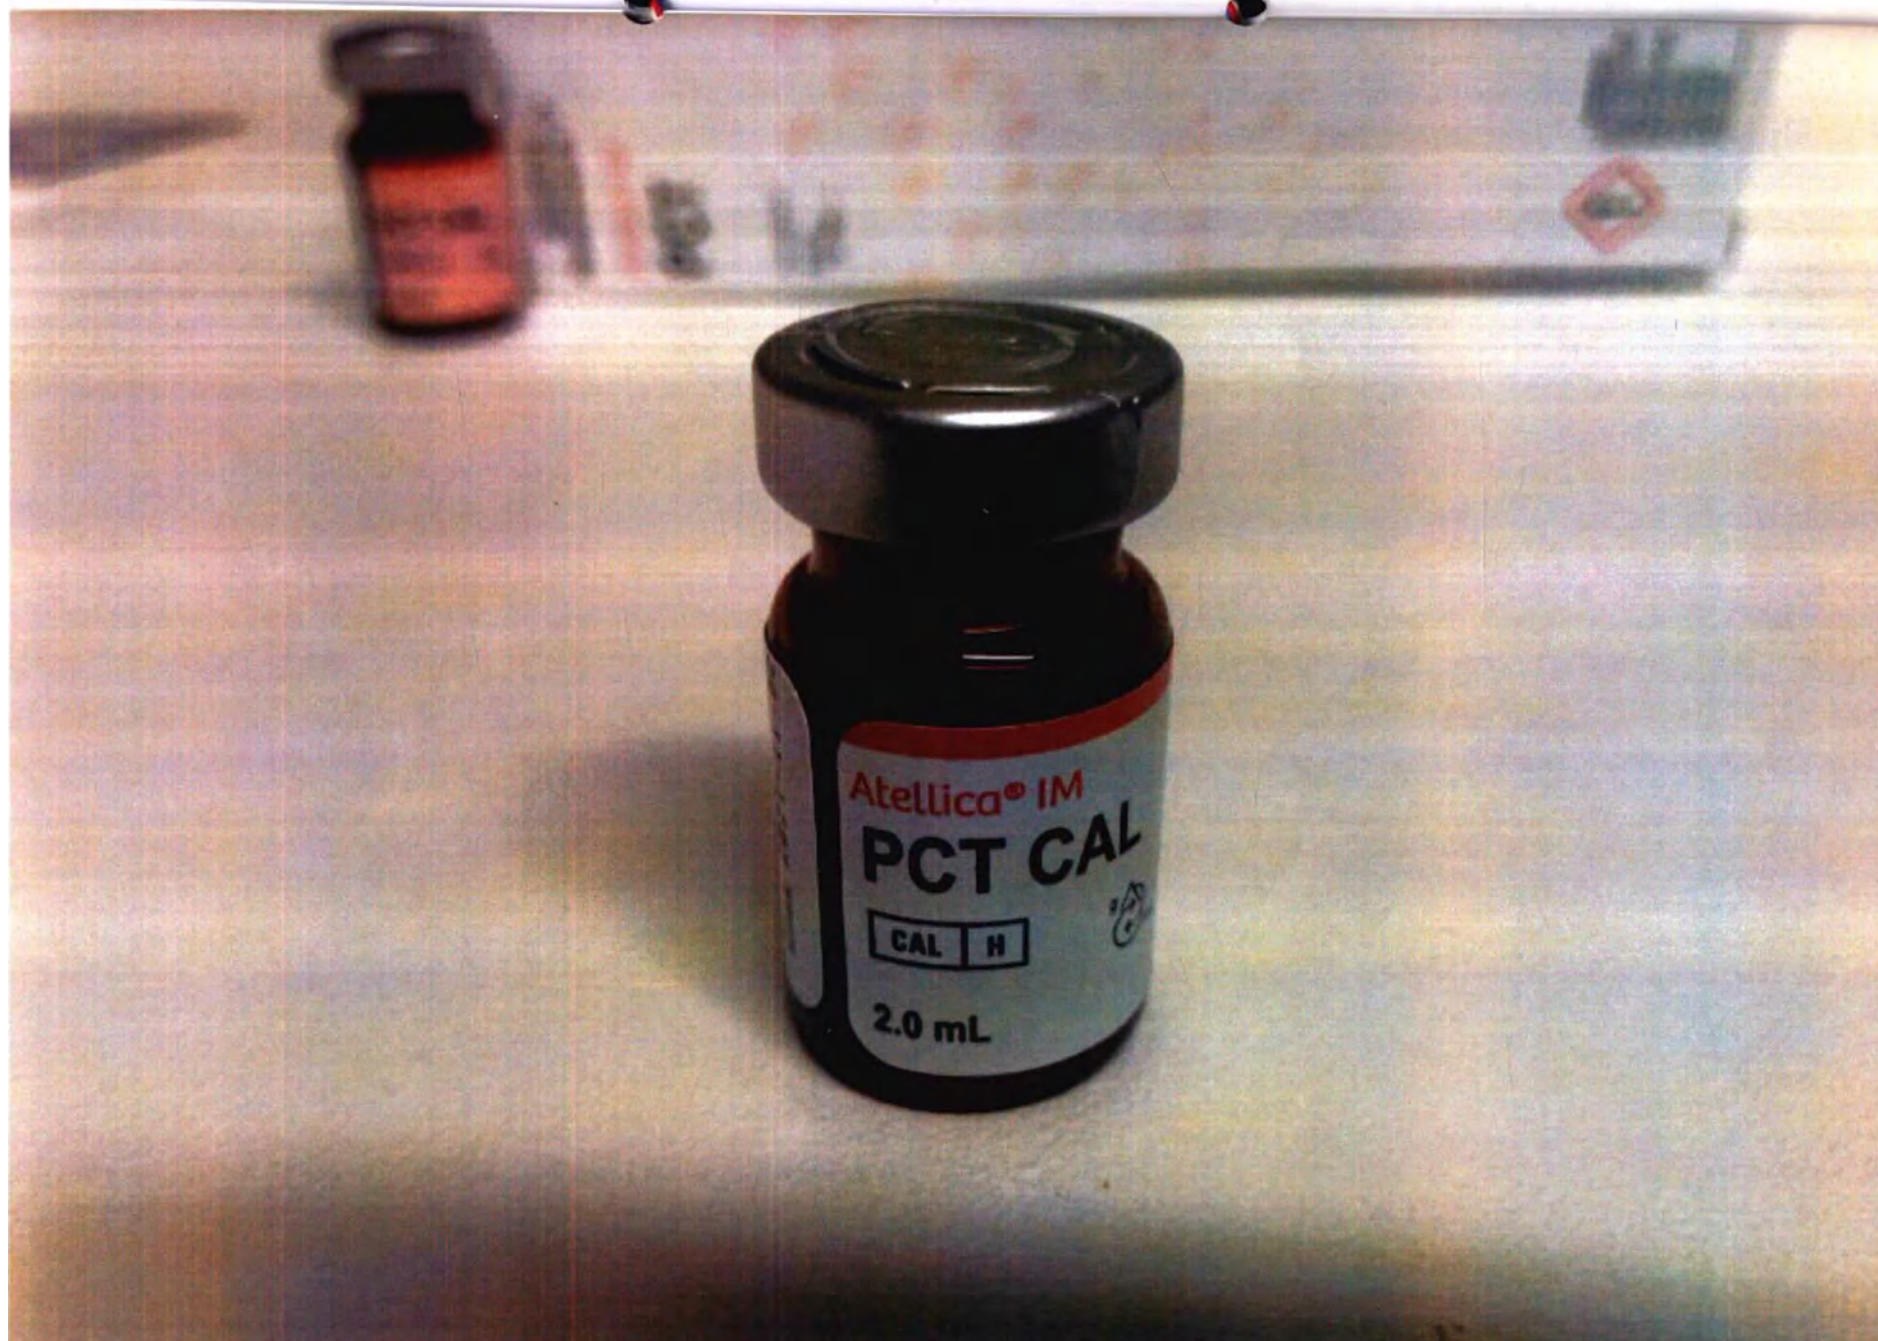


Рисунок 8. Набор реагентов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin (Atellica IM BRAHMS PCT)):
Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM BRAHMS PCT CAL H, 2,0 мл

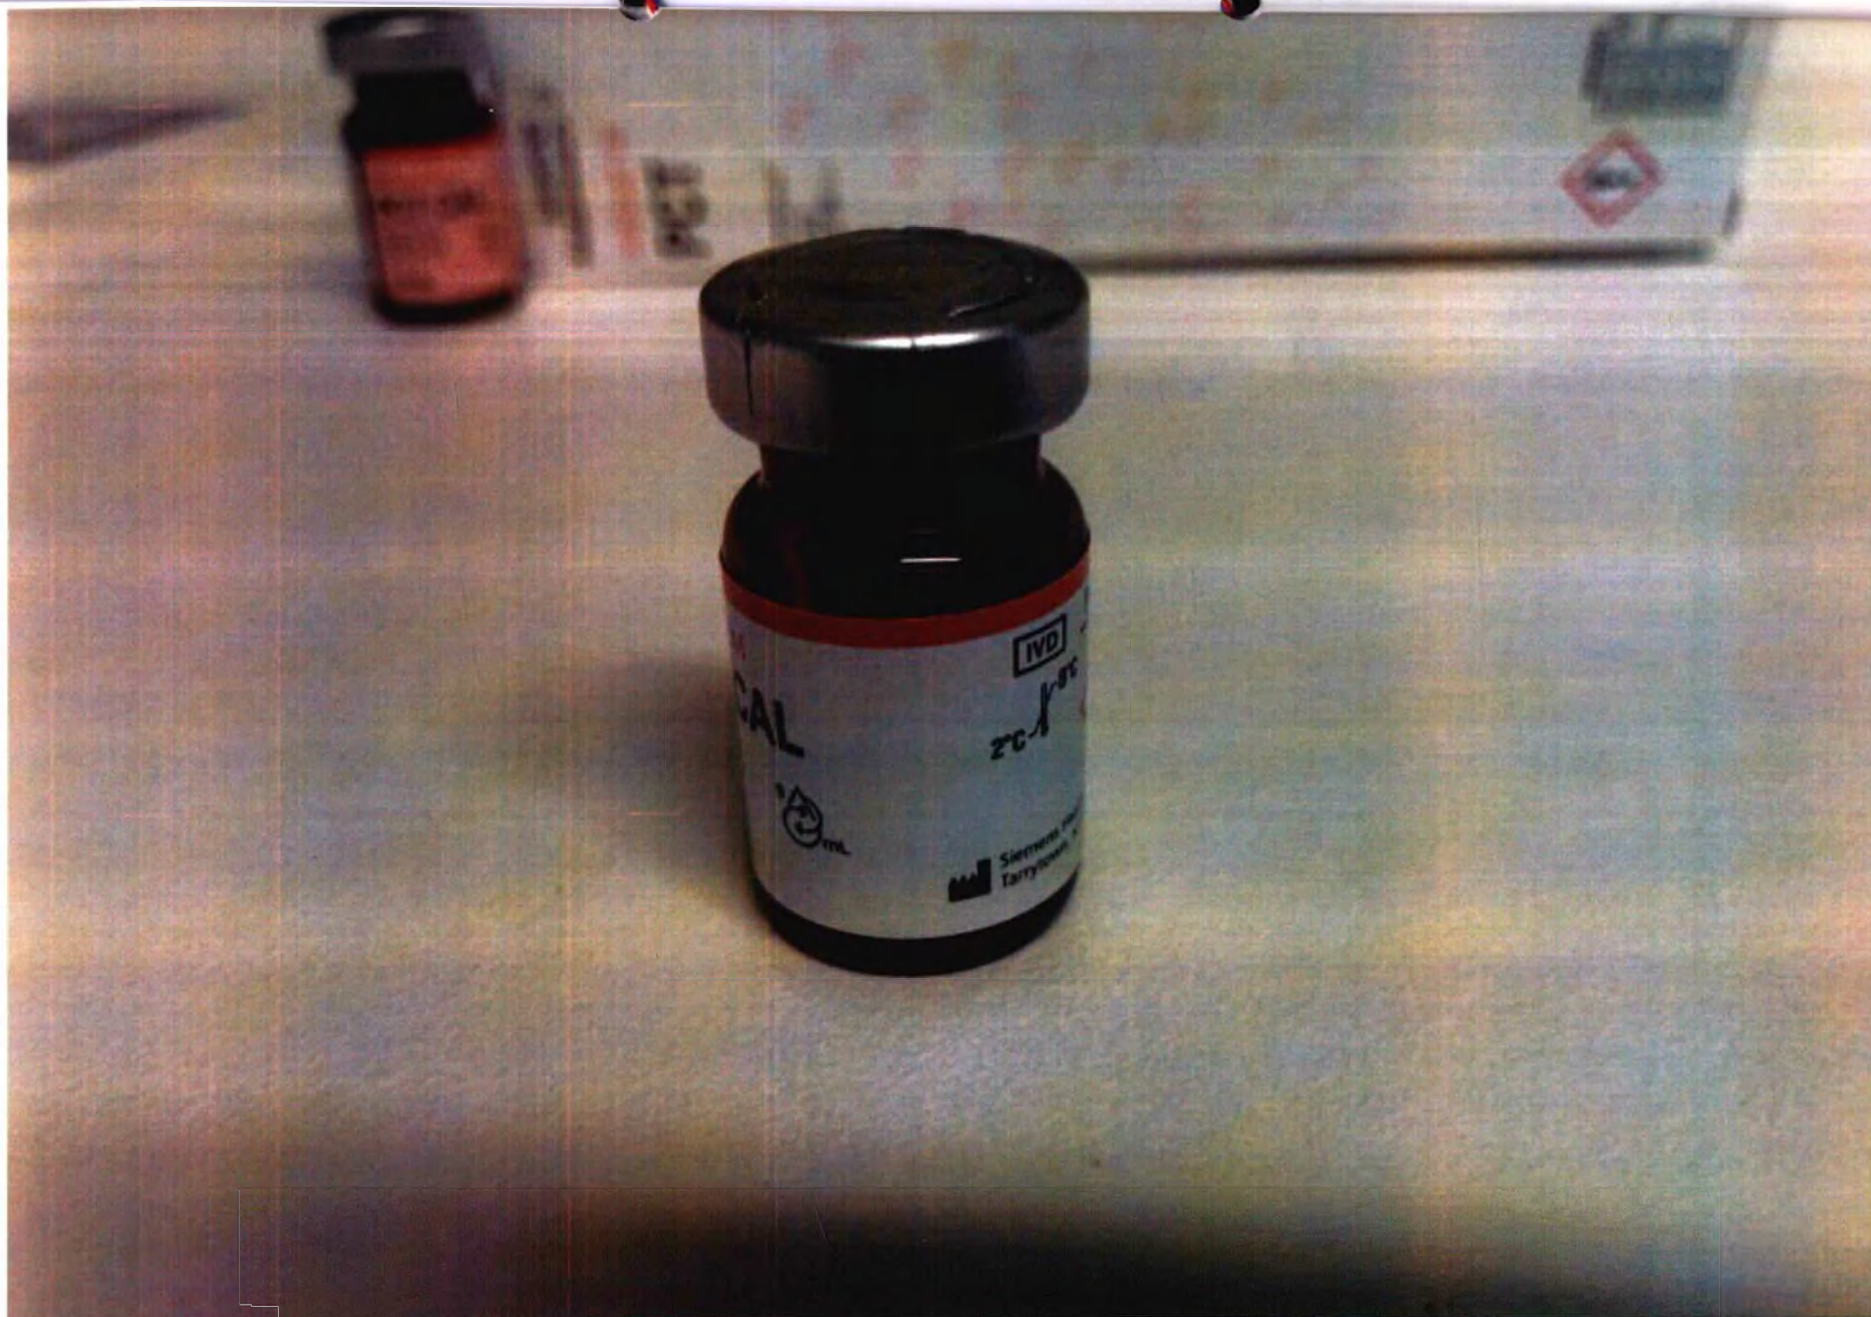


Рисунок 9. Набор реагентов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin (Atellica IM BRAHMS PCT)):
Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM BRAHMS PCT CAL H, 2,0 мл

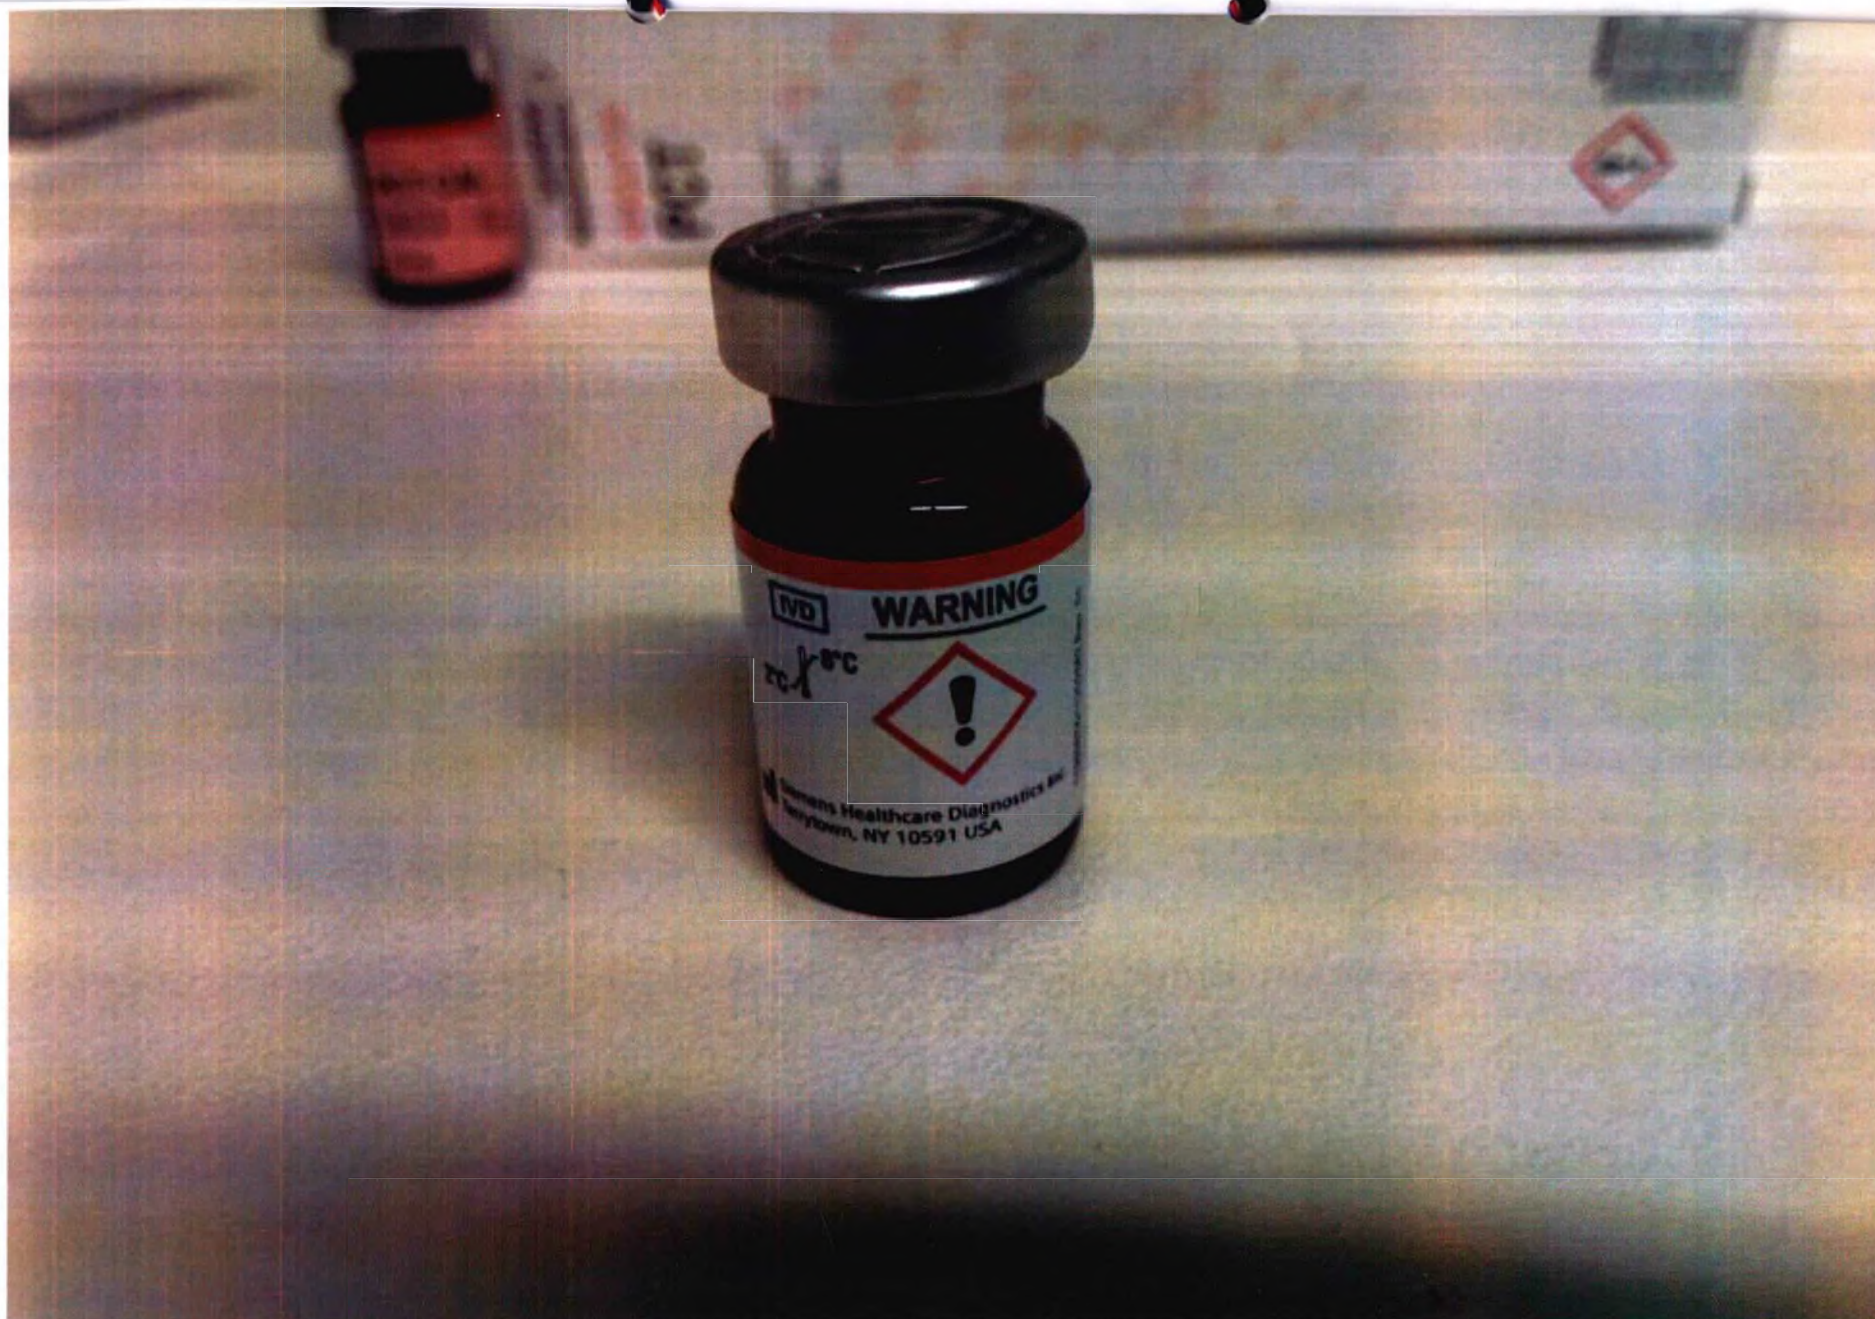


Рисунок 10. Набор реагентов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin (Atellica IM BRAHMS PCT)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM BRAHMS PCT CAL H, 2,0 мл

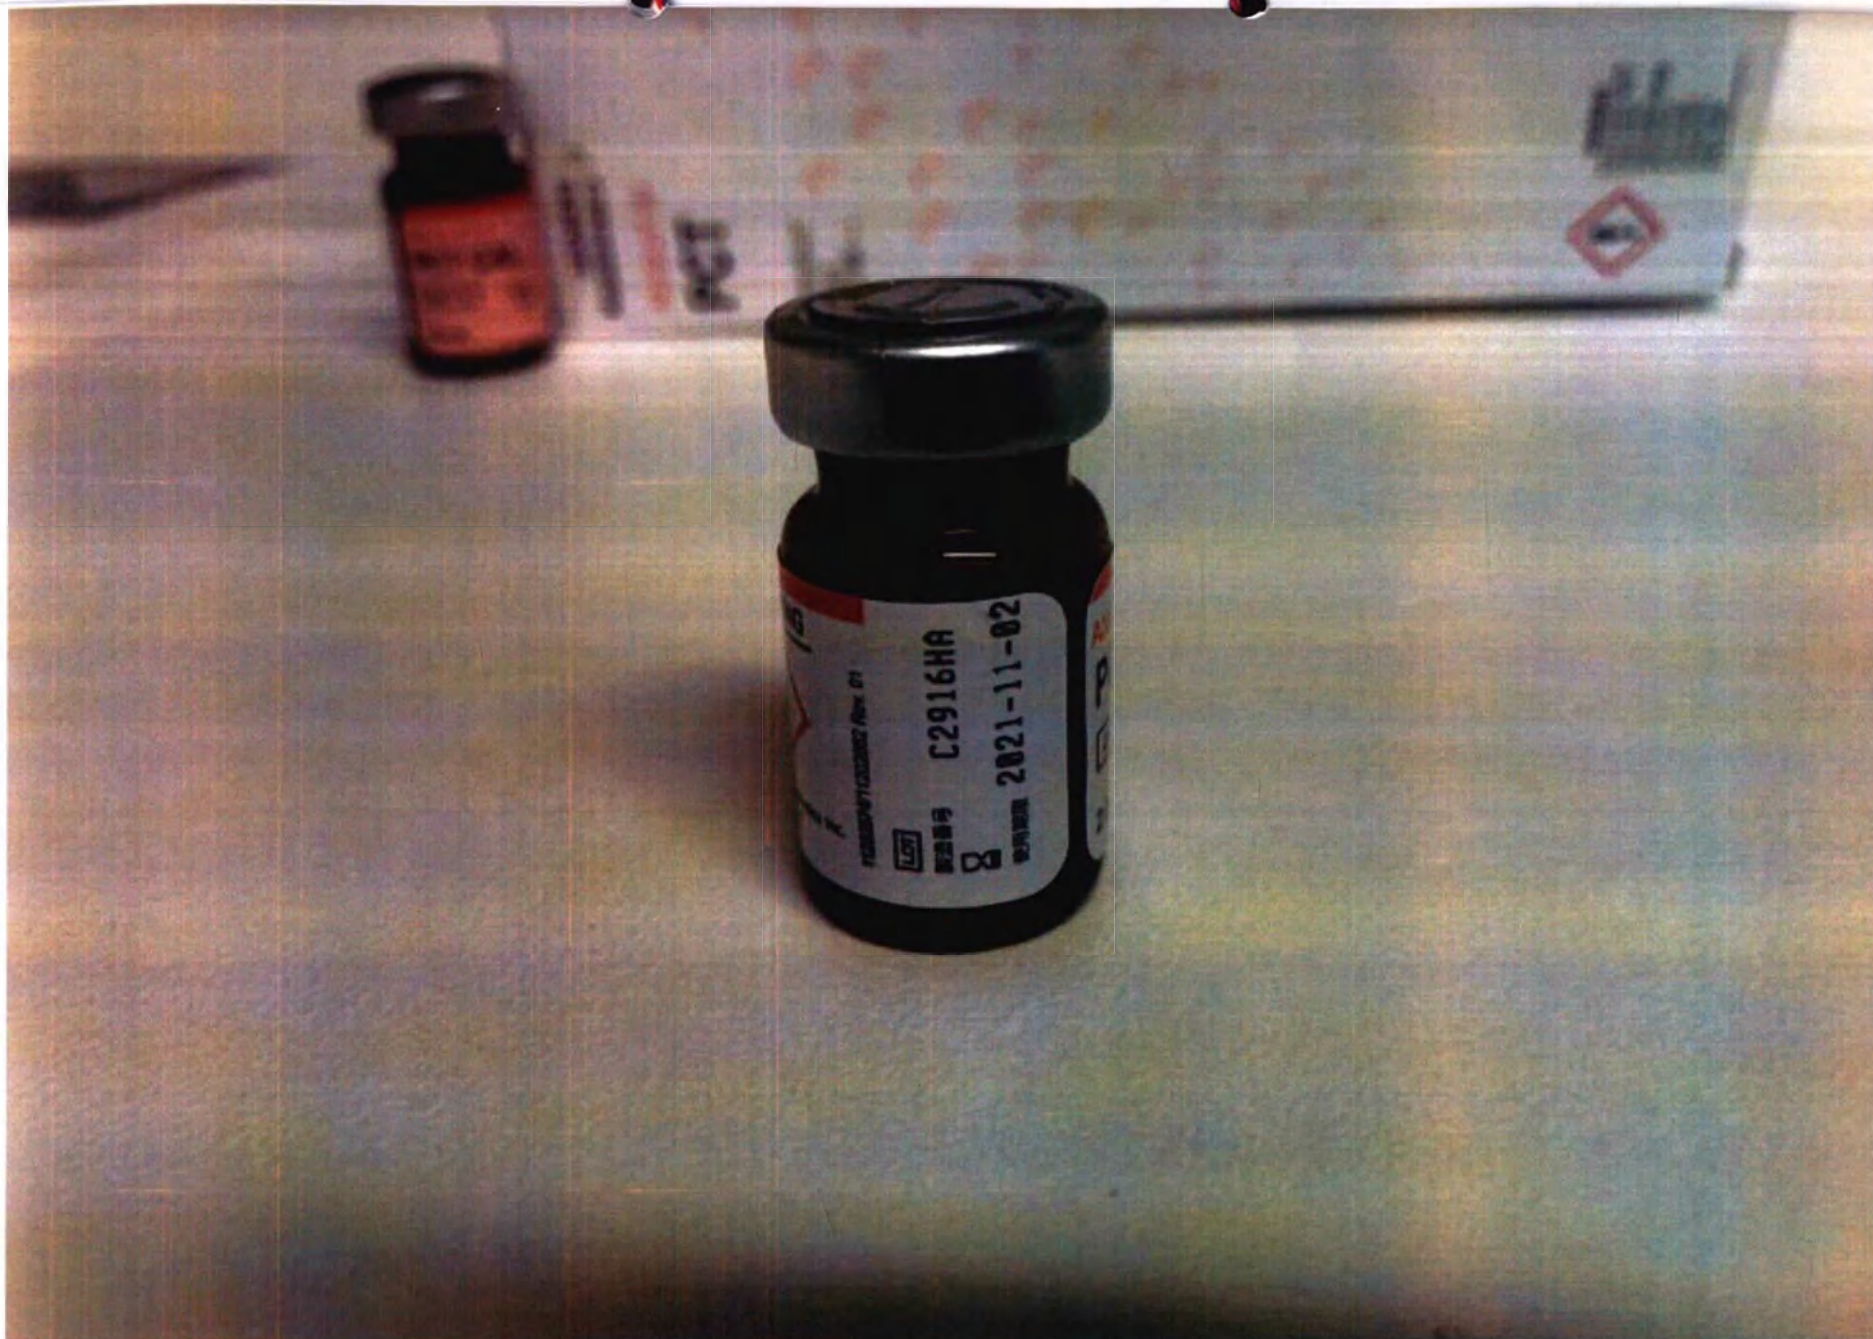


Рисунок 11. Набор реагентов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin (Atellica IM BRAHMS PCT)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM BRAHMS PCT CAL H, 2,0 мл

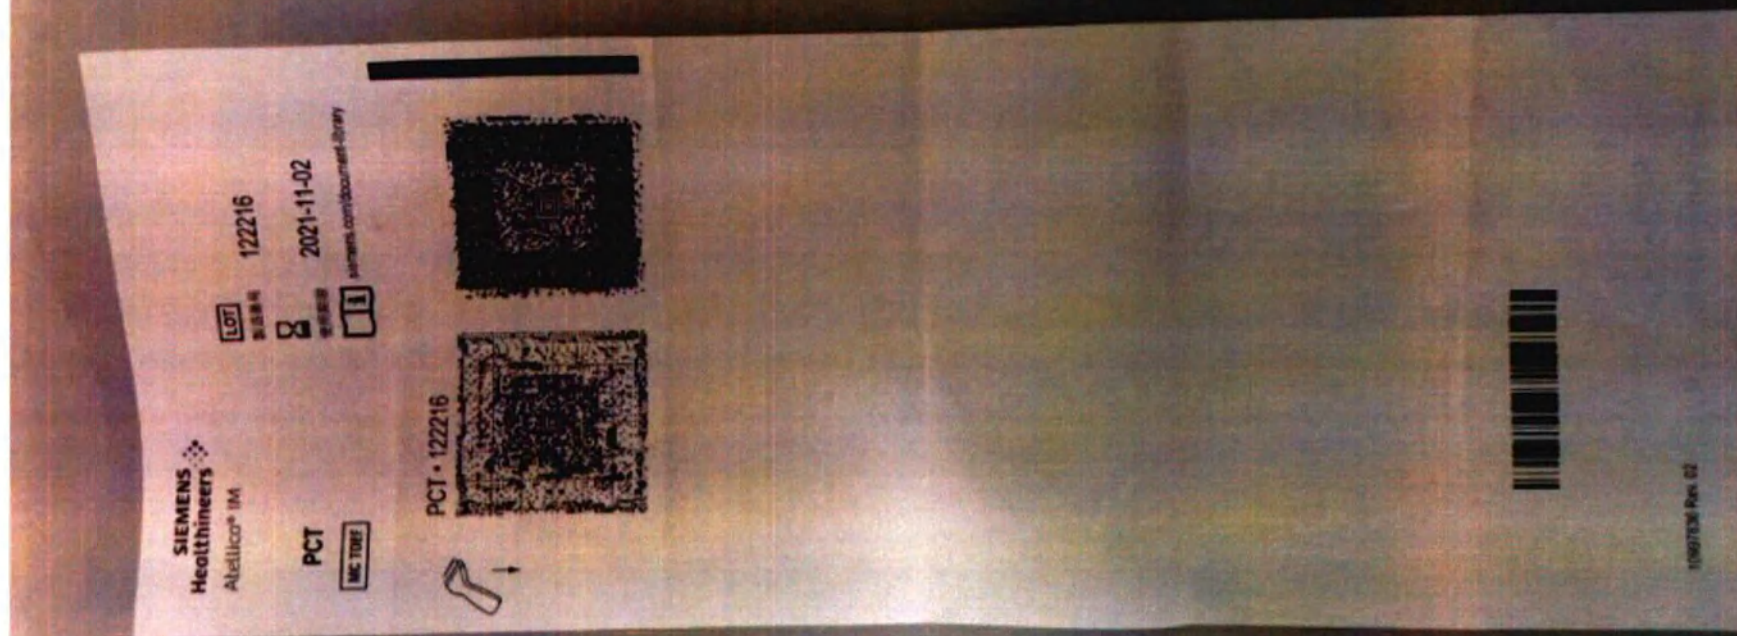


Рисунок 12. Набор реагентов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin (Atellica IM BRAHMS PCT)): ист значений параметров лота калибратора Atellica IM BRAHMS PCT CAL.

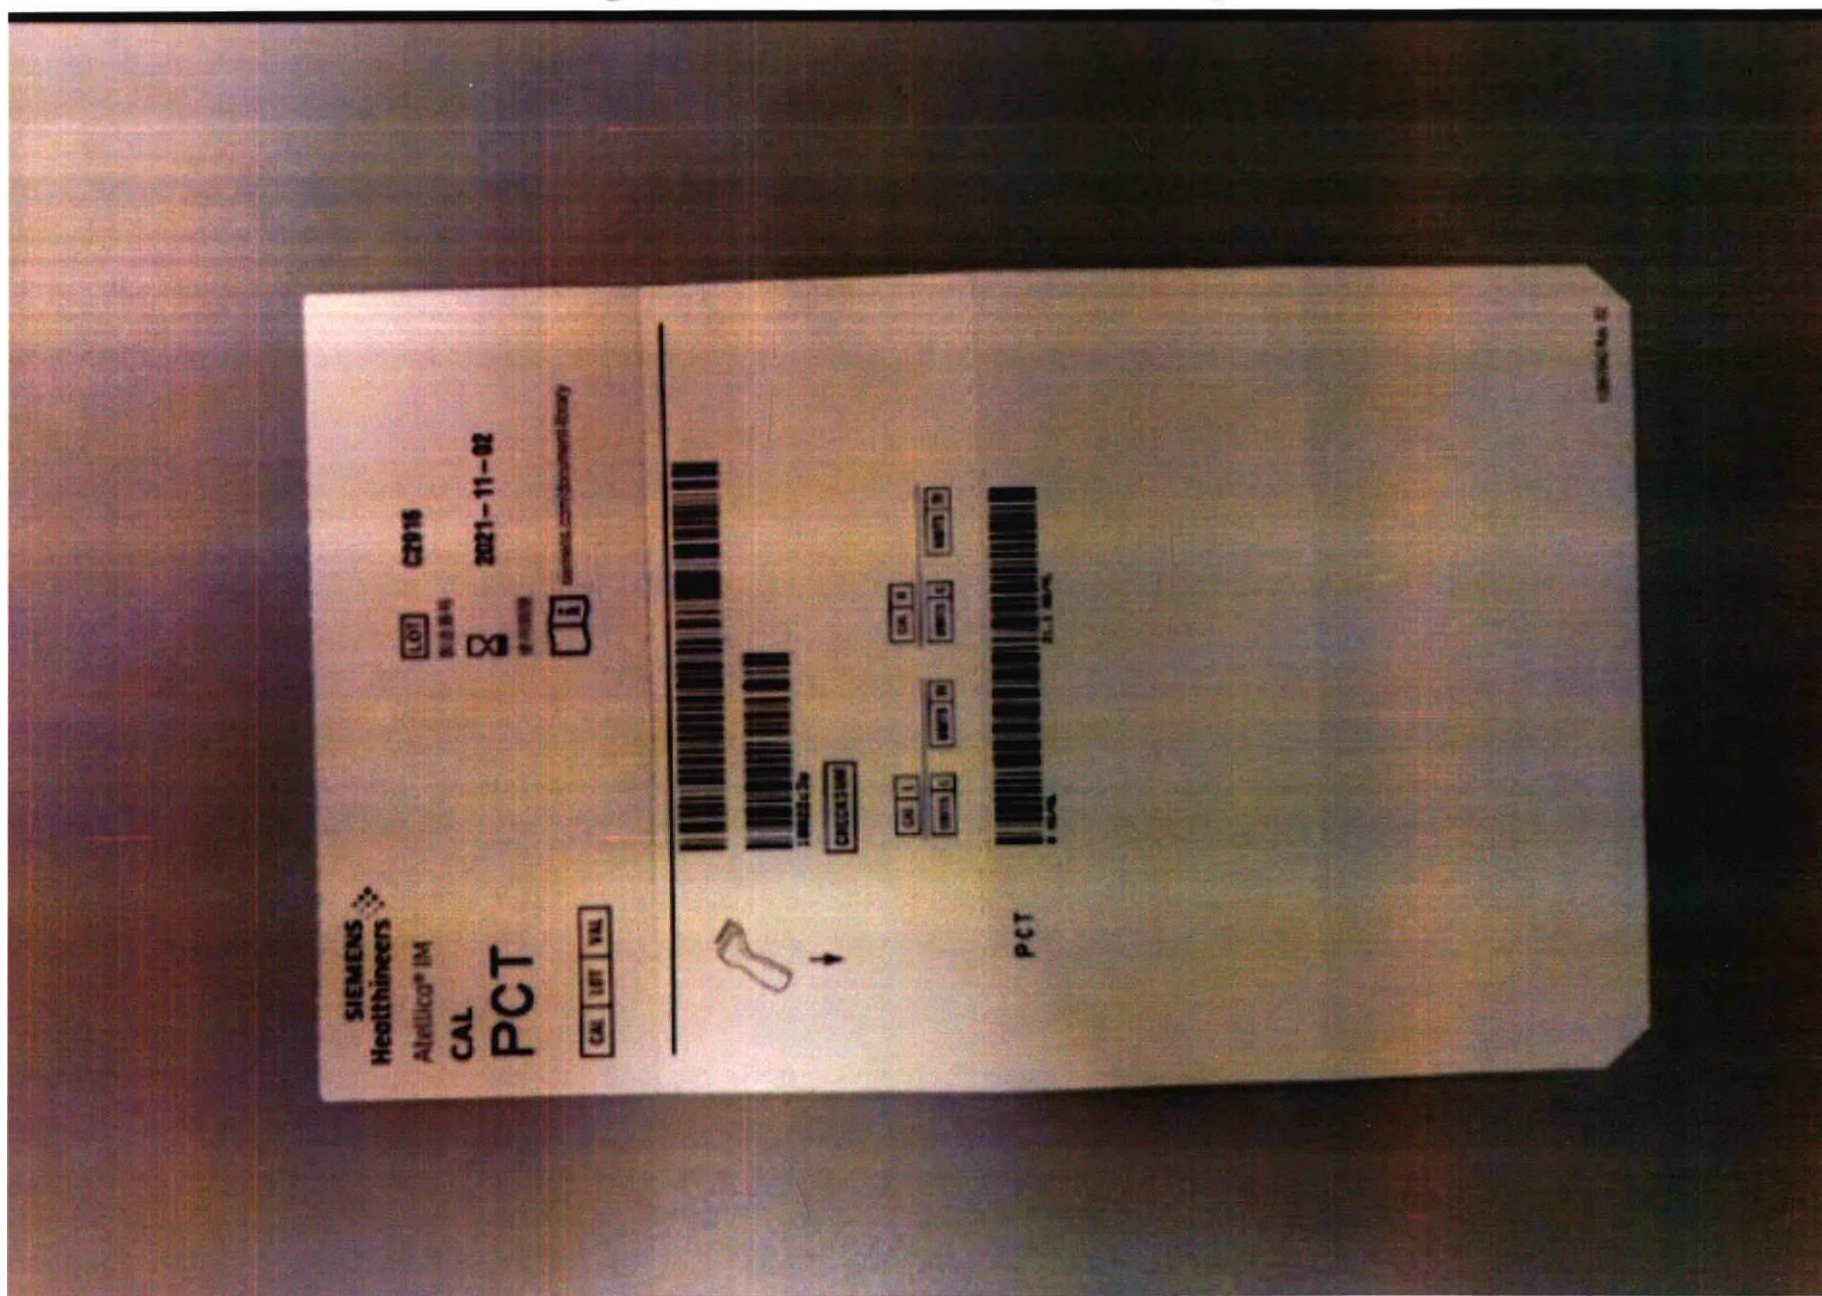


Рисунок 13. Набор реагентов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin (Atellica IM BRAHMS PCT)): Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM BRAHMS PCT.



Всего прошито и пронумеровано
14 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

