

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТПО»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе

Комплект 1 (общий вид)



Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»



О. Н. Шлюндин
2016 г.

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТПО»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе

Комплект 1 (общий вид)



Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»



О.Н. Шлюдин

2016 г.


ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТПО»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе

Комплект 2 (общий вид)

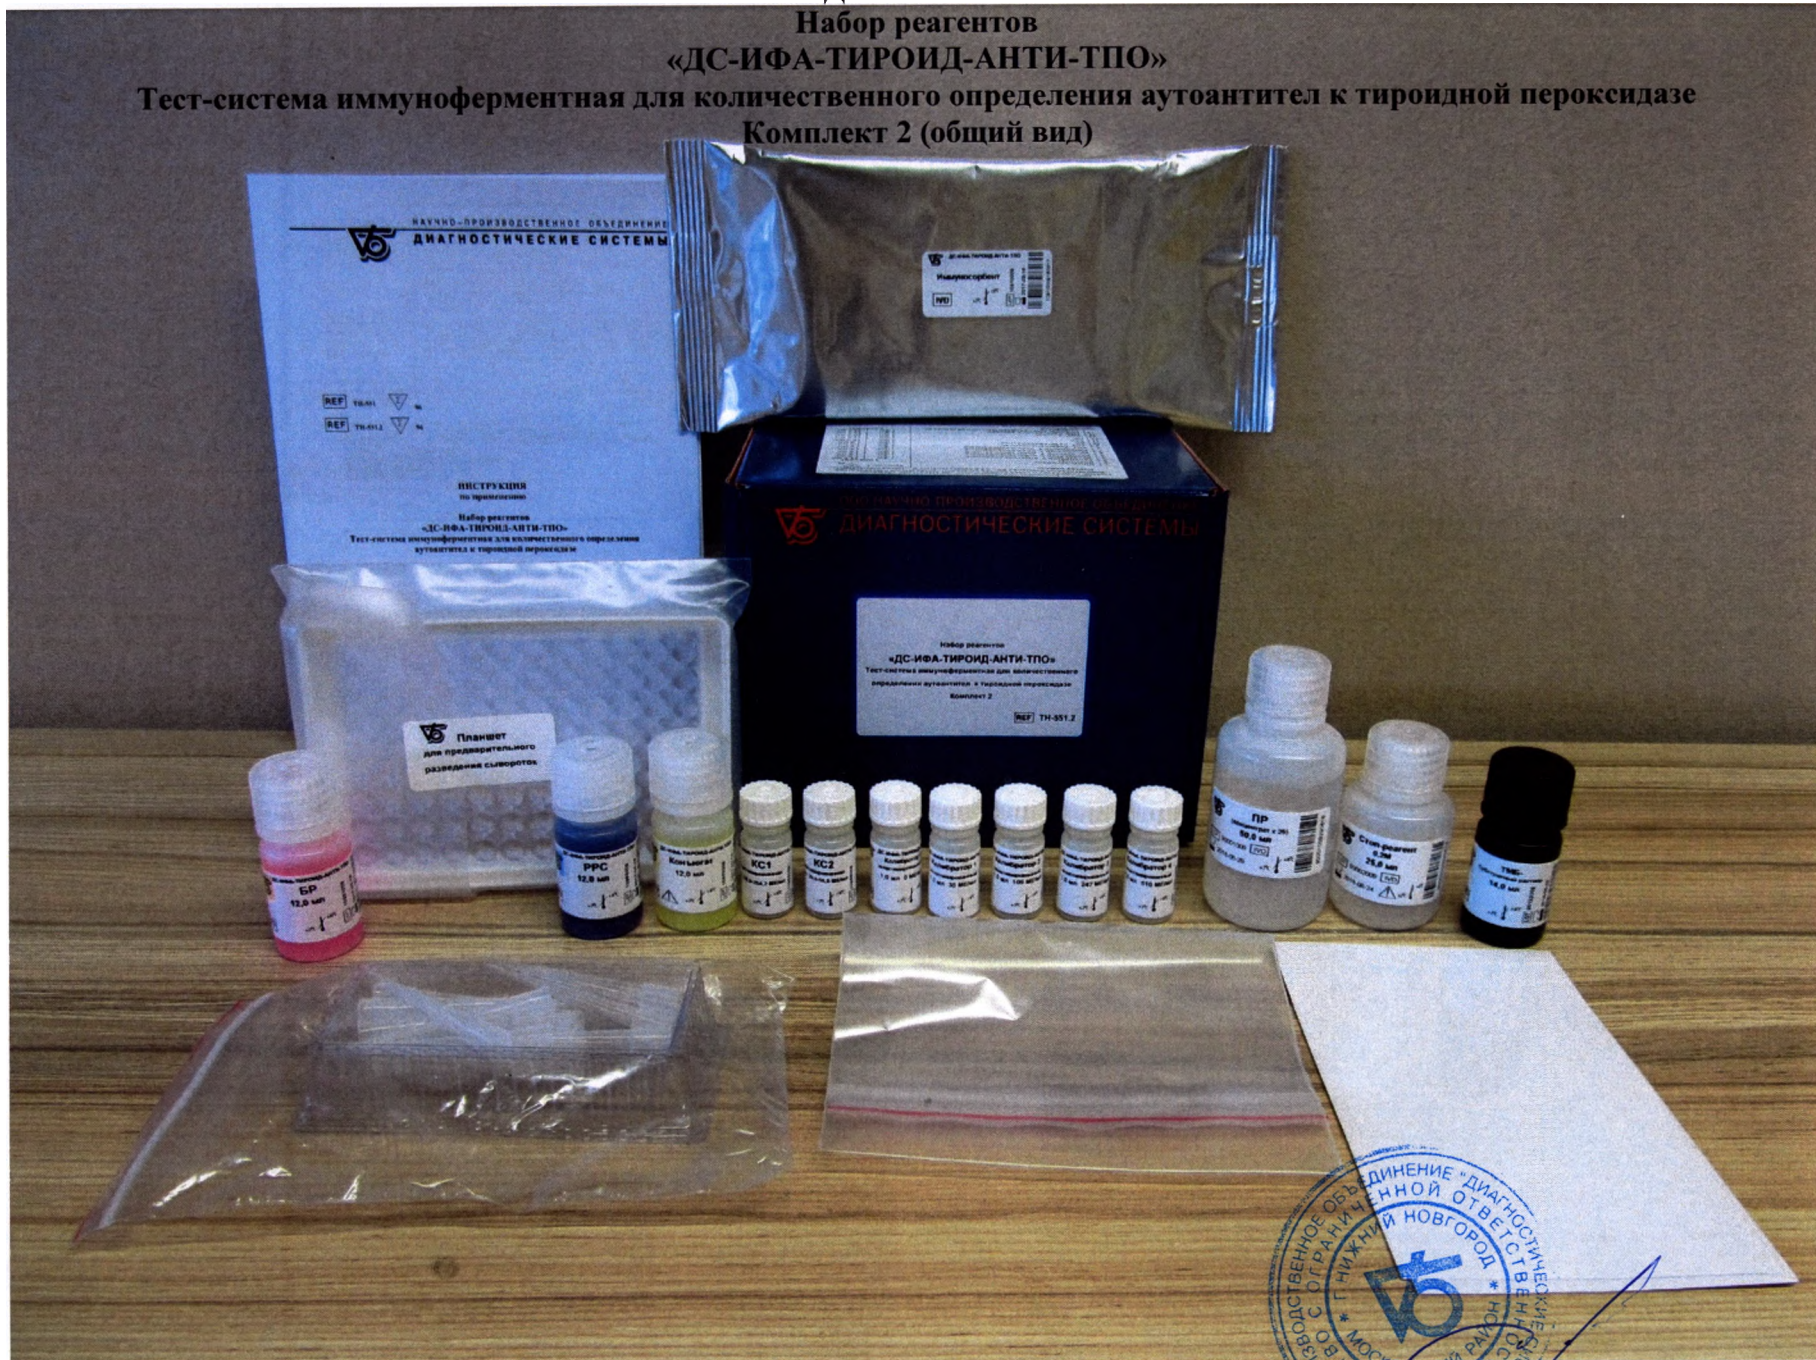

Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»

О. Н. Шлюндин

2016 г.

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТПО»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе

Комплект 2 (общий вид)



Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»

О. Н. Шлюдин

2016 г.

109-052-RU-03-00

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТПО»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе

Комплект 1 (вид сбоку)



ООО «НПО «Диагностические системы»
603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, 22
Тел/факс: (831) 434-86-83; 8-800-555-0300
E-mail: info@npods.ru; www.npods.ru

ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТПО

REF TH-551



2015-09

LOT 109009 экс.-пр.



2017-03-16

Срок годности: 18 мес.

РУ №

ТУ 9398-109-05941003-2015 (проект)



+2°C +8°C

Штрих-код:



ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТПО»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе

Комплект 2 (вид сбоку)



ООО «НПО «Диагностические системы»
603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, 22
Тел/факс: (831) 434-86-83; 8-800-555-0300
E-mail: info@npods.ru; www.npods.ru

ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТПО

REF TH-551.2



2015-09

LOT 109009 экс.-пр.

96


2017-03-16

Срок годности: 18 мес.

РУ №

ТУ 9398-109-05941003-2015 (проект)

Штрих-код:



Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»



О. Н. Шлюндин
2016 г.

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов «ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТПО»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе

Комплект 1 (вид сбоку)

«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».

Состав набора:		Комплект 1 	
1	Иммуносорбент	1 планшет	
2	Конъюгат	1 фл.	12,0 мл
3	Калибратор 0, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
4	Калибратор 1, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
5	Калибратор 2, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
6	Калибратор 3, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
7	Калибратор 4, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
8	КС1, инаktivированная	1 фл.	1,0 мл
9	БР	1 фл.	12,0 мл
10	РРС	1 фл.	12,0 мл
11	ПР	1 фл.	50,0 мл
12	Стоп-реагент	1 фл.	25,0 мл
13	ТМБ-Субстратный раствор	1 фл.	14,0 мл
14	Планшет для предварительного разведения сывороток	1 планшет	

Принадлежности:

Крышка к полистироловым 96-луночным планшетах (1 шт.) или плёнки защитные для ИФА-планшетов (2 шт.), наконечники одноразовые (16 шт.), ванночки пластиковые для жидких реагентов (2 шт.), пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.).



Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»

О. Н. Шлюндин
2016 г.

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТПО»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе

Комплект 2 (вид сбоку)

«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы. Антитела к ВИЧ-1.2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».

Состав набора:

Комплект 2



		1 планшет	
1	Иммуносорбент		
2	Конъюгат	1 фл.	12,0 мл
3	Калибратор 0, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
4	Калибратор 1, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
5	Калибратор 2, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
6	Калибратор 3, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
7	Калибратор 4, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
8	КС1, инаktivированная	1 фл.	1,0 мл
9	КС2, инаktivированная	1 фл.	1,0 мл
10	БР	1 фл.	12,0 мл
11	РРС	1 фл.	12,0 мл
12	ПР	1 фл.	50,0 мл
13	Стоп-реагент	1 фл.	25,0 мл
14	ТМБ-Субстратный раствор	1 фл.	14,0 мл
15	Планшет для предварительного разведения сывороток	1 планшет	

Принадлежности:

Крышка к полистироловым 96-луночным планшетах (1 шт.) или плёнки защитные для ИФА-планшетов (2 шт.), наконечники одноразовые (16 шт.), ванночки пластиковые для жидких реагентов (2 шт.), пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.).



Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»

О. Н. Шлюндин
2016 г.


ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ЛС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТПО»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе

Вскрытый ИФА-пластириловый разборный, в лунках которого сорбирован
антиген тиреоидной пероксидазы щитовидной железы человека

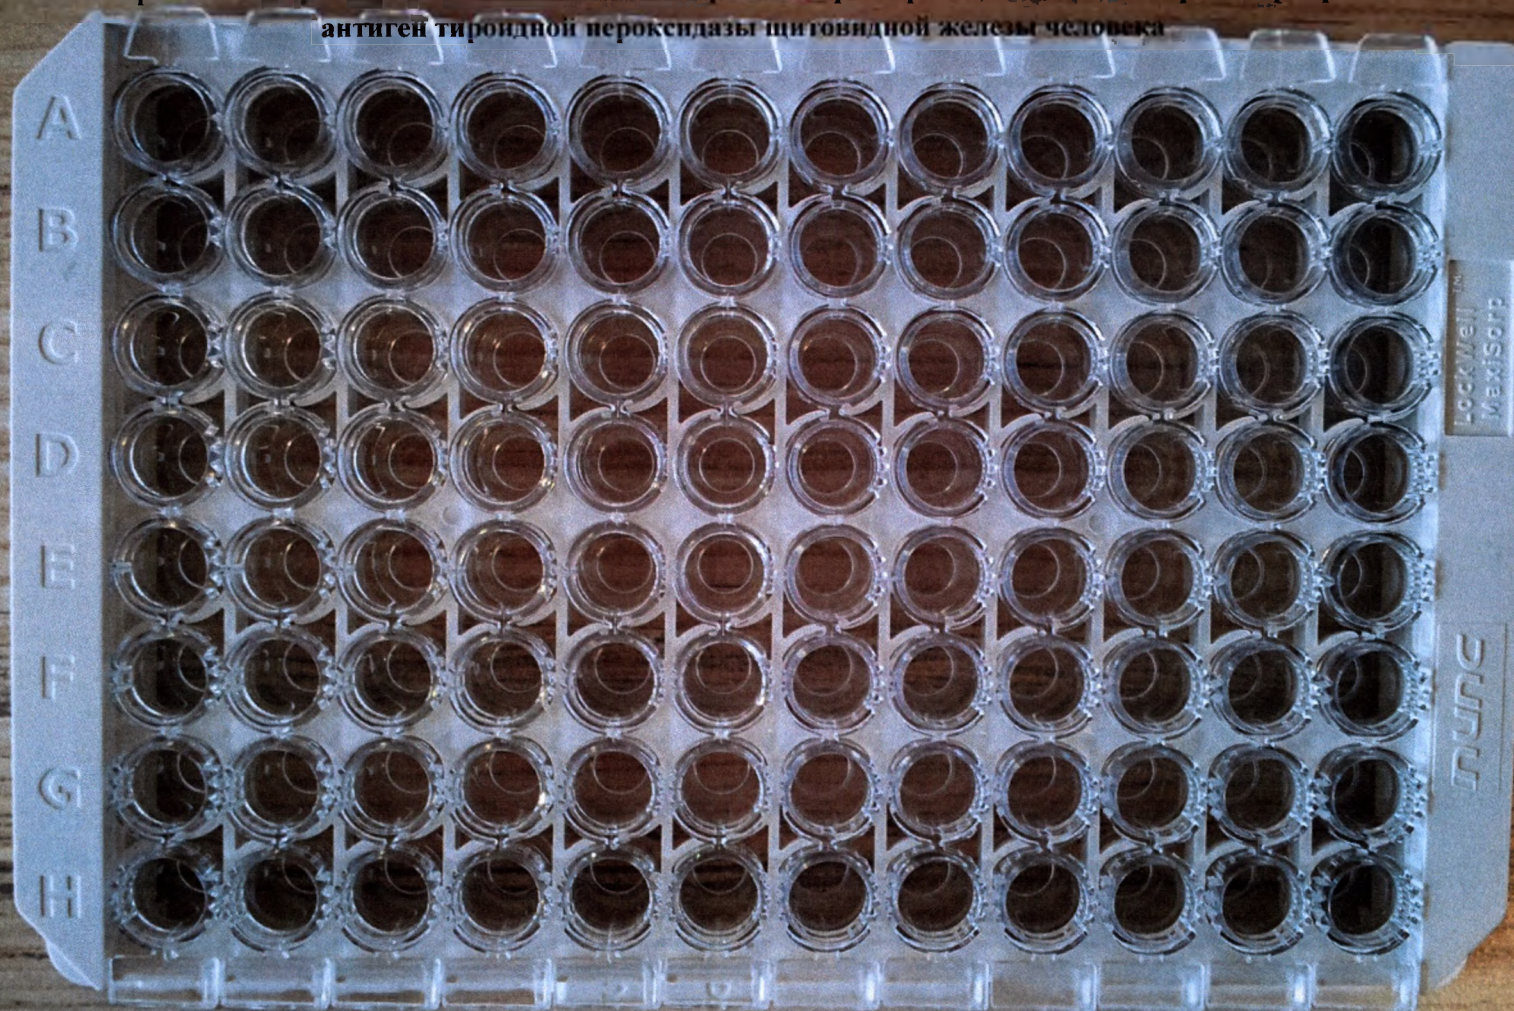

Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»



О. Н. Шлюндин
2016 г.