

ООО «НПО «Диагностические системы»
Набор реагентов
«ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G»
Тест-система иммуноферментная для выявления
антител класса IgG к *Chlamydia trachomatis* (общий вид)



Набор реагентов
«ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G»
 Тест-система иммуноферментная для выявления
 антител класса IgG к *Chlamydia trachomatis* (вид сбоку)

“Для профессионального применения”. “Не стерильно”.

“Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инактивированы.

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют”.

Состав набора

Σ 96

1	Иммуносорбент		1 планшет
2	Конъюгат	1 фл.	11,0 мл
3	К +, инактивированный	1 фл.	1,2 мл
4	К-, инактивированный	1 фл.	2,5 мл
5	БР	1 фл.	11,0 мл
6	PPC	1 фл.	11,0 мл
7	ПР	1 фл.	50,0 мл
8	Стоп-реагент	1 фл.	25,0 мл
9	ТМБ-Субстратный раствор	1 фл.	14,0 мл
10	Планшет для предварительного разведения сывороток		1 планшет

Принадлежности:

Крышка к полистироловым 96-луночным планшетам (1 шт.) или пленки защитные для ИФА-планшетов (2 шт.), наконечники одноразовые (16 шт.), ванночки пластиковые для жидких реагентов (2 шт.), пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.).

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G»

Тест-система иммуноферментная для выявления
антител класса IgG к *Chlamydia trachomatis* (вид сбоку)



ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G»

Тест-система иммуноферментная для выявления
антител класса IgG к *Chlamydia trachomatis* (вид сбоку)



ООО «НПО «Диагностические системы»
603093, Россия, Нижний Новгород, ул. Яблоневая, 22
Тел./факс: (831) 434-86-83, 8-800-555-0300
E-mail: info@npods.ru, www.npods.ru

Тест-система иммуноферментная для выявления
антител класса IgG к *Chlamydia trachomatis*

Вскрытый Иммуносорбент - планшет полистироловый разборный, в лунках которого сорбированы антигены *Chlamydia trachomatis*





ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G»

Тест-система иммуноферментная для выявления
антител класса IgG к *Chlamydia trachomatis* (принадлежности)

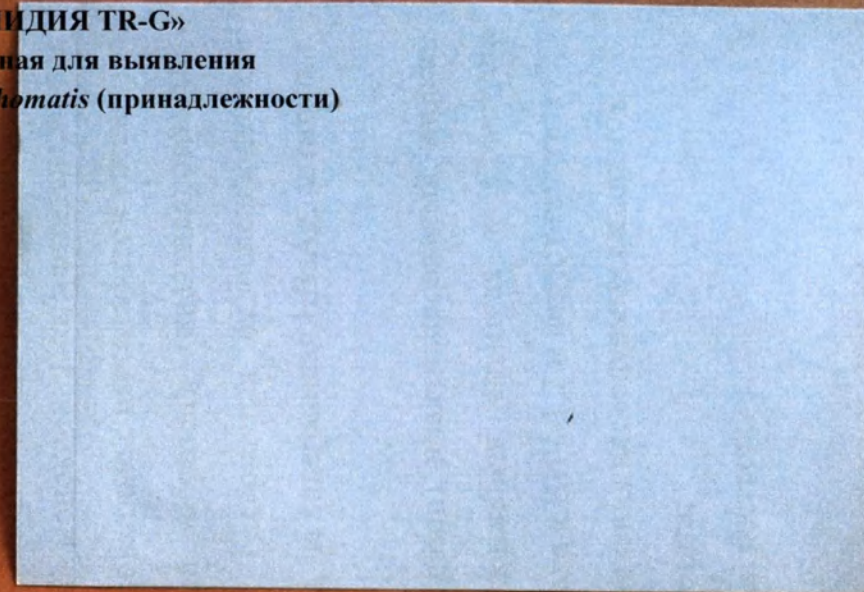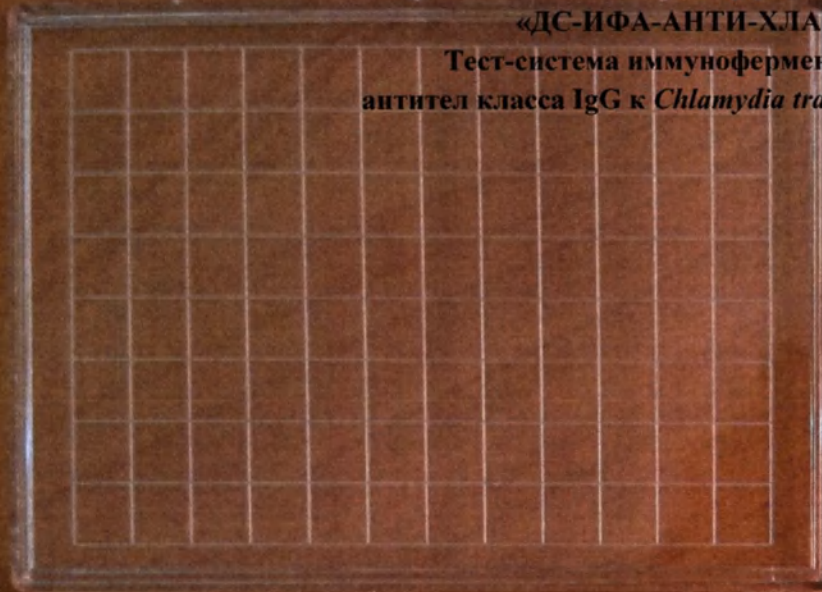



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»

О. Н. Шлюндин

«16» *сентября* 2015 г.

Маркировка медицинского изделия

Набора реагентов
«ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G»
Тест-система иммуноферментная
для выявления антител класса IgG к *Chlamydia trachomatis*
производства ООО «НПО «Диагностические системы»

1. Маркировка внешней упаковки



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



ООО «НПО «Диагностические системы»
603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, 22
Тел/факс: (831) 434-86-83; 8-800-555-0300
E-mail: info@npods.ru; www.npods.ru

Набора реагентов
«ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G»
Тест-система иммуноферментная
для выявления антител класса IgG к *Chlamydia trachomatis*

REF

IVD



ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G

REF



LOT



Срок годности

РУ №

ТУ

Штрих-код

«Для профессионального применения». «Не стерильно».

«Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инактивированы.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».

Состав набора:

Σ 96

		1 планшет	
1	Иммуносорбент		
2	Конъюгат	1 фл.	11,0 мл
3	К+, инактивированный	1 фл.	1,2 мл
4	К-, инактивированный	1 фл.	2,5 мл
5	БР	1 фл.	11,0 мл
6	PPC	1 фл.	11,0 мл
7	ПР	1 фл.	50,0 мл
8	Стоп-реагент	1 фл.	25,0 мл
9	ТМБ-Субстратный раствор	1 фл.	14,0 мл
10	Планшет для предварительного разведения сывороток	1 планшет	

Принадлежности:

Крышка к полистироловым 96-луночным планшетам (1 шт.) или плёнки защитные для ИФА планшетов (2 шт.), наконечники одноразовые (16 шт.), ванночки пластиковые для жидких реагентов (2 шт.), пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.).

2. Маркировка внутренней упаковки

ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G ИММУНОСОРБЕНТ IVD LOT Штрих-код	ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G Конъюгат 11,0 мл IVD LOT Штрих-код	ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G К+ инактивированный 1,2 мл IVD LOT Штрих-код
ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G К- инактивированный 2,5 мл IVD LOT Штрих-код	ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G БР 11,0 мл IVD LOT Штрих-код	ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G PPC 11,0 мл IVD LOT Штрих-код
ПР (концентрат x 25) 50,0 мл IVD LOT Штрих-код	СТОП-РЕАГЕНТ 0,2M 25,0 мл IVD LOT Штрих-код	ТМБ-Субстратный раствор 14,0 мл IVD LOT Штрих-код
мешет для предварительного разведения сывороток		

3. Маркировка групповой упаковки



ООО «НПО «Диагностические системы»
603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, 22
Тел/факс: (831) 434-86-83; 8-800-555-0300
E-mail: info@npods.ru; www.npods.ru

Набора реагентов
«ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G»
Тест-система иммуноферментная
для выявления антител класса IgG к *Chlamydia trachomatis*

REF

LOT



IVD

«Не стерильно»

Срок годности набора (кол-во мес.) _____

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

Число единиц потребительской упаковки _____



Разработал:
Менеджер по регистрации

И.С. Голубева
« 16 » апреля 2015 г.

Согласовали:
Директор по производству к.б.н.
В.К. Пименов
« 16 » апреля 2015 г.

Директор по качеству
М.Н. Кокорева
« 16 » апреля 2015 г.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
3 () листов(а)
цифрами



личная подпись

Гайденко В.П.