

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов
«ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-G»
Тест-система иммуноферментная для выявления антител
класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (общий вид)



Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»

О. Н. Шлюндин
«*О.Н. Шлюндин*» 2016 г.

**Набор реагентов
«ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-G»**
Тест-система иммуноферментная для выявления антител
класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (вид сбоку)

"Для профессионального применения". "Не стерильно".

"Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инактивированы. Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют".

Состав набора



1. Иммуносорбент	1 планшет	
2. Конъюгат	1 фл.	11,0 мл
3. К+, инактивированный	1 фл.	1,2 мл
4. К-, инактивированный	1 фл.	2,5 мл
5. БР	1 фл.	11,0 мл
6. РРС	1 фл.	11,0 мл
7. ПР	1 фл.	50,0 мл
8. Стоп-реагент	1 фл.	25,0 мл
9. ТМБ-Субстратный раствор	1 фл.	14,0 мл
10. Планшет для предварительного разведения сывороток	1 планшет	

Принадлежности:

Крышки к полистироловым 96-луночным планшетам (1 шт.) или плёнки защитные для ИФА планшетов (2 шт.), наконечники одноразовые (16 шт.), ванночки пластиковые для жидких реагентов (2 шт.), пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.)

Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»

О. Н. Шлюндин

«06» апреля 2016 г.

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-Г»

Тест-система иммуноферментная для выявления антител
класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (вид сбоку)



ООО «НПО «Диагностические системы»
Набор реагентов
«ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-G-АВИДНОСТЬ»
Тест-система иммуноферментная для определения
индекса авидности антител класса IgG
к вирусу простого герпеса 2 типа (вид сбоку)



Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»

О. Н. Шлюндин

«07» апреля 2016 г.


ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-G»

Тест-система иммуноферментная для выявления антител
класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа

Вскрытый Иммуносорбент - планшет полистироловый разборный, в лунках которого сорбирован рекомбинантный антиген ВПГ 2 типа

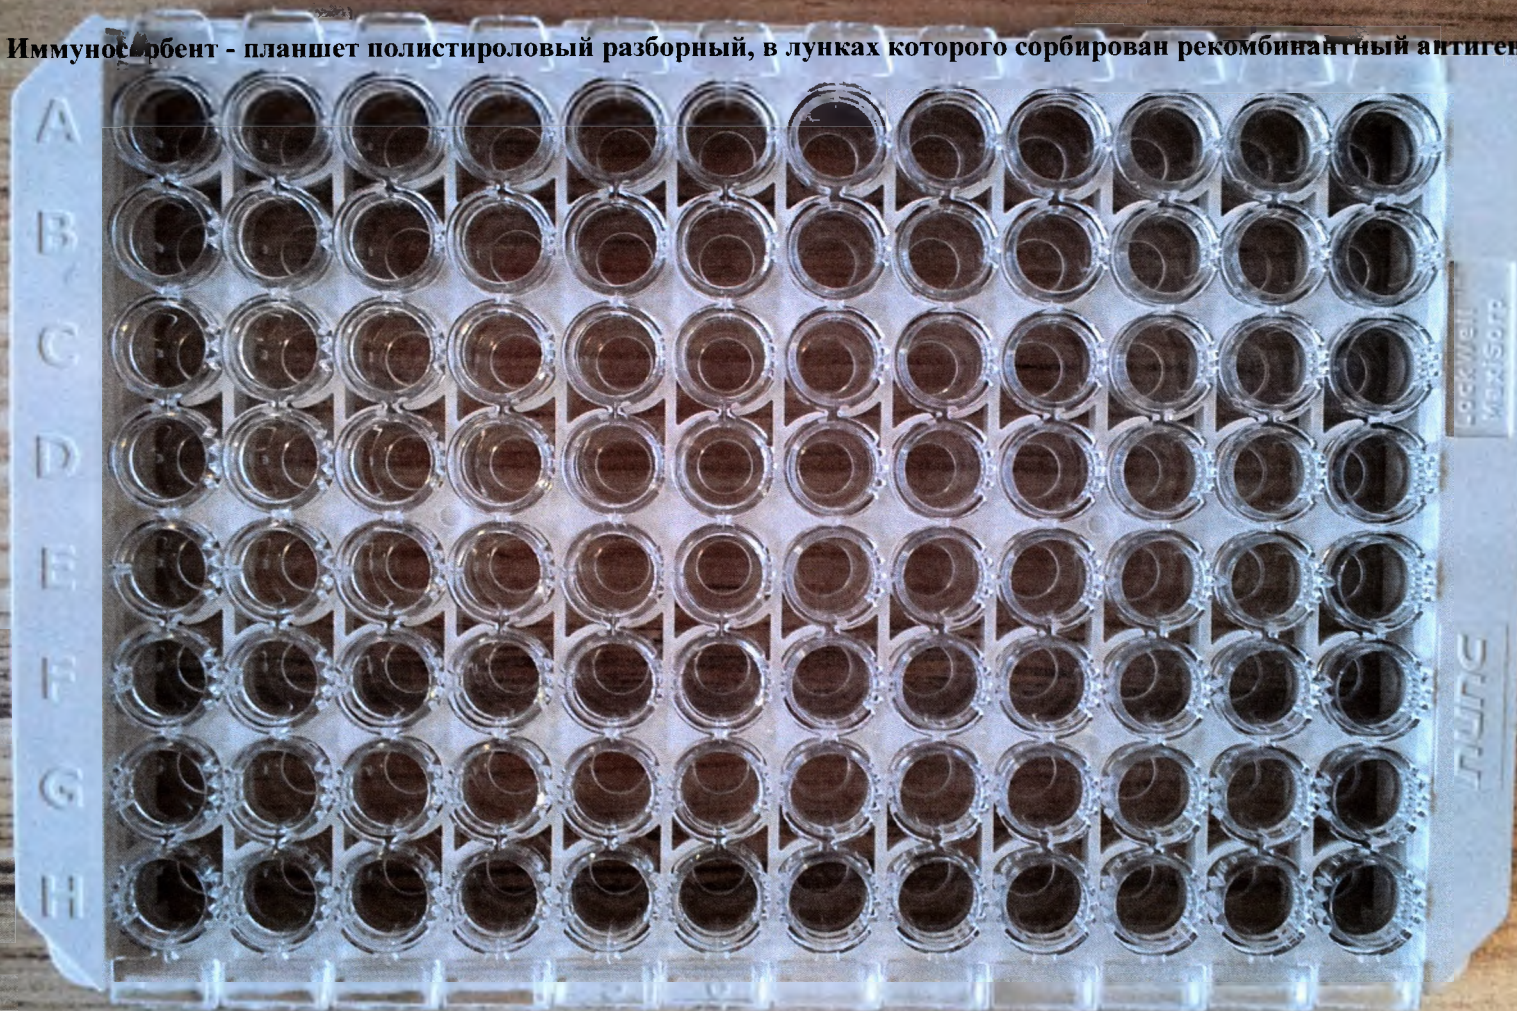

Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»

О. Н. Шлюндин


«*О. Шлюндин*» 2016 г.

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-G»

Тест-система иммуноферментная для выявления антител
класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (принадлежности)

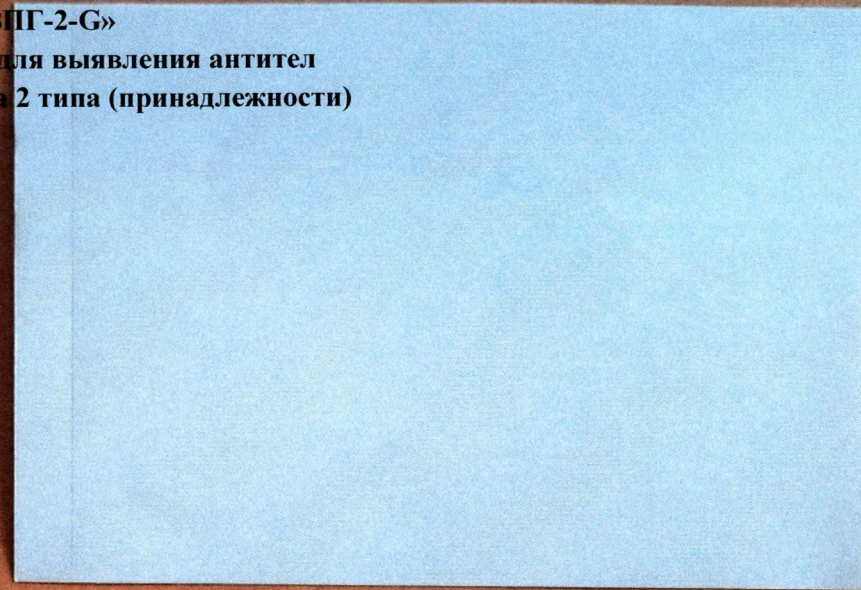

Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»

О. Н. Шлюндин

«05» апреля 2016 г.