

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор

АО «МЕДСЕРВИС»

Узелкова М.Е.



«06» октября 2022 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов к анализаторам активированного времени свертываемости крови (АВСК)

Actalyke Mini II, Actalyke XL», производства,

производства Helena Laboratories Corp., USA, «Хелена Лабораториз Корп.», США.



Actal

Activated Clotting Tin

299



*+M325MAX-ACT10/
S3740-22-MAX-ACT1/
1402020412310*

Модель для имплантации АКСИ (MAX-ACT) в тестовом
операционном (MAX-ACT Maxigen Tubes), сепаратной
20 шт. в сепаратной коробке.

REF MAX-ACT

ДИКОДЫ: 30 шт. в сепаратной коробке

Maxigen Laboratories Inc.

ПУ № РЭН 2019/0802 от 28.08.2021

IND Для диагностики
in vitro / in vitro

Способ применения:
указан в инструкции

LOT укажите на упаковке


Срок годности: укажите на упаковке,
после истечения срока годности
использовать для диагностики
невозможно

Срок и температурные хранения
указаны на упаковке и в инструкции

РЭП АО "МЕДСИ" - Россия, 127344, Москва, ул.
Новый Б. 31, к. 1, в. 1, 2-й этаж, 8-й этаж, 10-й этаж,
11-й этаж



Набор для определения АВСК (MAX-ACT) в тестовых пробирках (MAX-ACT Reagent Tubes),
серый колпачок - 50 шт. в картонной коробке.

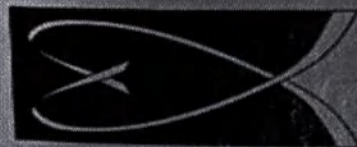

262



УПАКОВКА - АКТИВ
8071-23-0-0-001
10/2024/201

Activate

Activate

Используется для определения активности (ACT) в тестовой системе (ACT Rapid Test), которая используется для определения активности.

REF C-ACT

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.

Нельзя использовать повторно.

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.

Использовать повторно.

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.

Использовать повторно.

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.

Использовать повторно.

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.

Использовать повторно.

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.

Использовать повторно.

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.

Использовать повторно.

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.

Использовать повторно.

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.

Использовать повторно.

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.

Использовать повторно.

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.

Использовать повторно.

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.

Использовать повторно.

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.

Использовать повторно.

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.

Использовать повторно.

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.

Использовать повторно.

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.

Использовать повторно.

Срок годности: 12 мес. с даты выпуска.



Набор для определения АВСК (С-АСТ) в тестовых пробирках (C-ACT Reagent Tubes), черный колпачок - 50 шт. в картонной коробке.

262



*+H30K-ACT/1
ACT/1-02-C-ACT/1
14C2004-230 *



Activate

Test System

Набор для определения АБСХ (C-ACT) в тестовых пробирках (C-ACT Reagent Tubes), черные колпачки - 10 шт. в картонном коробе.

REF C-ACT

Фасовка: 10 шт. в картонном коробе.



Р/У № РЗН 2018/0002 от 28.09.2021

IVD Для диагностики

in vitro / in vitro

Способ применения

указан в инструкции

LOT указан на упаковке

Срок годности: указан на упаковке,

после истечения срока годности

изделия не должно использоваться

Срок и температура хранения

указаны на упаковке и в инструкции

АО "МЕДСИРМИС", Россия, 125044, Москва, ул.

Павлова, д. 7/1, к. 3, стр. 3, корпус 4, этаж 3, офис

345



Набор для определения АВСК (K-ACT) в тестовых пробирках (K-ACT Reagent Tubes), желтый колпачок - 50 шт. в картонной коробке.

292



Actalvke

Activate

Набор для определения АБСХ (G-АСТ) в тестовых пробирках (G-АСТ Reagent Tubes), белые колпачки - 50 шт. в картонной коробке.

REF G-АСТ

ФАСОВКА: 10 шт. в картонной коробке



РУ № РЗН 2018/0002 от 28.09.2021

IVD Для диагностики
in vitro / in vitro
Способ применения
указан в инструкции

LOT указан на упаковке

Срок годности: указан на упаковке,
после истечения срока годности
изделие не должно использоваться

Срок и температура хранения
указаны на упаковке и в инструкции

РЕР АО "МЕДИСЕРВИС", Россия, 128144, М-100, ул.
Давыда 21, в 1-м эт. 8-й этаж, 8-й этаж, 8-й этаж, 8-й этаж

Test System



*+M525G-ACTD/
\$571-22-G-ACT/
14020240531%*



Набор для определения АВСК (G-ACT) в тестовых пробирках (G-ACT Reagent Tubes), белый колпачок - 50 шт. в картонной коробке.

Прошито и скреплено печатью

9 листов

Директор АО «МЕДСЕРВИС»

М.Е. Узелкова

