



ООО НАУЧНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

603093, Россия, Нижний Новгород, ул. Горького, 100

тел./факс: (831) 434-00-00

"ДС-СО-НВе"

Стандартный набор для диагностики

материала на наличие

с-антигена

ДС-СО-НВе




СОСТАВ НАБОРА

1. "ДС-СО-НВе-Ag", лиофилизированный

2. "ДС-СО-НВе-Ab", инактивированный

3. "ДС-СО-НВе-Ab", лиофилизированный

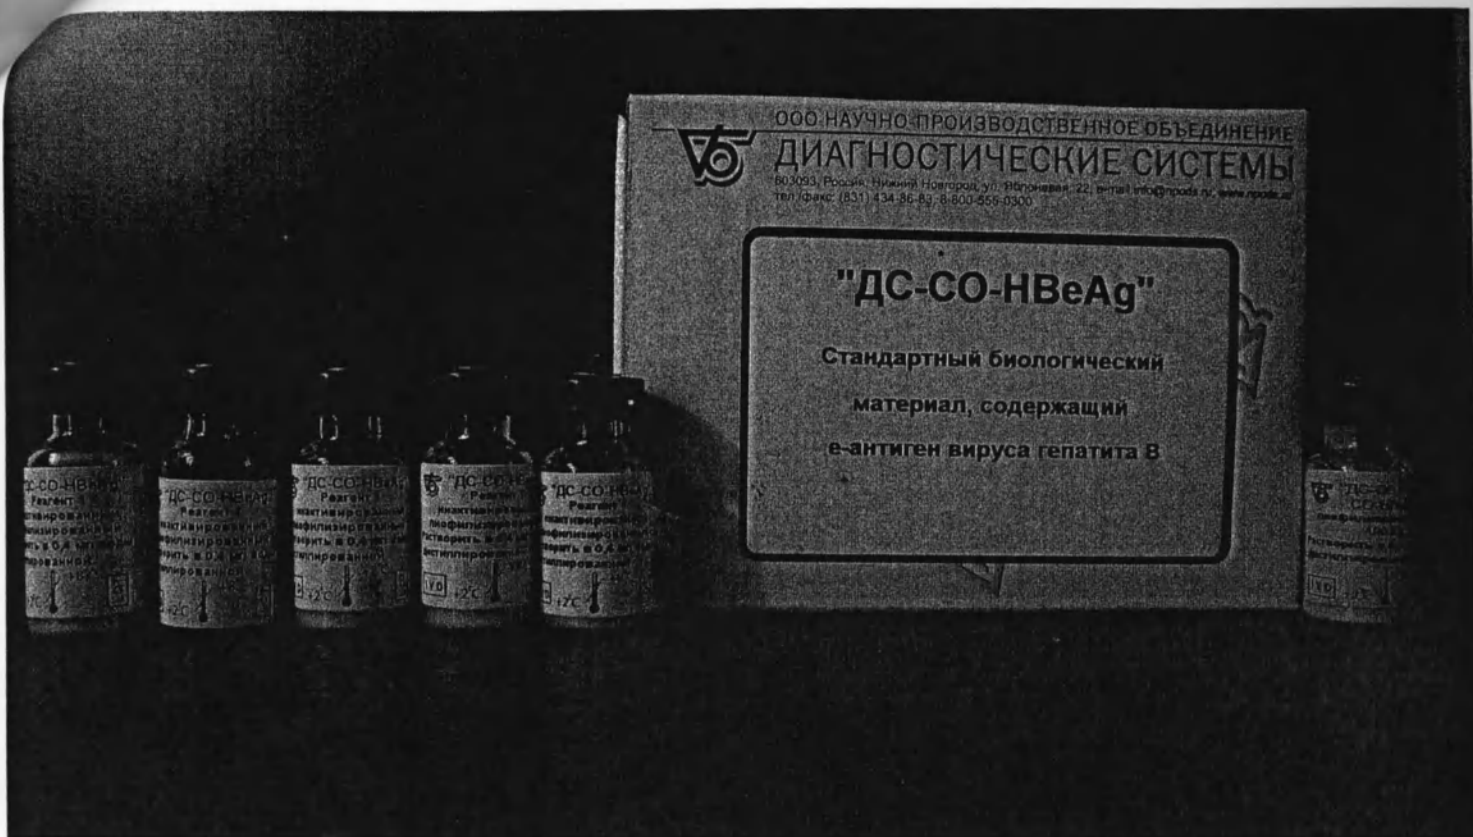

ДС-СО-НВеAg

