


**Набор реагентов
«ДС-ВЛК-НВsAg»**

**Контрольный образец для внутрилабораторного контроля качества исследований
на наличие поверхностного антигена вируса гепатита В**

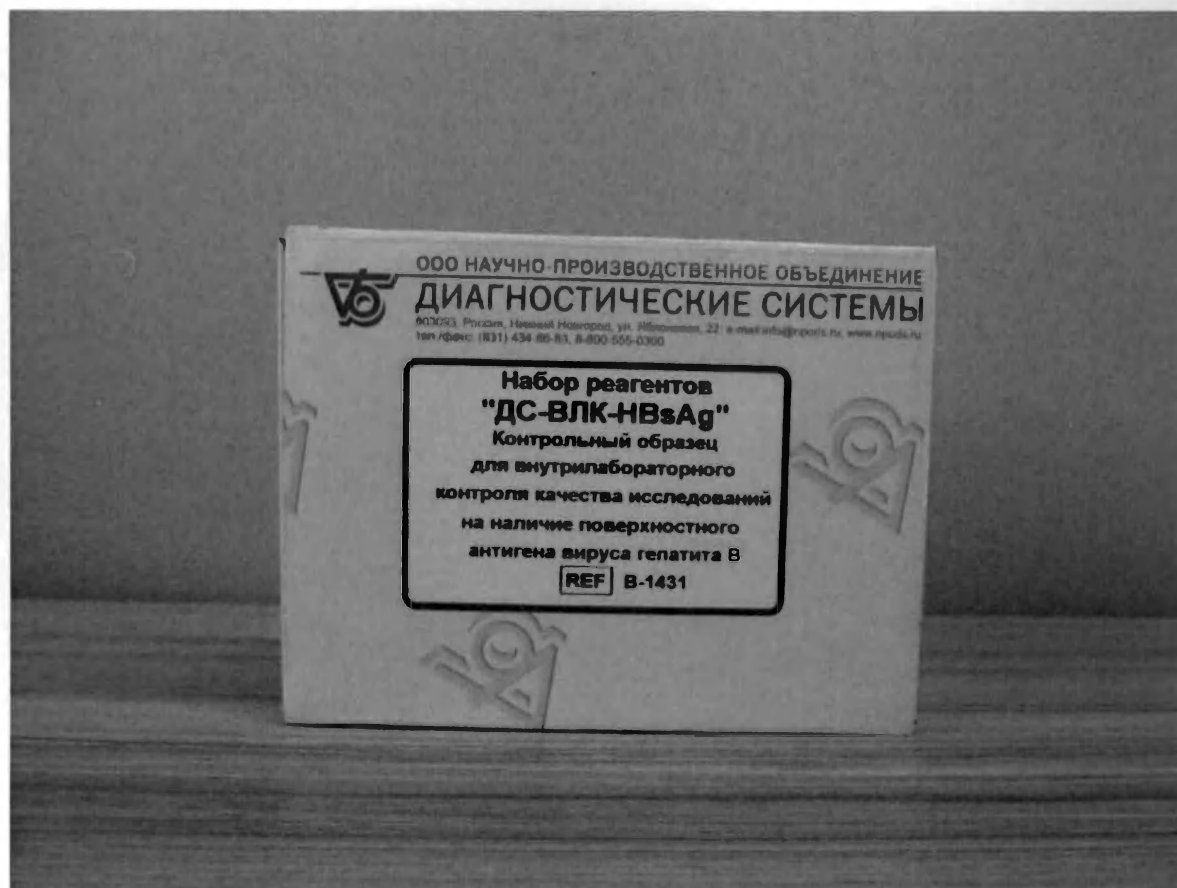

Заместитель генерального директора
ООО «Научно производственное объединение
«Диагностические системы»

О. Н. Шлюндин
2012г.