


Фотографии

упаковки и состава изделия медицинского назначения

Набор реагентов «ИФА-АНТИ-ЛЮИС-М». Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к возбудителю сифилиса»
по ТУ 9398-201-05941003-2012

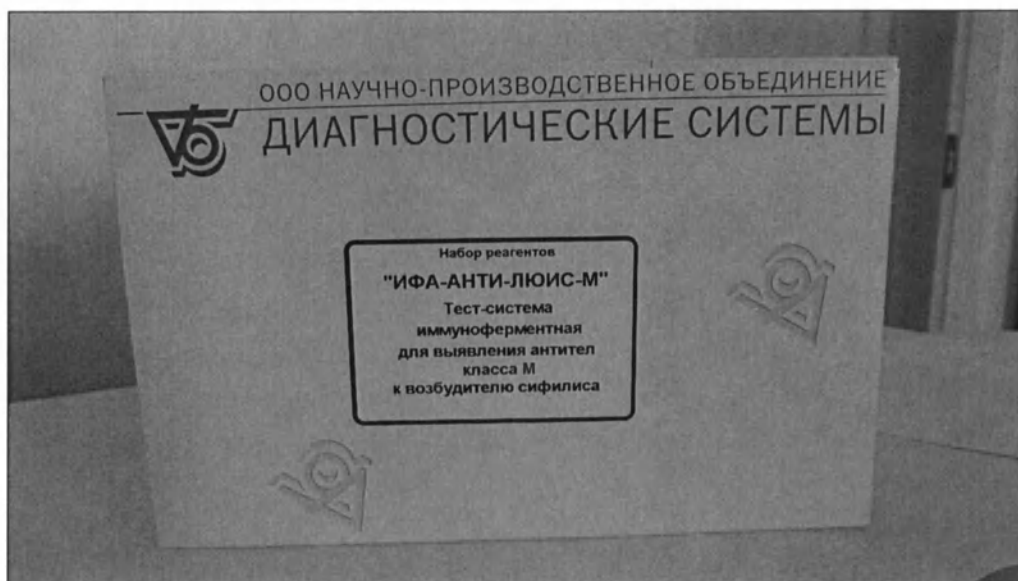

Ответственный по испытаниям

главный научный сотрудник

отдела лабораторной диагностики ИППП и болезней кожи

ФГБУ «ГНЦДК» Минздравсоцразвития России,

д.м.н., доцент

С.В. Ротанов