

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Паритет-Рентген»

А.Б. Лукьянов

«02» декабря 2020 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Комплекс рентгеновский диагностический под торговой маркой «Millennium®»
по ТУ 26.60.11-006-68428554-2020 с принадлежностями

Комплекс рентгеновский диагностический под торговой маркой «Millennium®» по ТУ 26.60.11-006-68428554-2020 с принадлежностями



ОСНОВНОЙ СОСТАВ:

1.1 Стол со штативом снимков.


- Стол со штативом снимков ТОМОС в исполнениях: ТОМОС-А, ТОМОС-Д, ТОМОС-АЕ, ТОМОС-ДЕ:



6

1.2 Стойка снимков

- Стойка снимков СС в исполнениях: СС-А, СС-Д, СС-АП, СС-ДП:

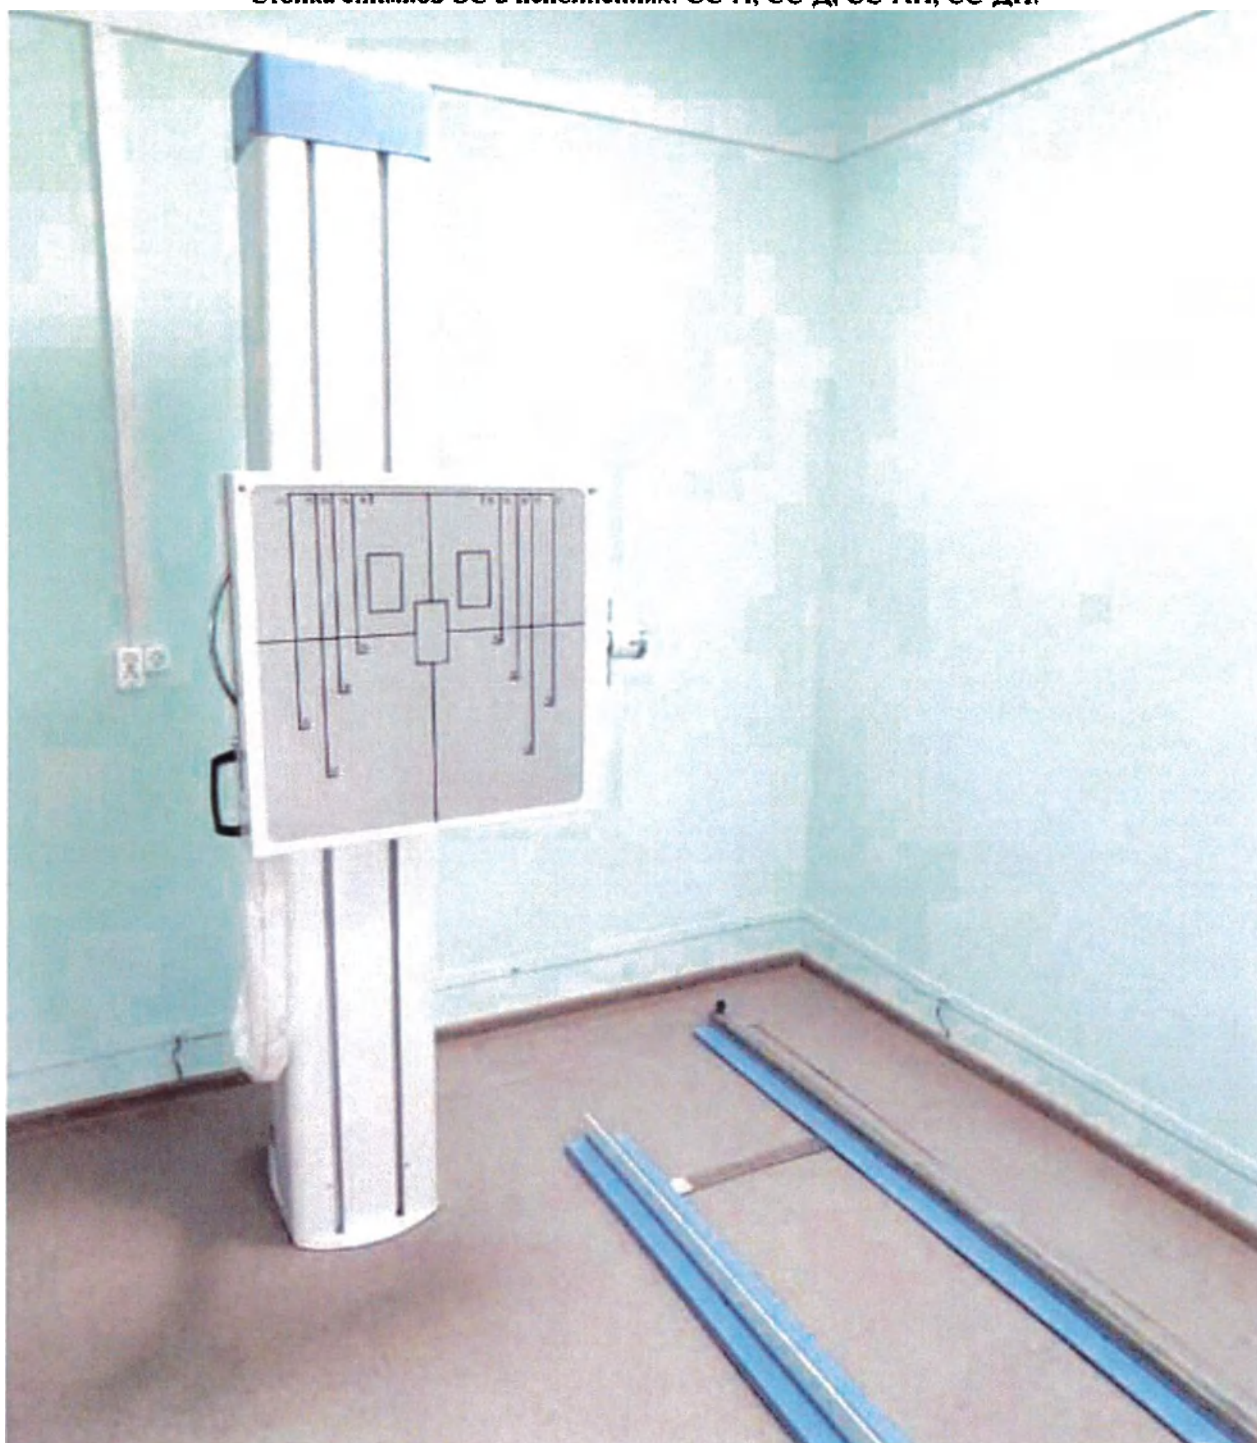

1.3 Диффрагма (коллиматор).
- Optica, модель: Optica 10





CE 163

SGS
710383

FCR_{only}

SN WOE012088/1-1

2019-12

(01)08718/55001358
(11)181200
(21)MOE012088/1.1


24 VDC / 24 VA
Min. inherent filtration
Al equiv.: 2.0mm Al/75kV
X-ray rating up to: 150kVp

IP20

This product complies with the requirements of 21 CFR 342.20 for products intended for use as a dietary supplement. This product complies with 21 CFR 342.20 and 342.21 except for the following: No. 342.20 (b) (1) (i) (A) dated July 28, 2002.

- Optica, модель: Optica 20



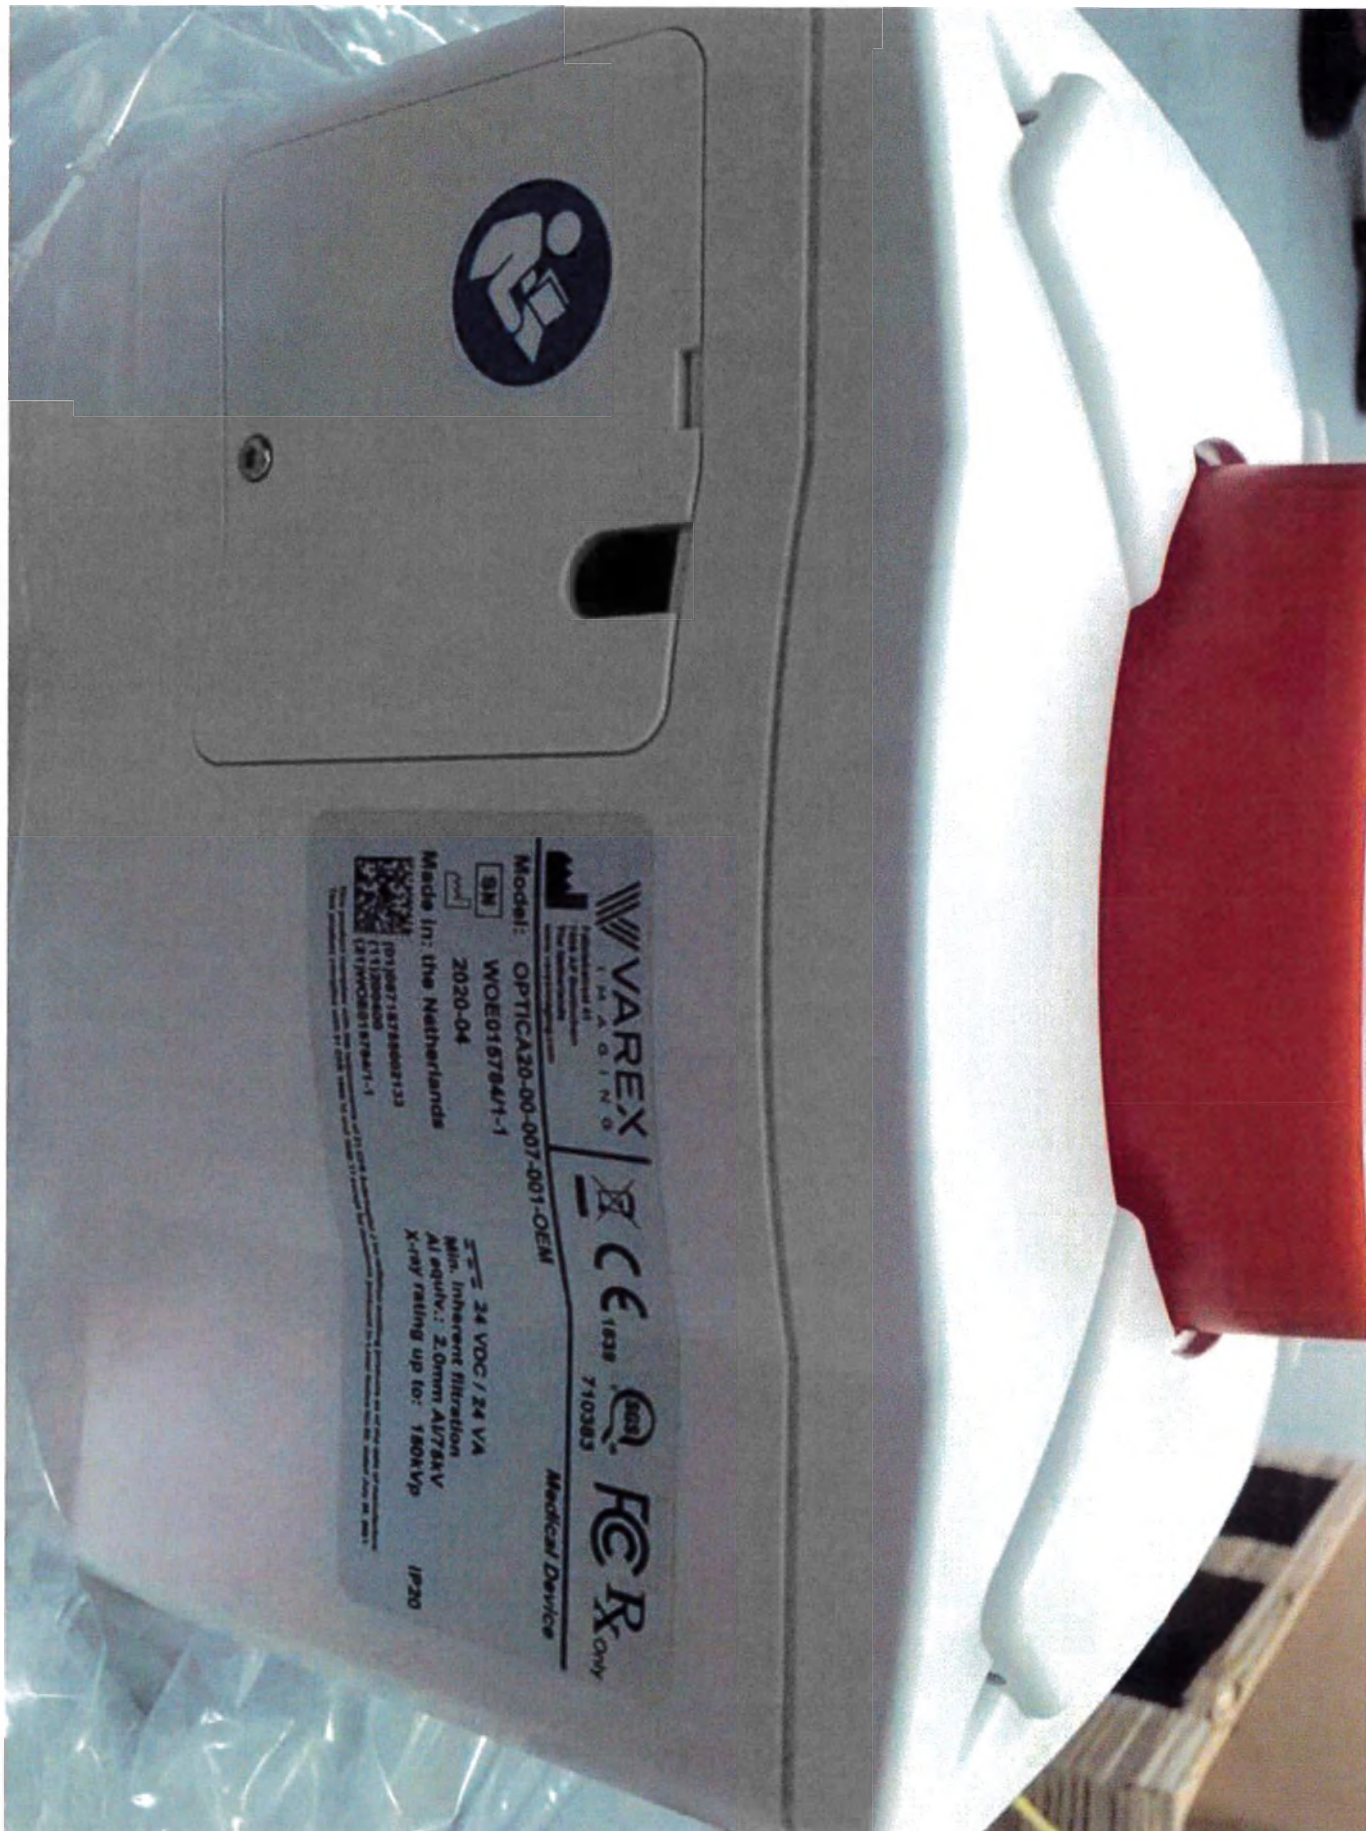

VAREX
I M A G I N G
Medical Device

Model: OPTICA30-00-007-001-OEM

SN: WOE0167841-1

Made in: the Netherlands

2020-04

Min. inherent filtration
Al equiv.: 2.0mm Al/75kV
X-ray rating up to: 180kVp

24 VDC / 24 VA

IP20

CE 1538 710383

FCR Only

101108718780002133
1113000000
1317W008187841-1

These products are registered under the EU MDR. Please refer to the user manual for more information.



- Optica, модель: Optica 30



Claymount
 Model: Optics 30-CF902
 VAREX
 50128-20-OEM
 WOEO15613/1-1
 2020-03

CE 1838 710383
FCR ONLY
Medical Device

Min. Inherent Filtration
 At equiv.: 1.2mm Al/75kV
 X-ray rating up to: 160kVp
 IP20

187108718756001384113000217WOC0015613/1-1

These products are classified as Class II medical devices under the European Union Medical Device Regulation (MDR) 2017/745. They are CE marked in accordance with the MDR. The CE mark indicates that the products comply with the requirements of the MDR. The CE mark is a statement by the manufacturer that the product meets the requirements of the MDR. The CE mark is a statement by the manufacturer that the product meets the requirements of the MDR.



- Optica, модель: Optica40



 **Claymount**


Anholtseweg 44
7091 HB Dinxperlo
Netherlands
Manufacturer www.claymount.com




CE 0120



Model: Optica 40-CF002

REF 50126-00-RUS
Catalogue number

SN WO232908/E-8
Serial number

 **2014-06**
Date of manufacture

IP40 === 24V 80VA

Min. inherent filtration
Al equiv.: 2.0mm Al/75kV
X-ray rating up to: 150kVp

• или Ralco R;



**1.4Отсеивающая решетка (при необходимости).
- JPI, модели: Grid 1000**



- или Soyee, модели: Soyee



1.5 Ионизационная камера.
- VacuDAP, модели: VacuDAP



VacuDAP - OEM

Country of Origin Germany
Made in Germany




2019-12

SN

19 05818

REF

156 00 15



0.2 Al
(40 - 150) kV
IEC 60580

CE 0197



VACUTEC Meßtechnik GmbH




Dornblüthstraße 14a
DE-01277 Dresden
www.vacutec-gmbh.de

--- 10V - 30V / max. 2W
Firmware: 1.602

- или SSMC, модель: Solid State MC 508



- или SSMC, модель: Solid State MC 601

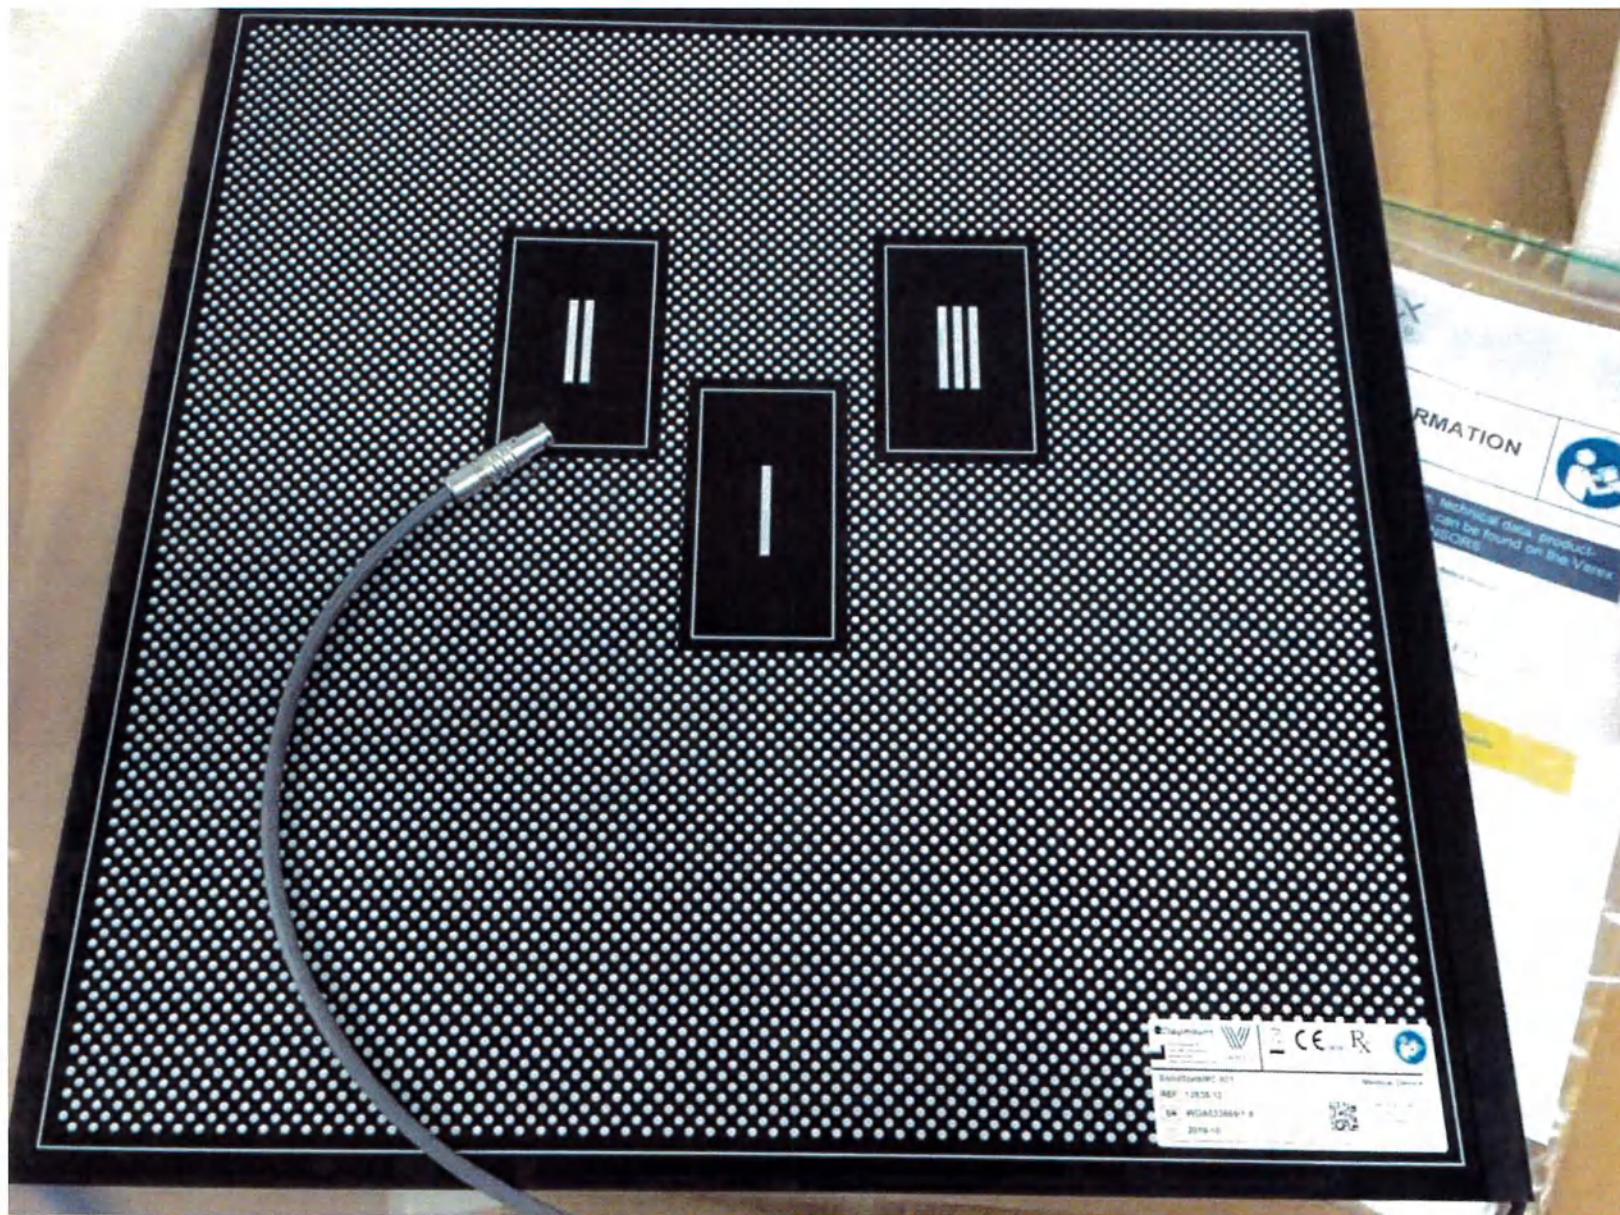

1.6 Устройство рентгеновское питающее высокочастотное.


- Устройство рентгеновское питающее EPS 45-80 HIGH-VOLTAGE GENERATOR, с принадлежностями:



- или Устройство рентгеновское питающее VZW 2930 с принадлежностями:



- или Устройство рентгеновское питающее INDICOIQ, CMP 200, CMP 200DR с принадлежностями

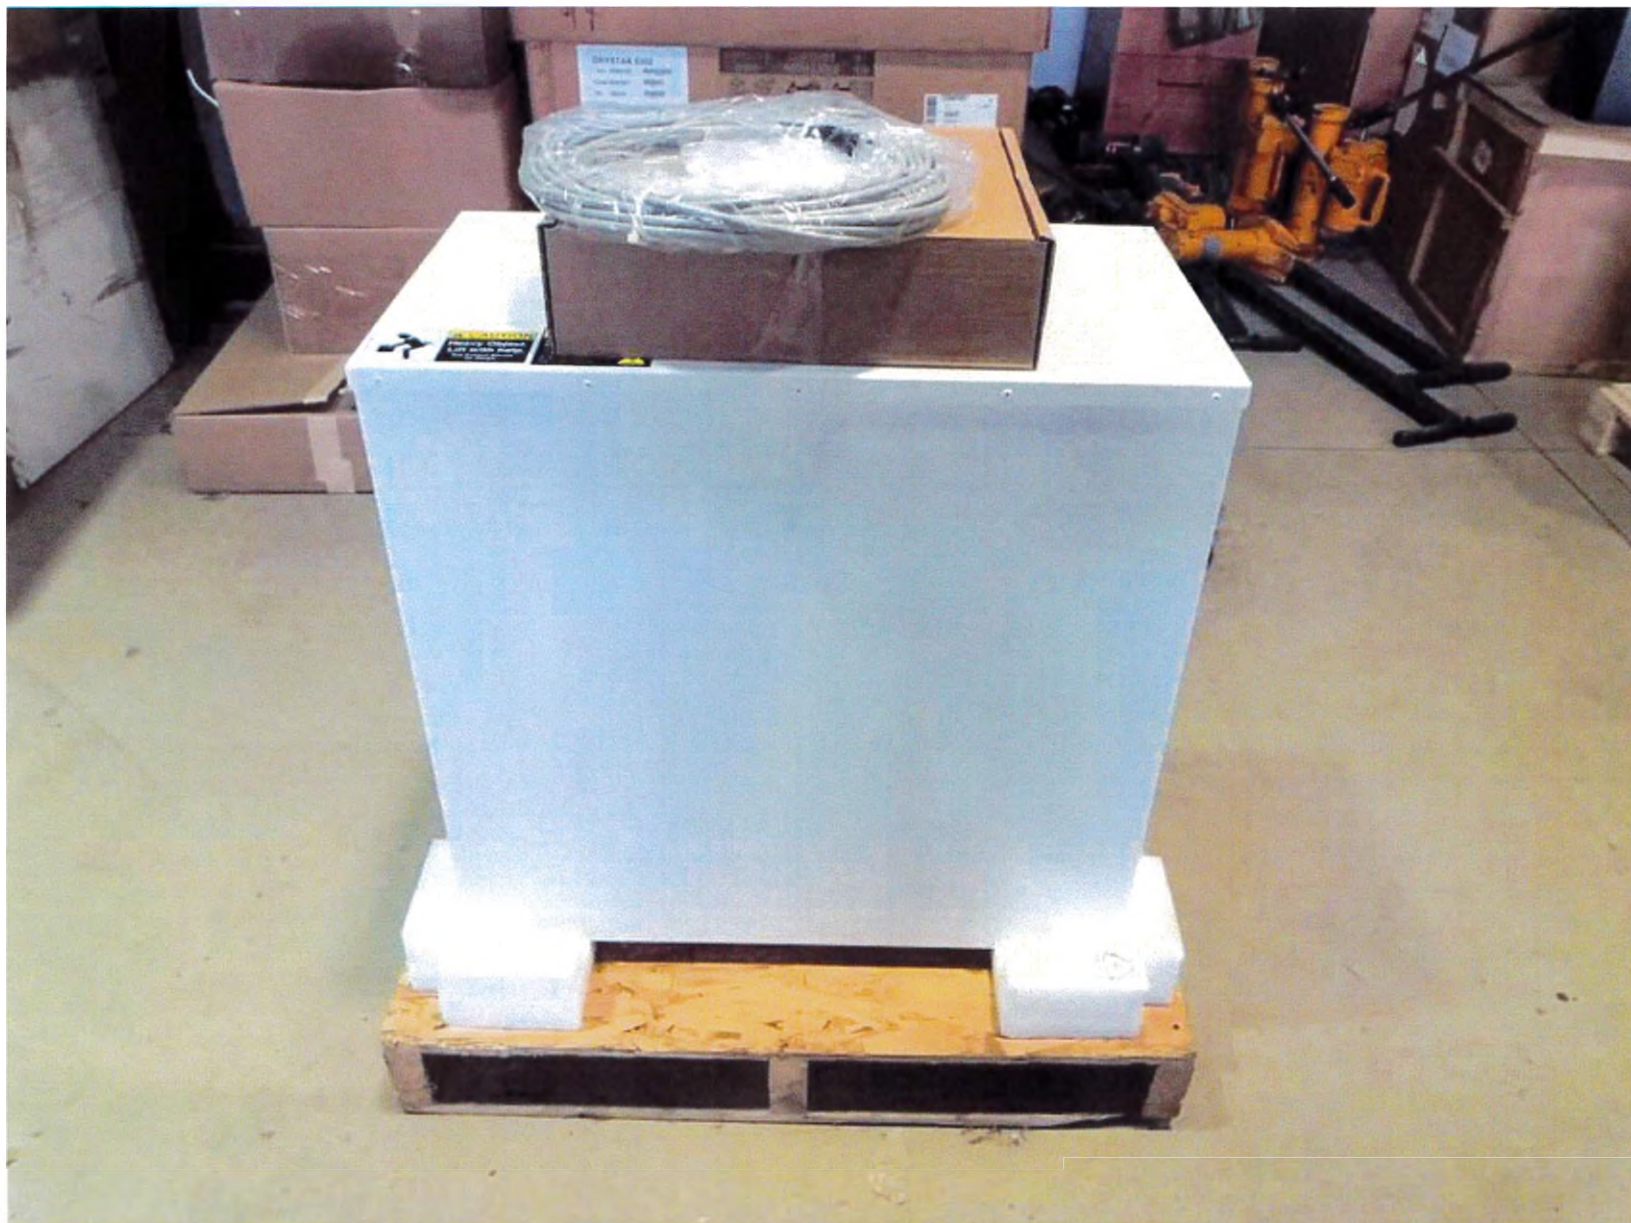

SYSTEM PART NO.:
VZW2556RB2-Y4
SYSTEM SN: CPD29628M17
SYSTEM ACCESSORY LISTING
(see factory configuration)
CONSOLE SN: 30112183L17
HV MODULE SN: GD427109M17
ADR SYSTEM SN:


SYSTEM CONTAINS
FIRMWARE
PART NO.: 90134900
REVISION: A7
COMPATIBLE WITH
SYSTEM MODEL: VZW2556RB2-Y4

ACPS
CPI
MANUFACTURED BY
Communications & Power Industries Canada Inc.
48 River Drive, Georgetown, Ontario, Canada, L7G 2J4
MADE IN CANADA
MODEL NO.: VZW2556RB2-Y4
SERIES: CMP 300DR 50 kW
PART NO.: 90539513
SERIAL NO.: CPD29628M17
MFG. DATE: December 2017
VOLTS AC: 400/480
AMPS AC: MOMENTARY 100/80 NOMINAL 5
FREQ: 50/60 Hz PHASE: 3
COMPLIES WITH IEC 60601-2-34: 2006
& CORH RADIATION PERFORMANCE
STANDARD 21 CFR, SUBCHAPTER J




ACCEPTED
FINAL MECHANICAL
INSPECTION
DATE: DEC 08 2017
FINAL PERFORMANCE
TEST DATE: DEC 07 2017
PRODUCT RELEASE
DATE: DEC 08 2017
PRODUCT CODE: VZW2556RB2-Y4
SERIAL NUMBER: CPD29628M17

42

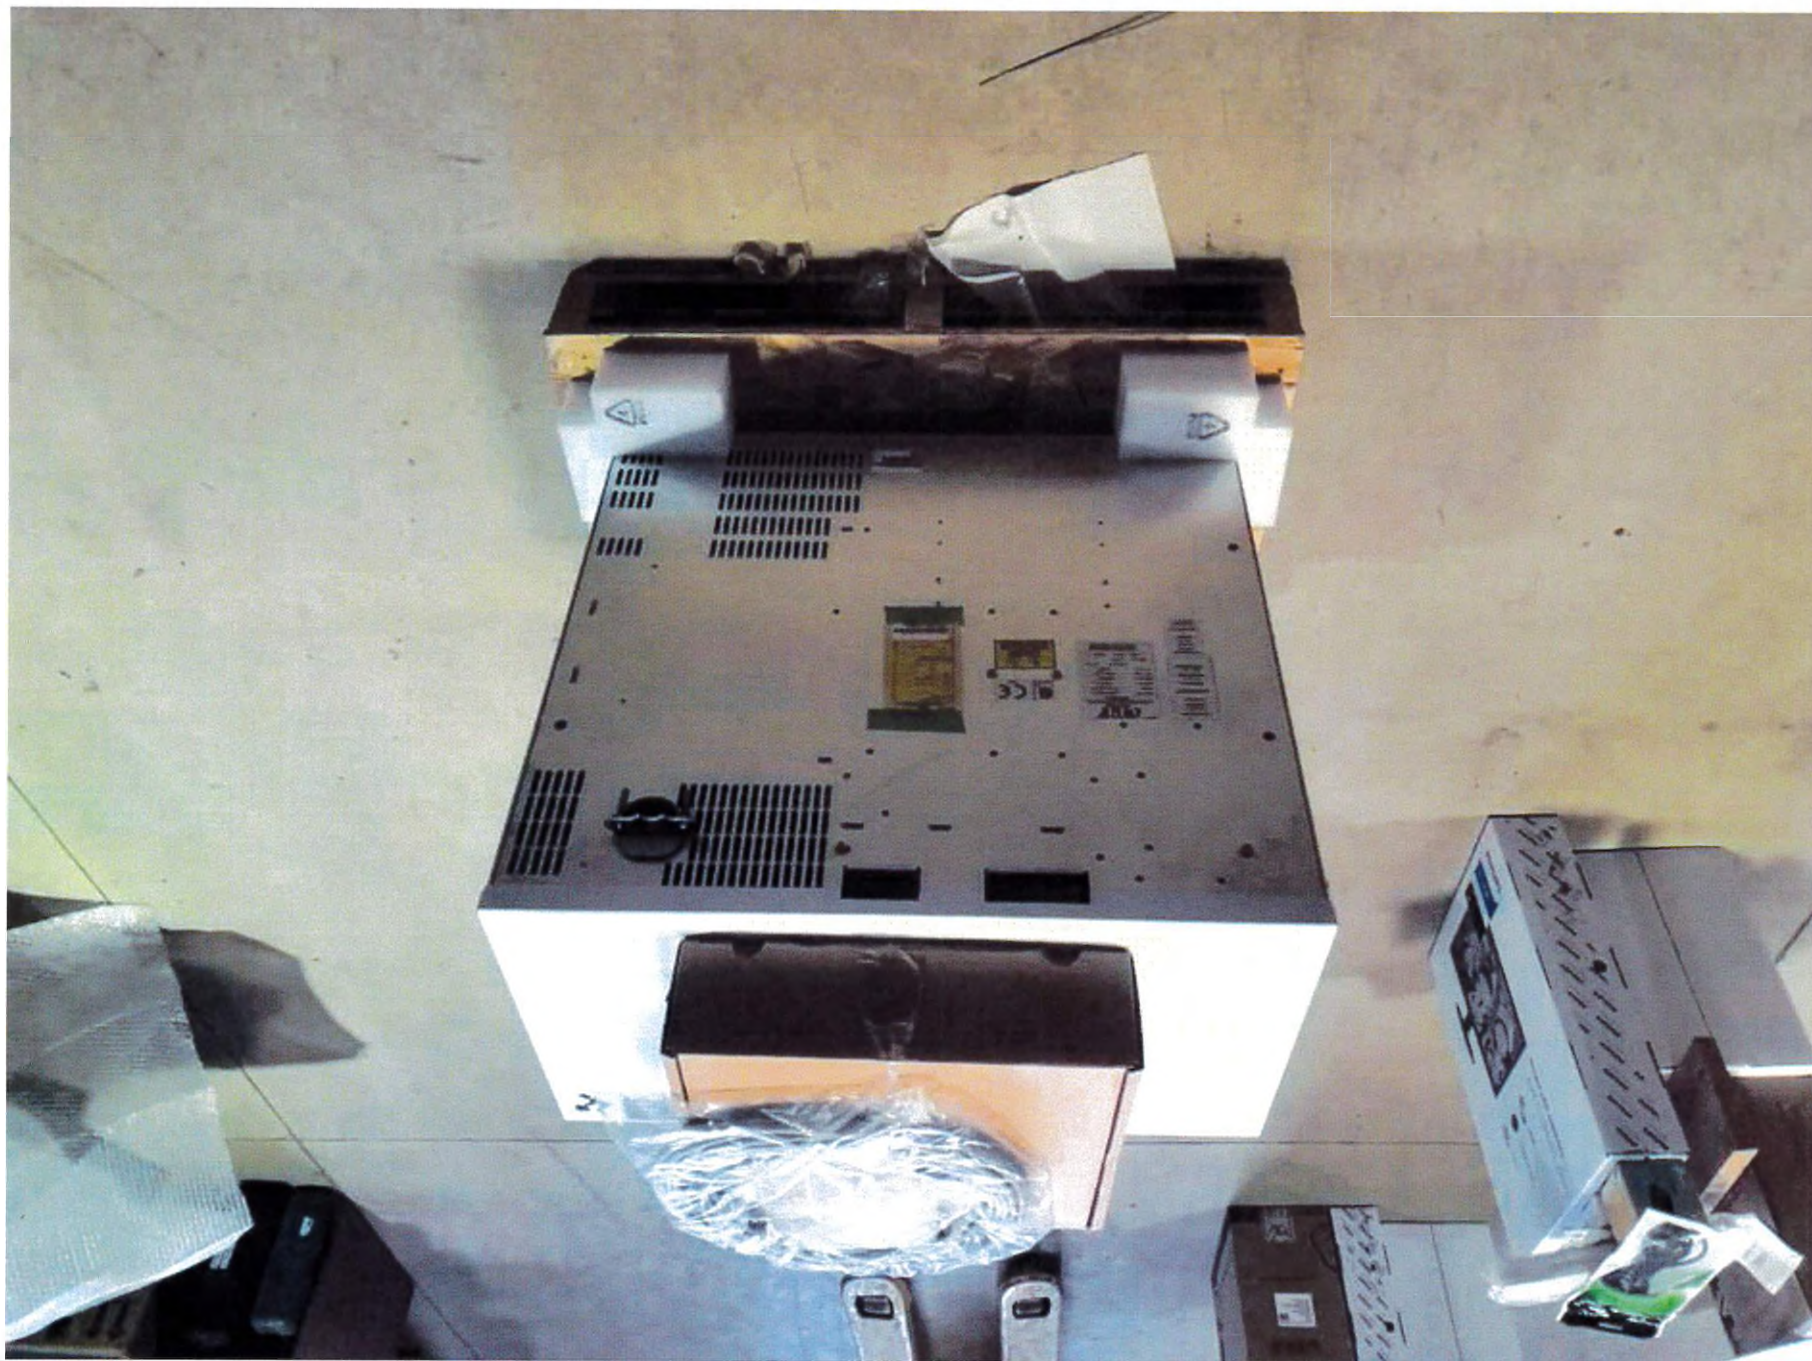

- или Устройства рентгеновские питающие по ТУ 9442-002-75249059-2007 в следующих исполнениях: РПУ ВЧ/1, РПУ ВЧ/2 и РПУ ВЧ/3:

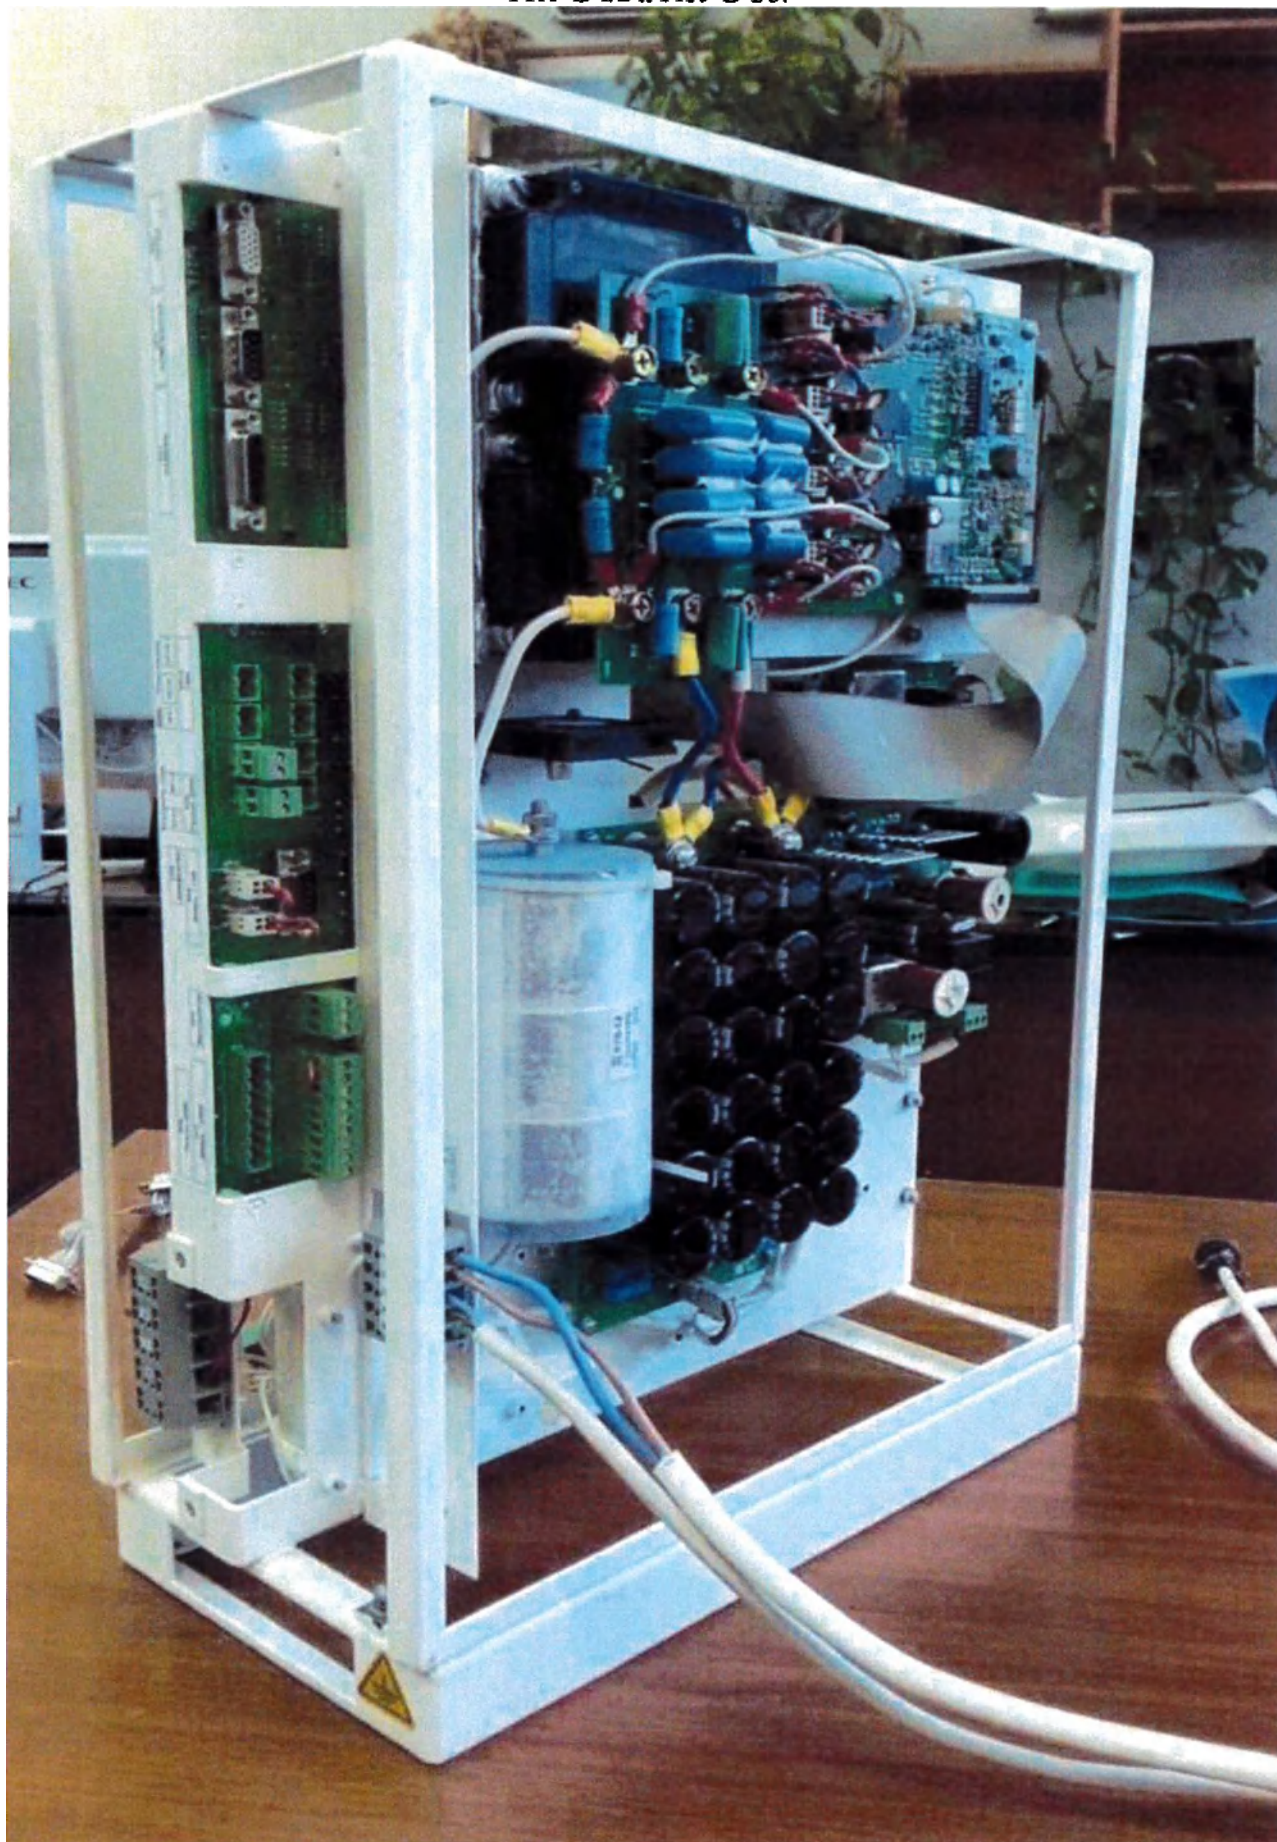

- или EditorHFe:



26



Josef-Baumann-Straße 23
D-44805 Bochum

CE 0197



Röntgengenerator
X-Ray Generator
Générateur Radiologique
Generador Radiológico

Achtung ! Lebensgefahr !
Attention ! Danger to life !
Attention ! Danger de mort !
Atención ! Peligro de muerte !



Öffnen des Schrankes nur durch qualifiziertes Servicepersonal
The cabinet may only be opened by qualified service personnel
Overture de l'armoire autorisée uniquement par le personnel de service qualifié
La apertura del armario solo podrá efectuarse por personal técnico cualificado

EDITOR HFe 601

distributed by



150 kV

400V

800 mA , 65 KW

Standby: 1.55A; max. current: 144 A

3N~

50Hz / 60Hz

manufactured: 4 / 2018

SN

35424

REF

021605106-LSS

HOUSING

06000502

Complies with requirements applicable for HV-generators and X-ray controls given by
CDRH Radiation Performance standards 21CFR1020.30. (21 CFR Subchapter J) as of date
of manufacture.




Intertek
4008454

ETL CLASSIFIED
Conforms to Std.
ANSI/AAMI ES60601-1,
EN/IEC 60601-1
EN/IEC 60601-2-54
Certified to CAN/CSA Std.
C22.2 No. 60601-1,
C22.2 No. 60601-2-54

27

- или Устройство рентгеновское питающее передвижное среднечастотное микропроцессорное с автоматической индикацией дозы и системой самодиагностики УРСПас-"РЕНЕКС" по ТУ 9442-014-01416381-01:

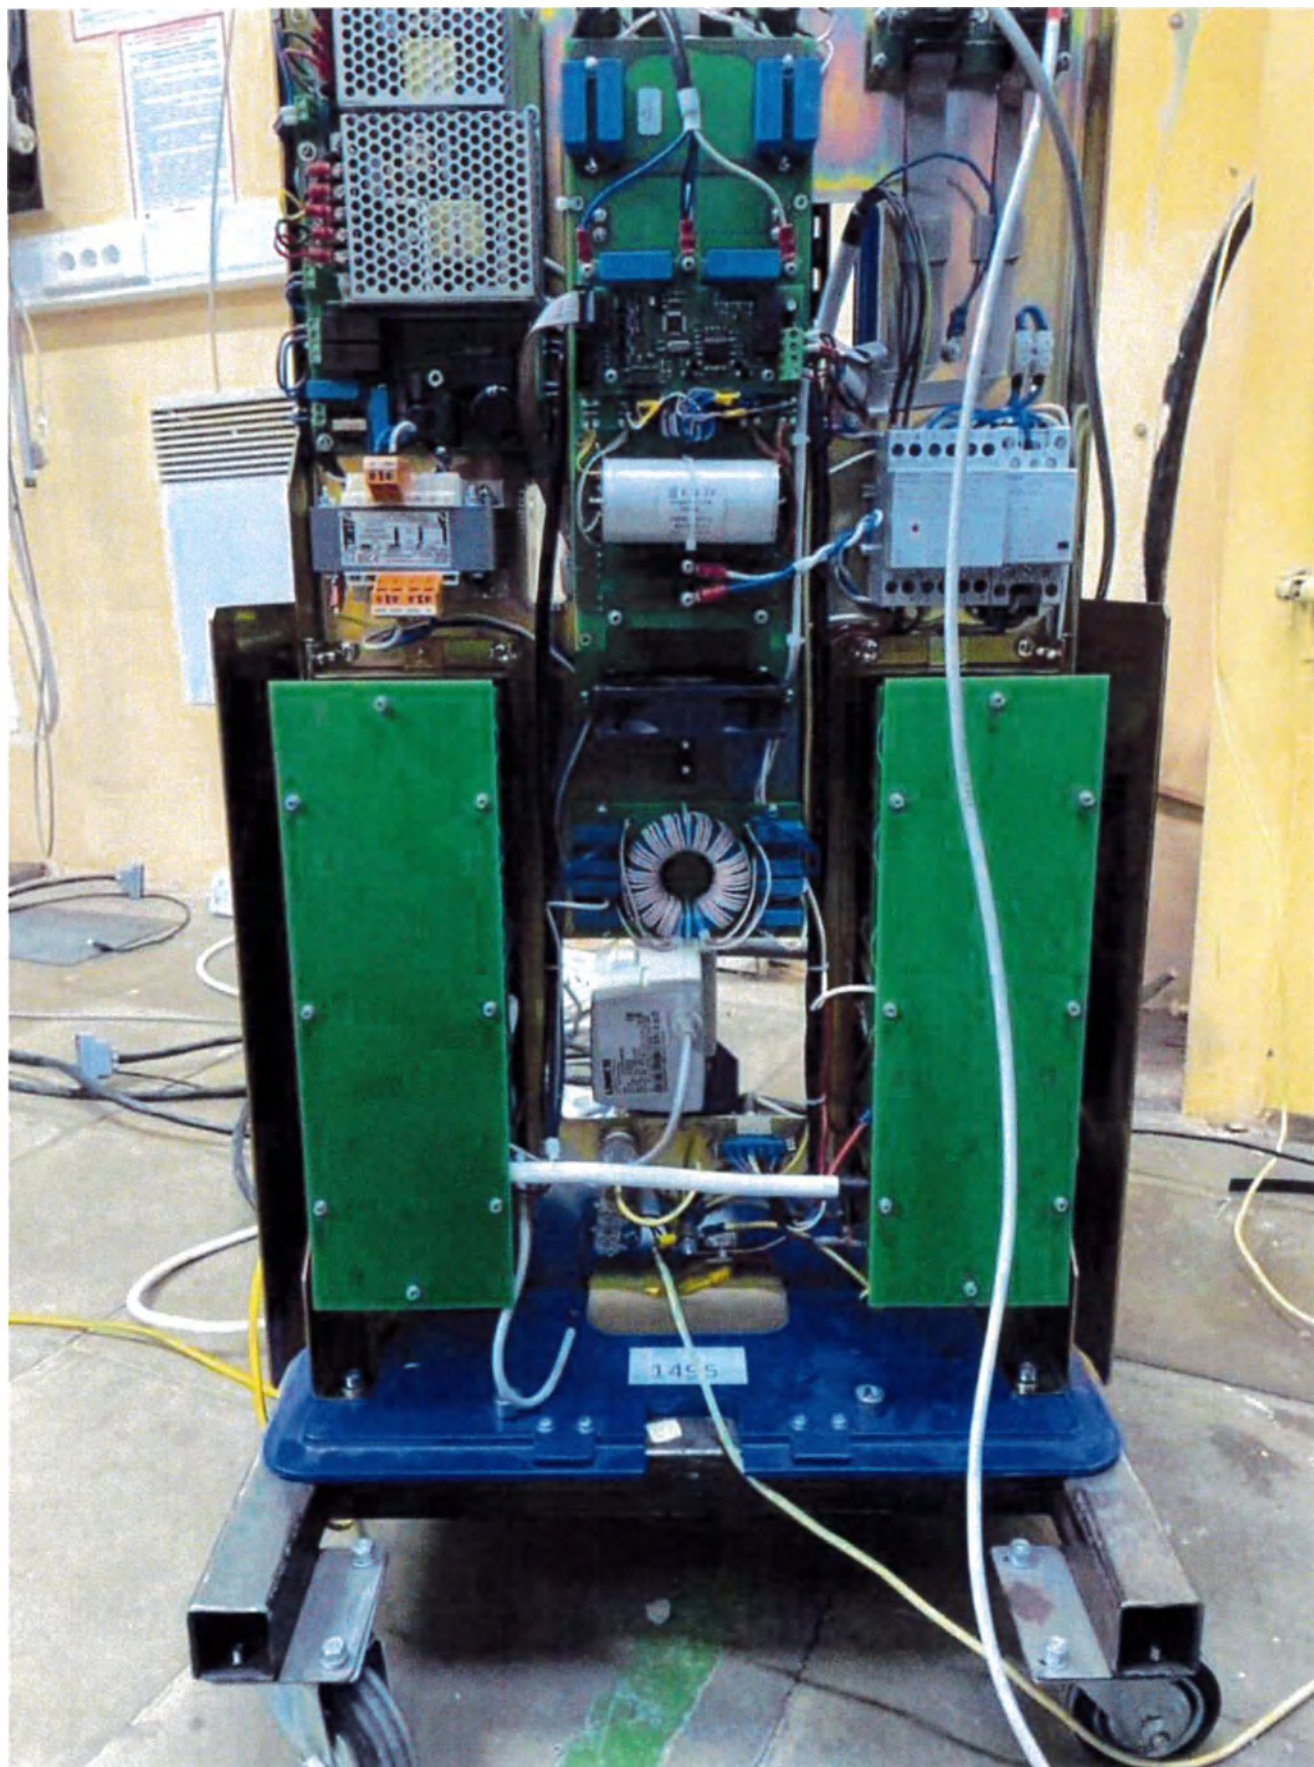


- или Устройство рентгеновское питающее среднечастотное микропроцессорное с автоматической индикацией дозы на пациента и системой самодиагностики для работы с двумя высоковольтными генераторами напряжения "Ренекс-Автогн" по ТУ 9442-019-54839165-2002:



- или Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРПв-"РЕНЕКС" по ТУ 9442-027-54839165-2005:



1.7 Излучатель рентгеновский диагностический (рентгеновская трубка/кожух).
Трубки рентгеновские медицинские, серии: RO, CT XS, SRO, SRM, MRC, MRM, RTC, DU, DA, с принадлежностями

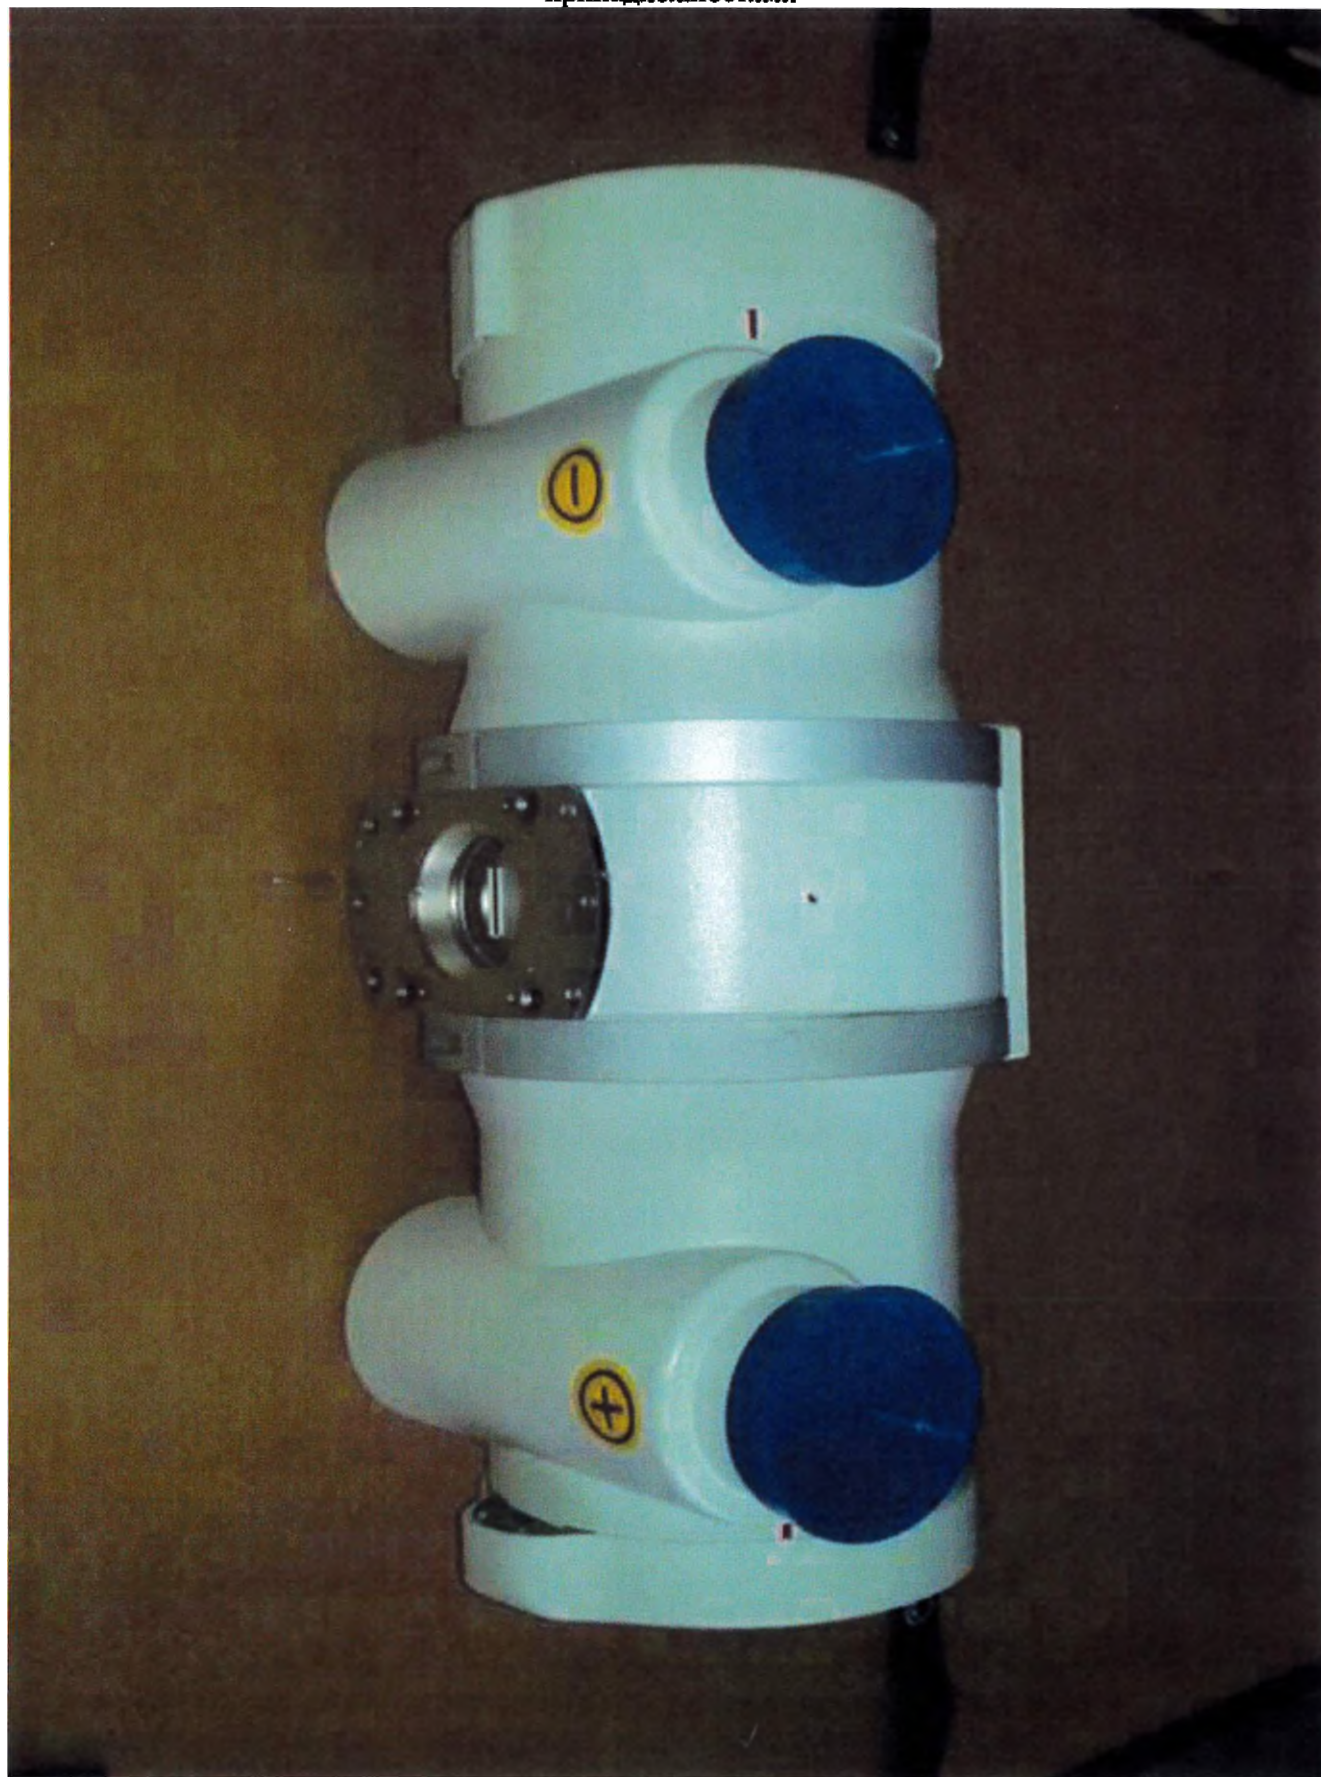


- Излучатели трубкиами рентгеновскими


исполнения: RAY-14_3, RAY-14_3F, RAY-14_1, RAY-14S_3, RAY-14S_3F, RAY-14S_1, RAY-12_3, RAY-14_3F, RAY-12_1, RAY-12S_3, RAY-12S_3F, RAY-12S_1, RAY-8_3, RAY-8_1, RAY-8S_3, RAY-8S_1, SV 150/33/78R-V, SV 150/33/78R-T, SV 150/22/54-S, SV 150/22/54-V, SV 150/25/48-S, SV 150/25/48-V, SV 150/25/48-T, Opti 150/33/78R-S-80 3:



- или излучатели рентгеновские медицинские IAE:

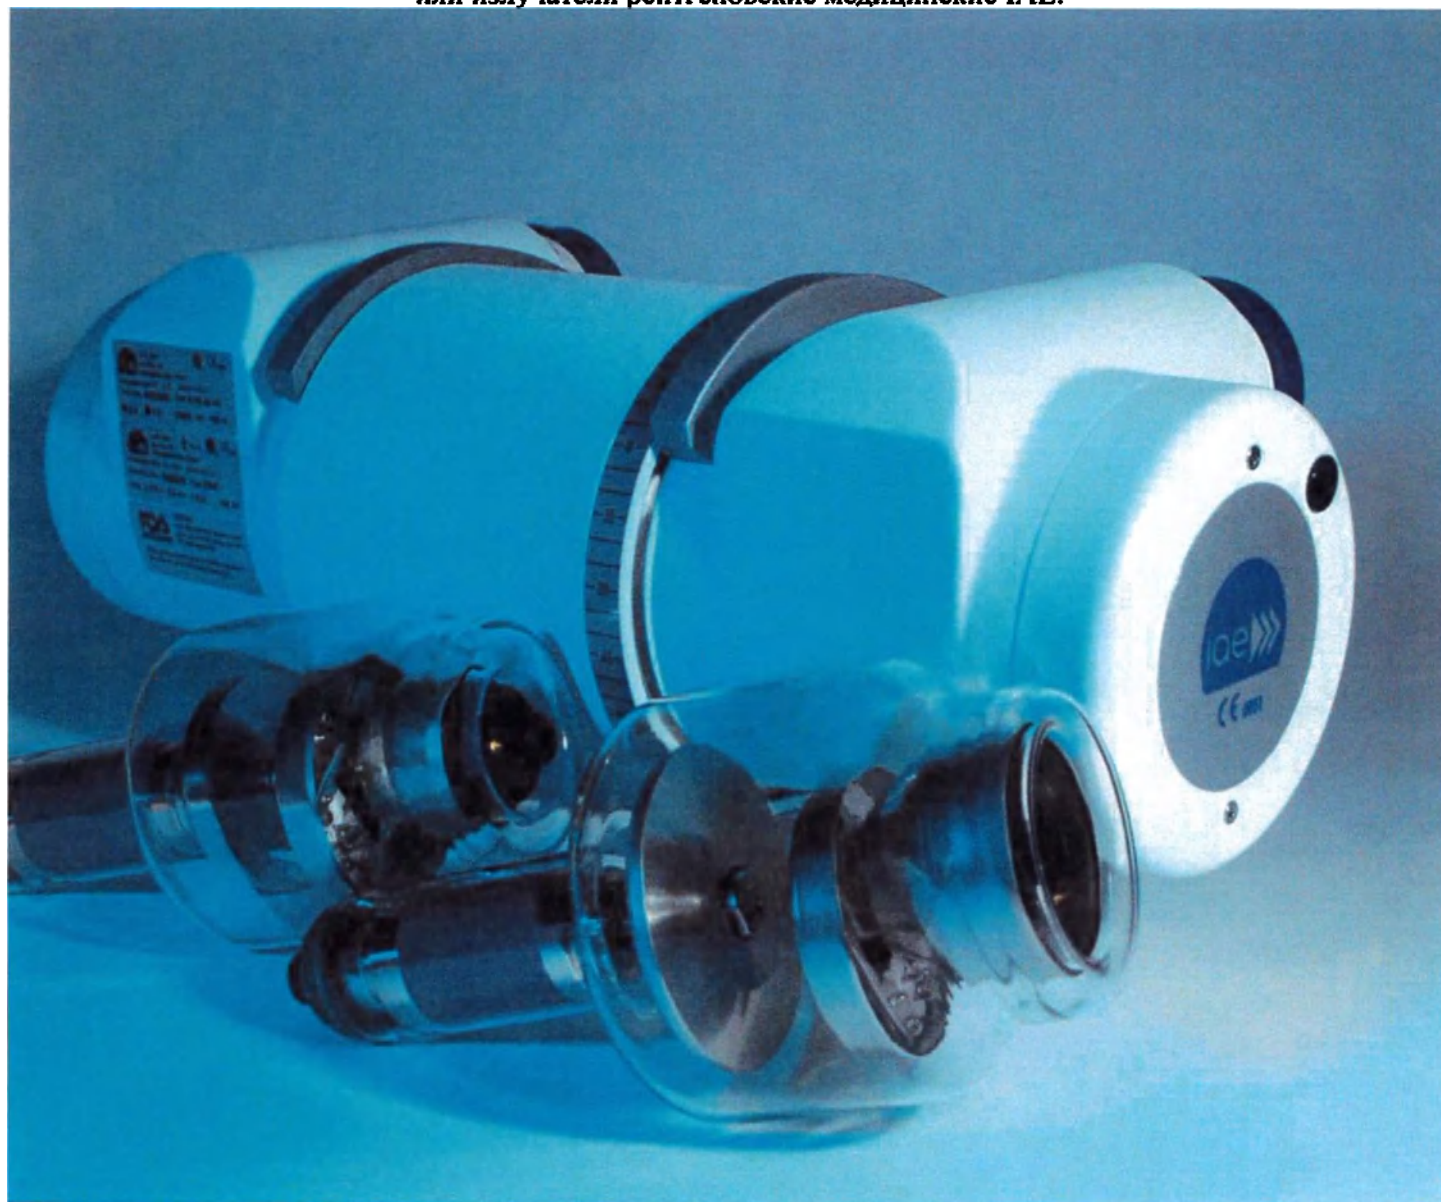

- Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой, варианты исполнения: E7864X или E7884X, или E7869X, или E7892X, или E7895X

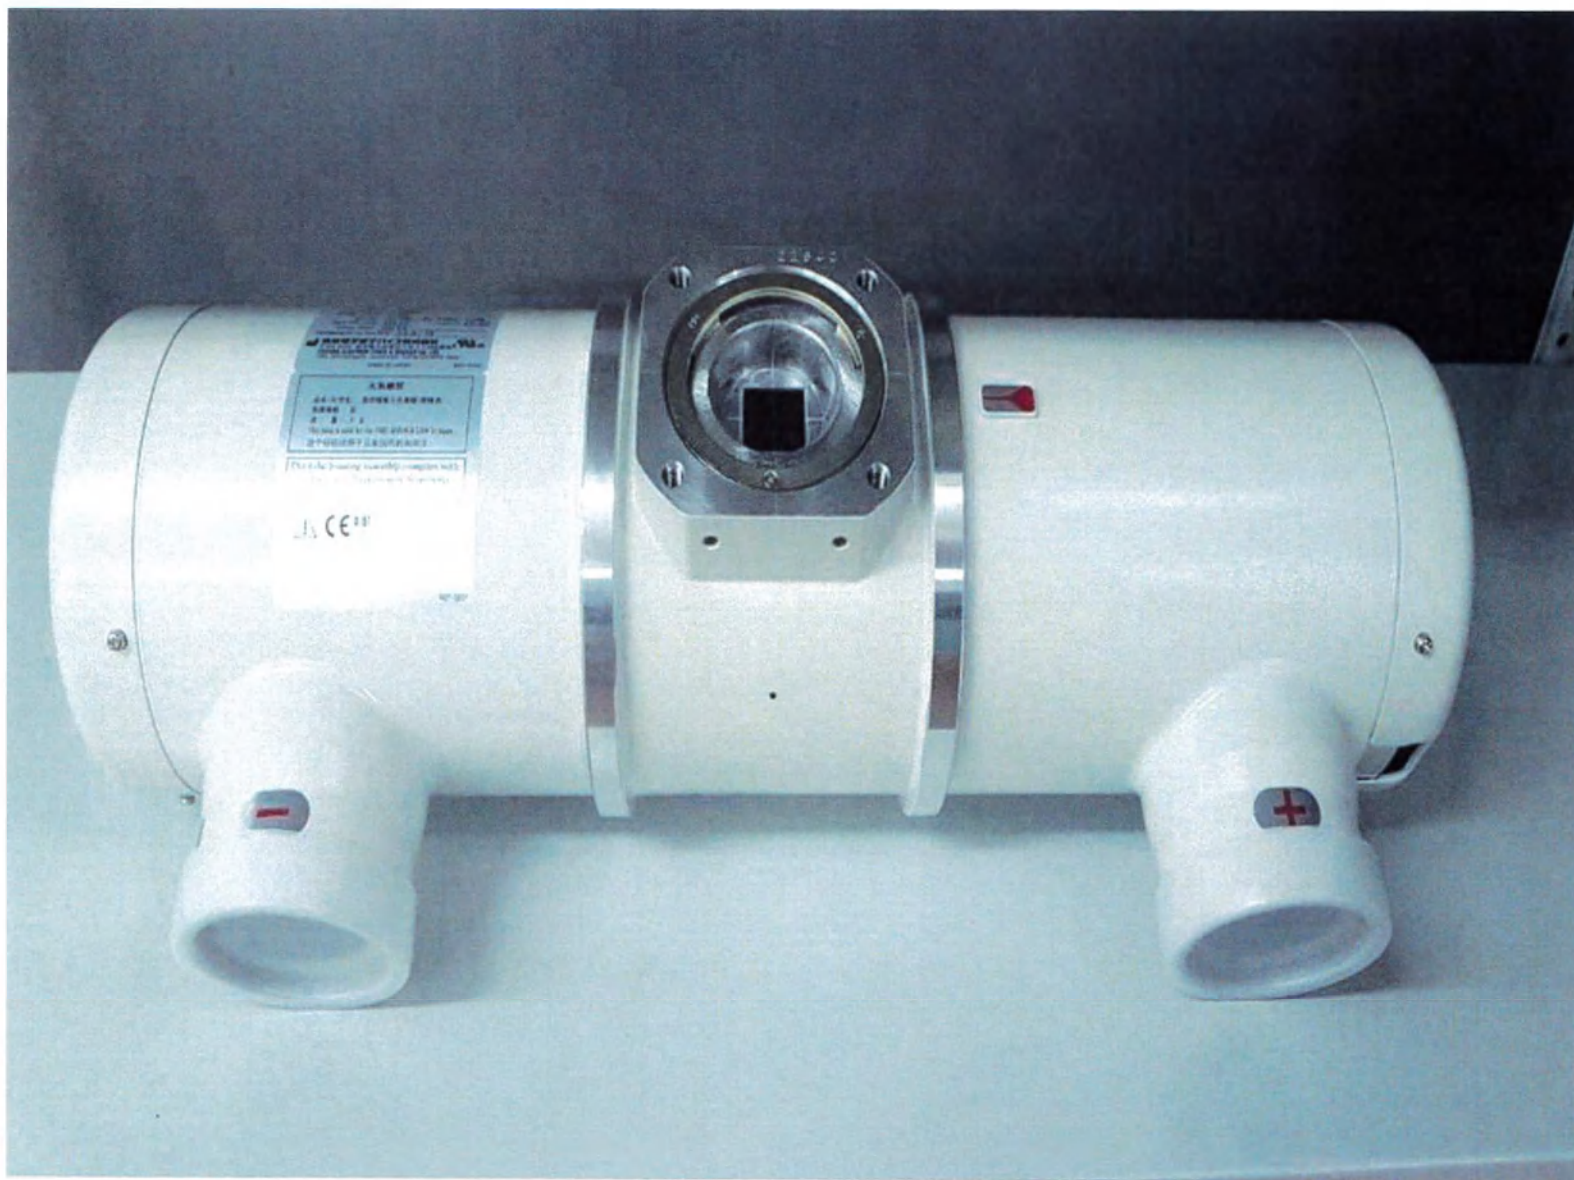


1.8 Плоскопанельный цифровой детектор с принадлежностями (с программным обеспечением и/или аппаратной частью (при необходимости))
- Приёмник рентгенографический цифровой ViVIX-S, с принадлежностями:




- или Детектор плоскпанельный цифровой Xmagu, с принадлежностями:



- или Детектор рентгеновских лучей плоскпанельный для медицинской диагностики Rixium с принадлежностями:

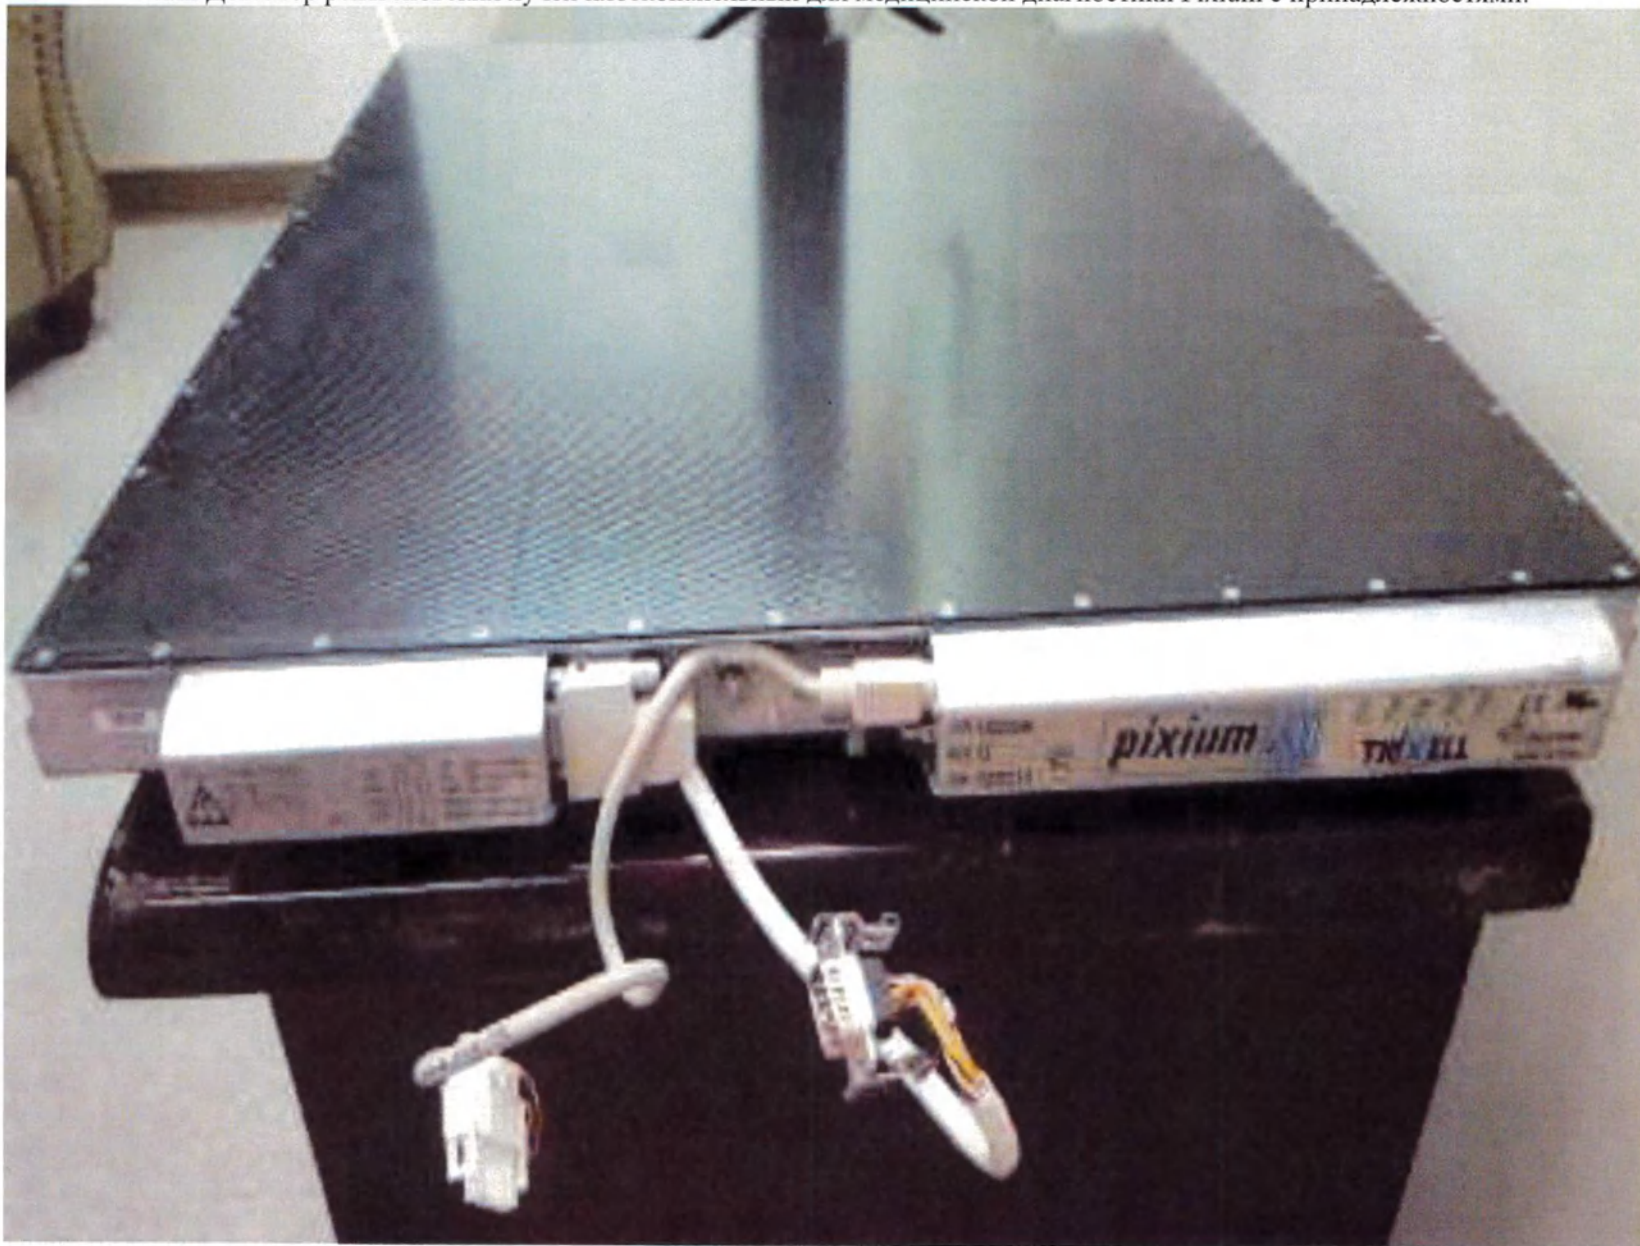


- или Детектор рентгеновский плоскостельный серии FDX с принадлежностями:

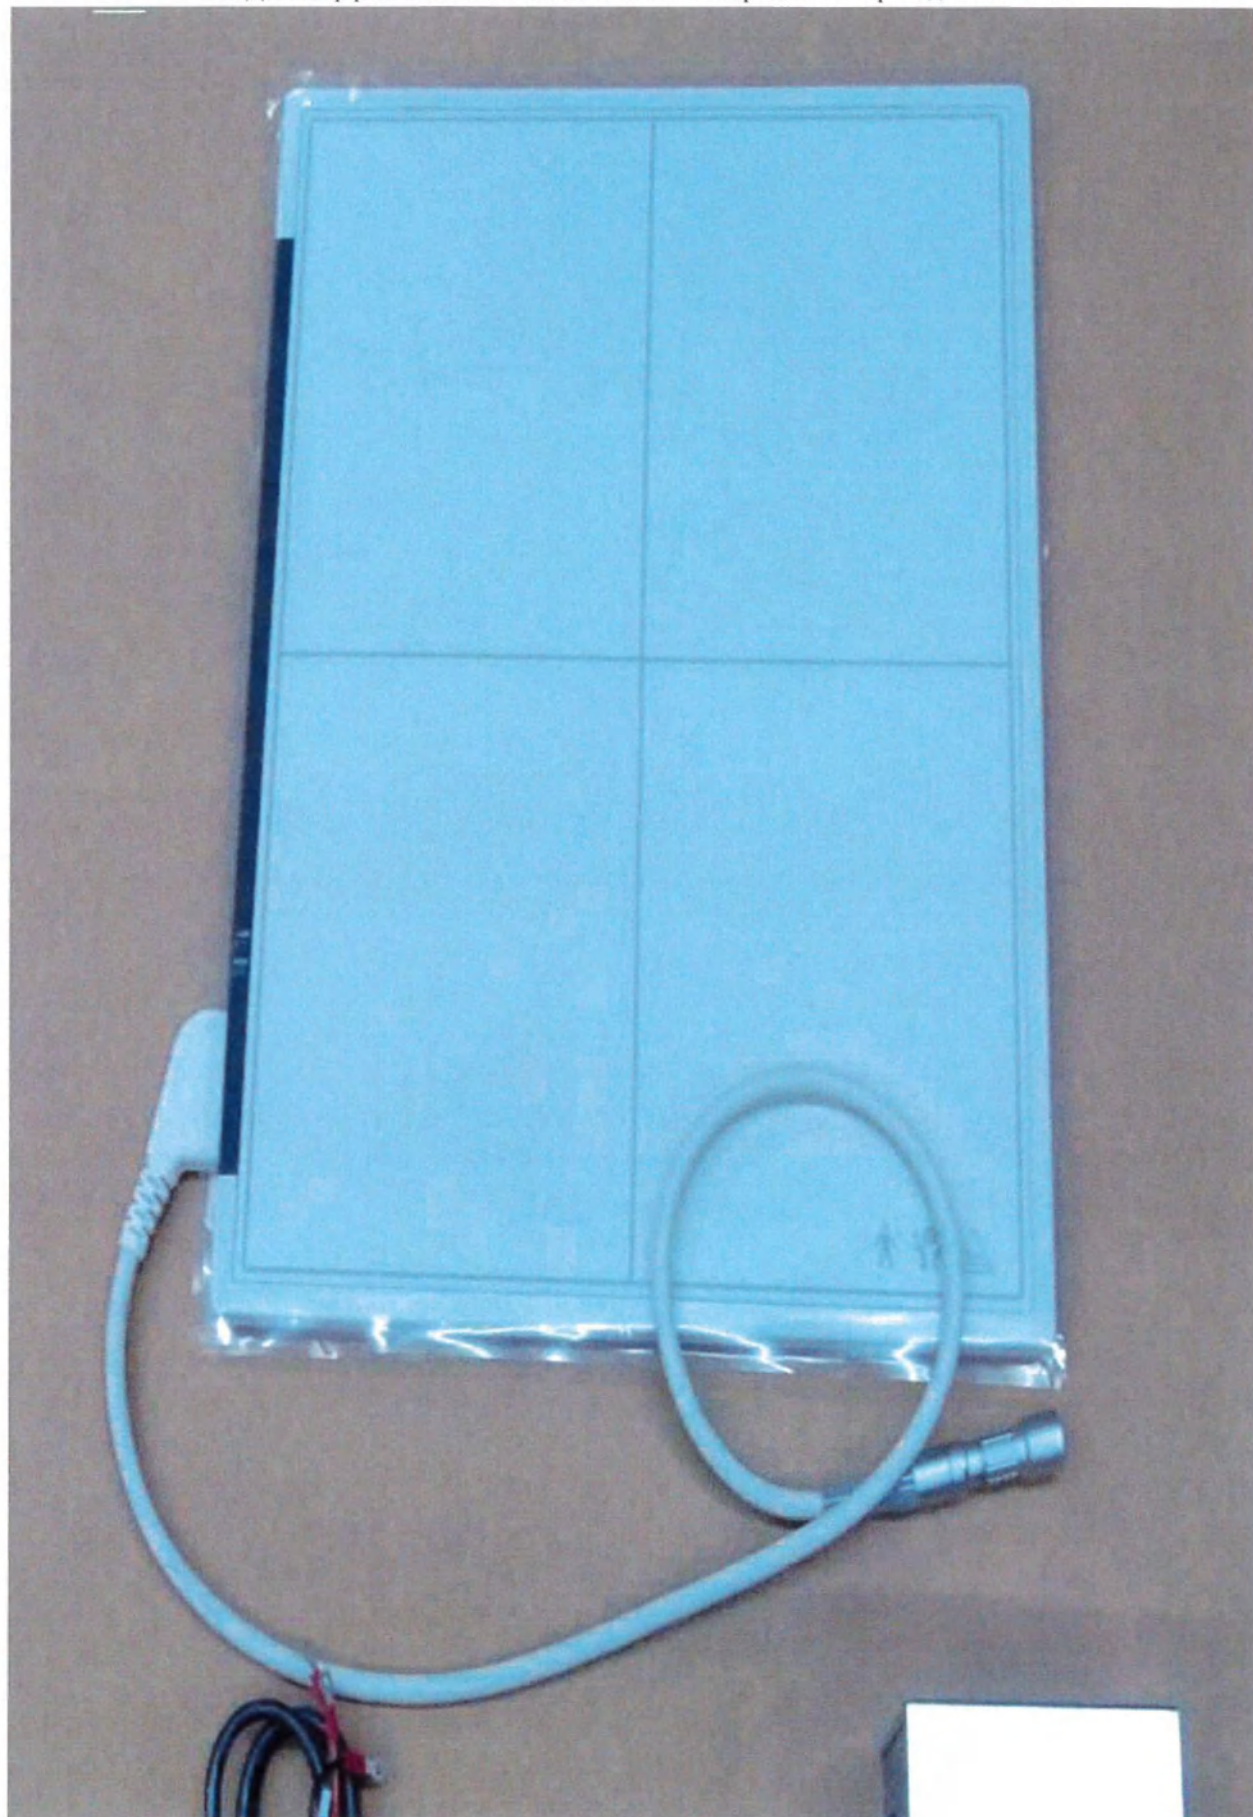

38


- или Система цифровой радиографии медицинская диагностическая Carestream DRX-1 System на основе плоскостанельного детектора рентгеновского излучения, с принадлежностями

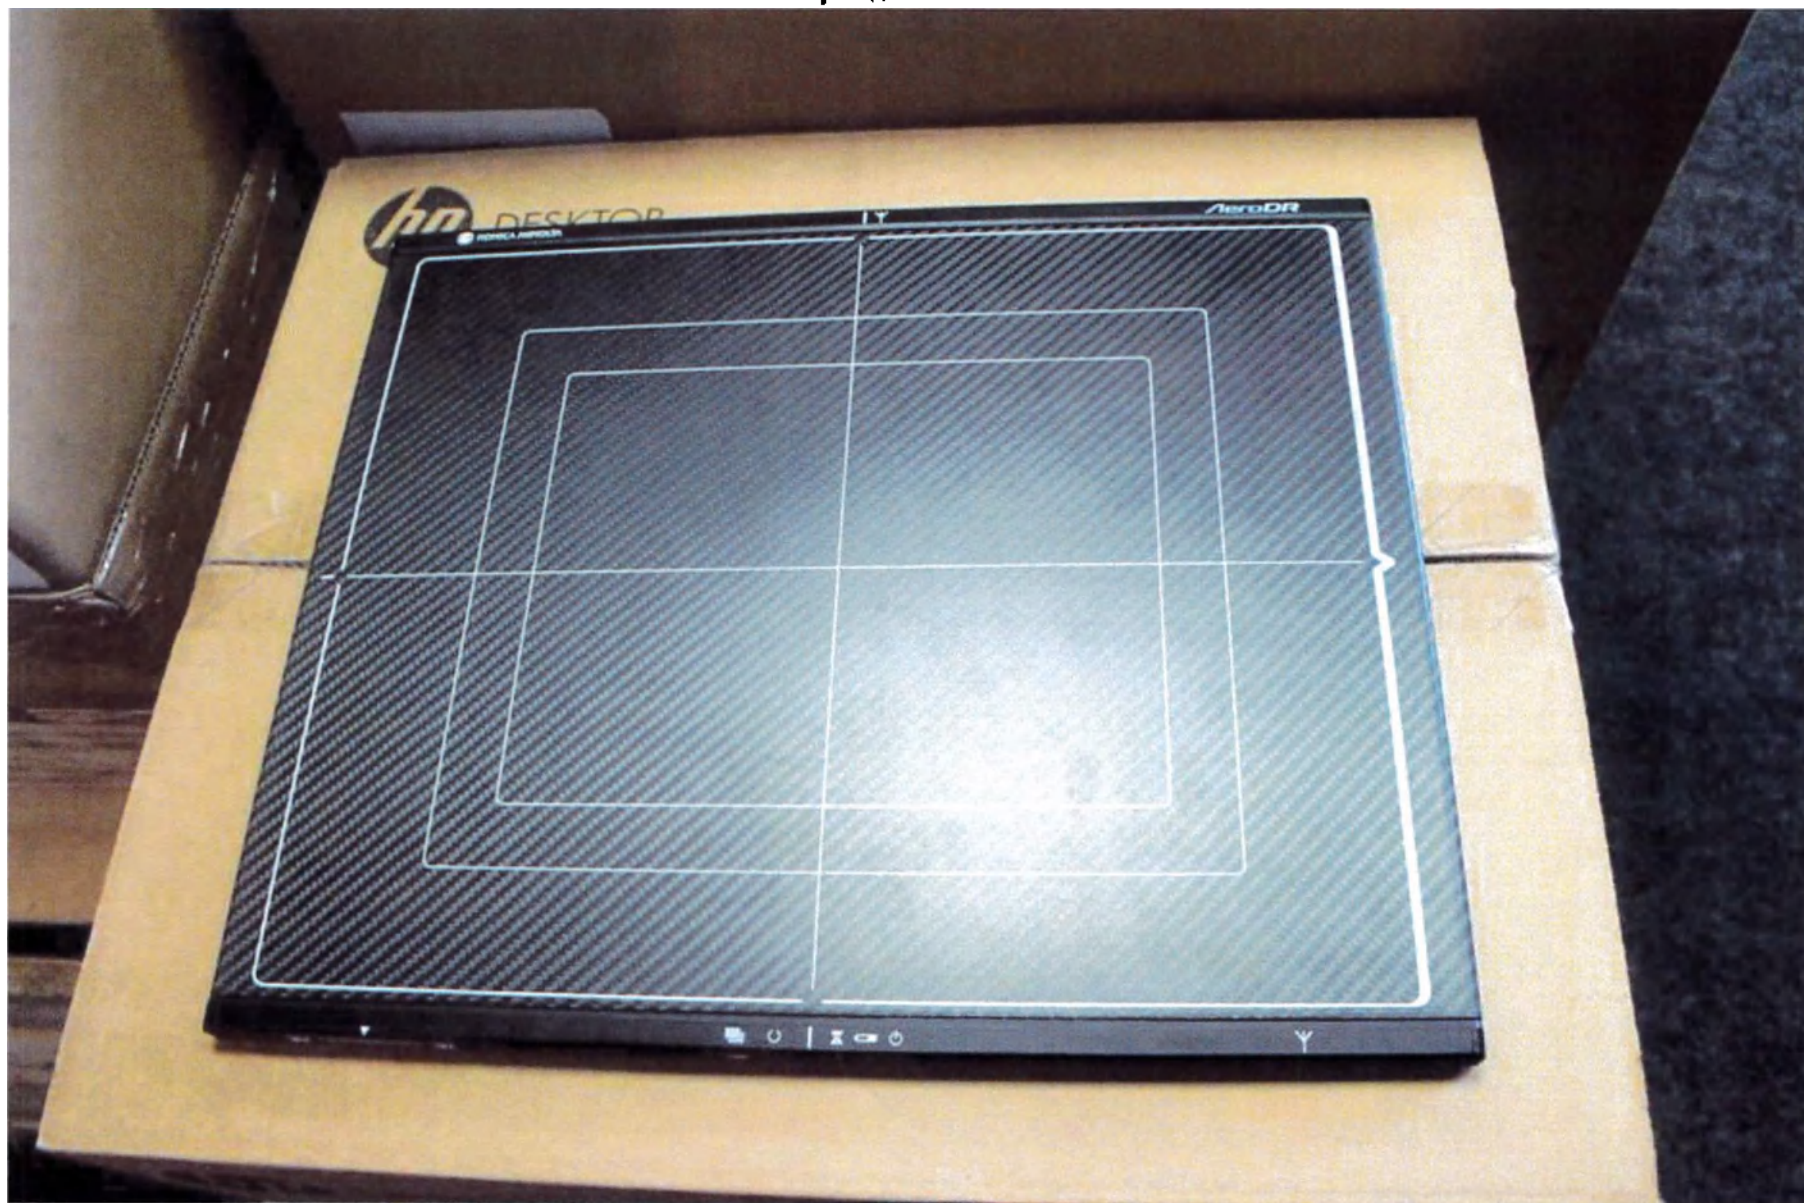

- или плоскпанельный детектор серии СОЛО ДР-МТ:



- или Устройство обработки рентгеновского изображения с принадлежностями, модели: 1417WCC, 1417WGC, 1717SCC, 1717SGC

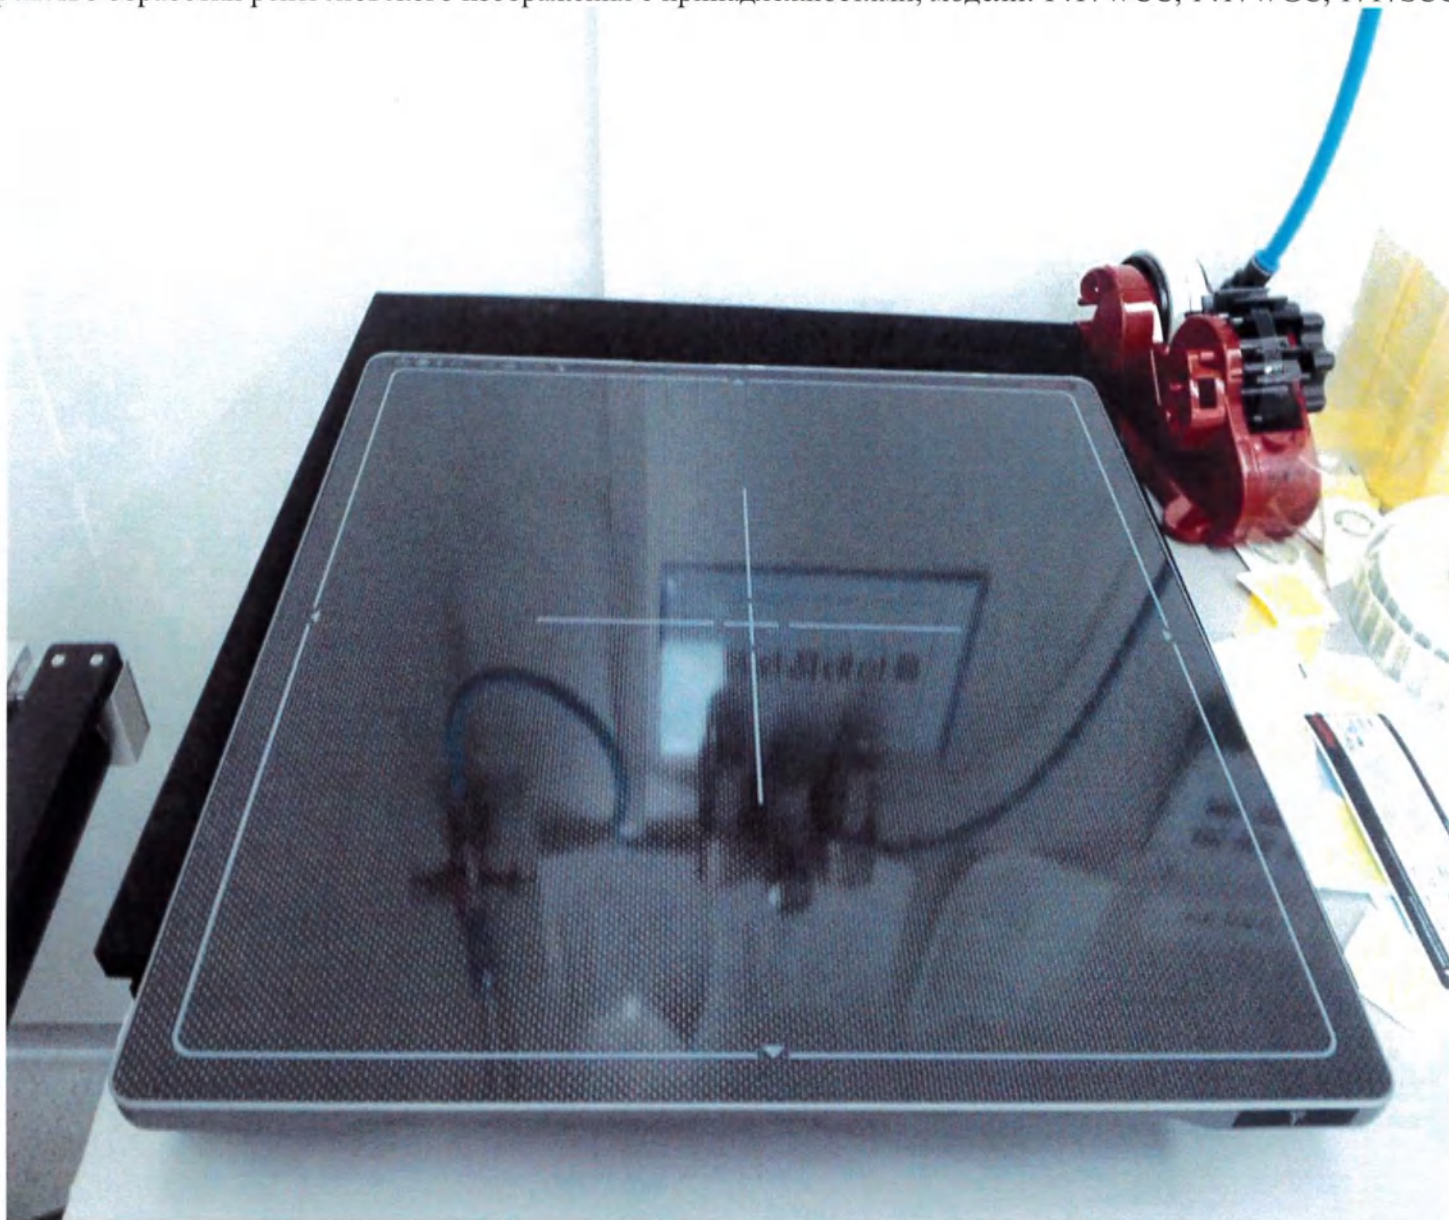



MANUFACTURER Rayence Co.,Ltd.

14, Samsung 1-ro 1-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea / www.rayence.com

Model : 1417WCC (Medical Image Processing Unit)

Rating : 24V ~~~

CAUTION : Use Only with RB37WHA
(Li-ion Battery) or RP003A
(Power Supply)

Prudence : N'utilisez qu'avec
RB37WHA(batterie) ou RP003A
(Circuit d'alimentation)

SDPPI Certificate number: 53321 / SDPPI / 2017
PLG ID: 7308



Date of Manufacture
2019.09.21



Serial Number
CGR019370193



(01)08800018600559


(11)190921

(21)CGR019370193

FCC ID : QIRYRWM001A

This device complies with part 15 of the
FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:
(1) This device may not cause harmful
interference.
(2) This device must accept any interference
including interference that may cause
operation of the device to cease.

This Class A digital apparatus complies with
ICES-001. Its radio frequency interference
emissions are limited to indoor use only.



VATECH Dental Manufacturer
Chancery House, St. Nicholas
Tel: +44 208 652 1990 Fax: +44 208 652 1991

Made in Korea





MANUFACTURER Rayence Co.,Ltd
14, Samsung 1-ro 1-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Kor
www.rayence.com

Model : 1717SCC (Medical Image Processing Unit)



Rating : 24V


For use with
RS1717 only.

CE0120




E34836


This equipment complies with IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and 21CFR Subchap



Serial Number
LDR217430771



Date of Manufacture
2017.11.09




VATECH Dental Manufacturing Ltd.
Chancery House, St. Nicholas Way,
Sutton, SM1 1JB, United Kingdom
Tel : +44 208 652 1990 / Fax : +44 208 652 1909
Made in Korea




(01)08800018
(11)171109
(21)LDR2174

- или Система цифровой визуализации рентгенографических изображений DX-D на основе плоскостанельных детекторов (DR) с принадлежностями

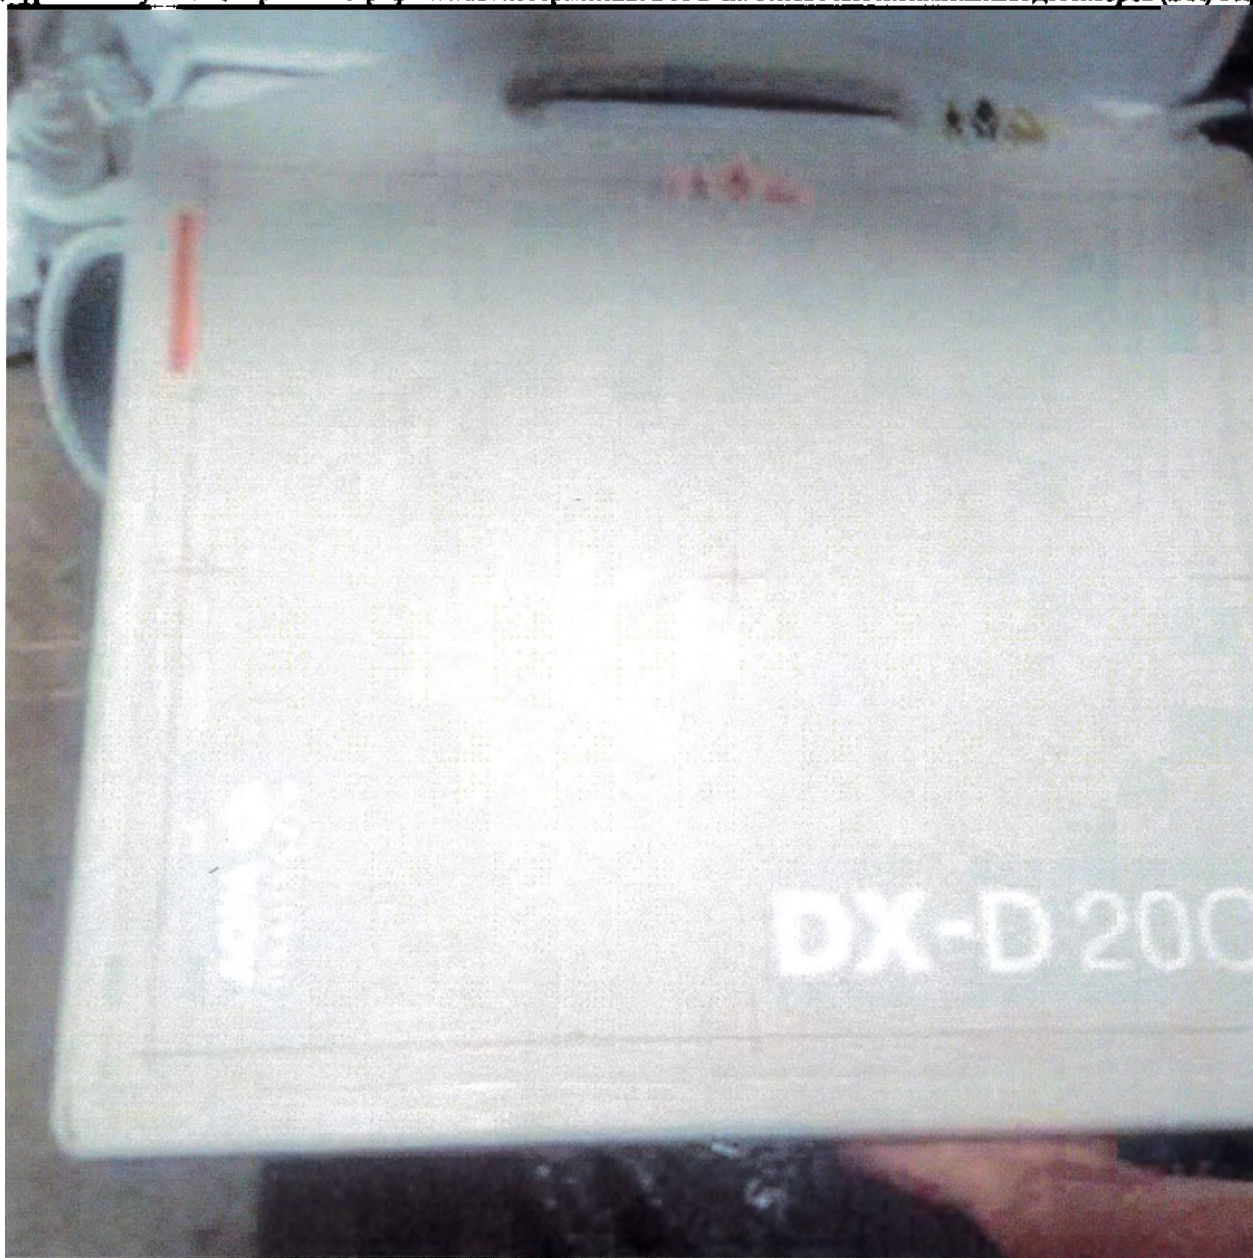


1.9 Дозиметр рентгеновского излучения клинический (при необходимости)
- Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012

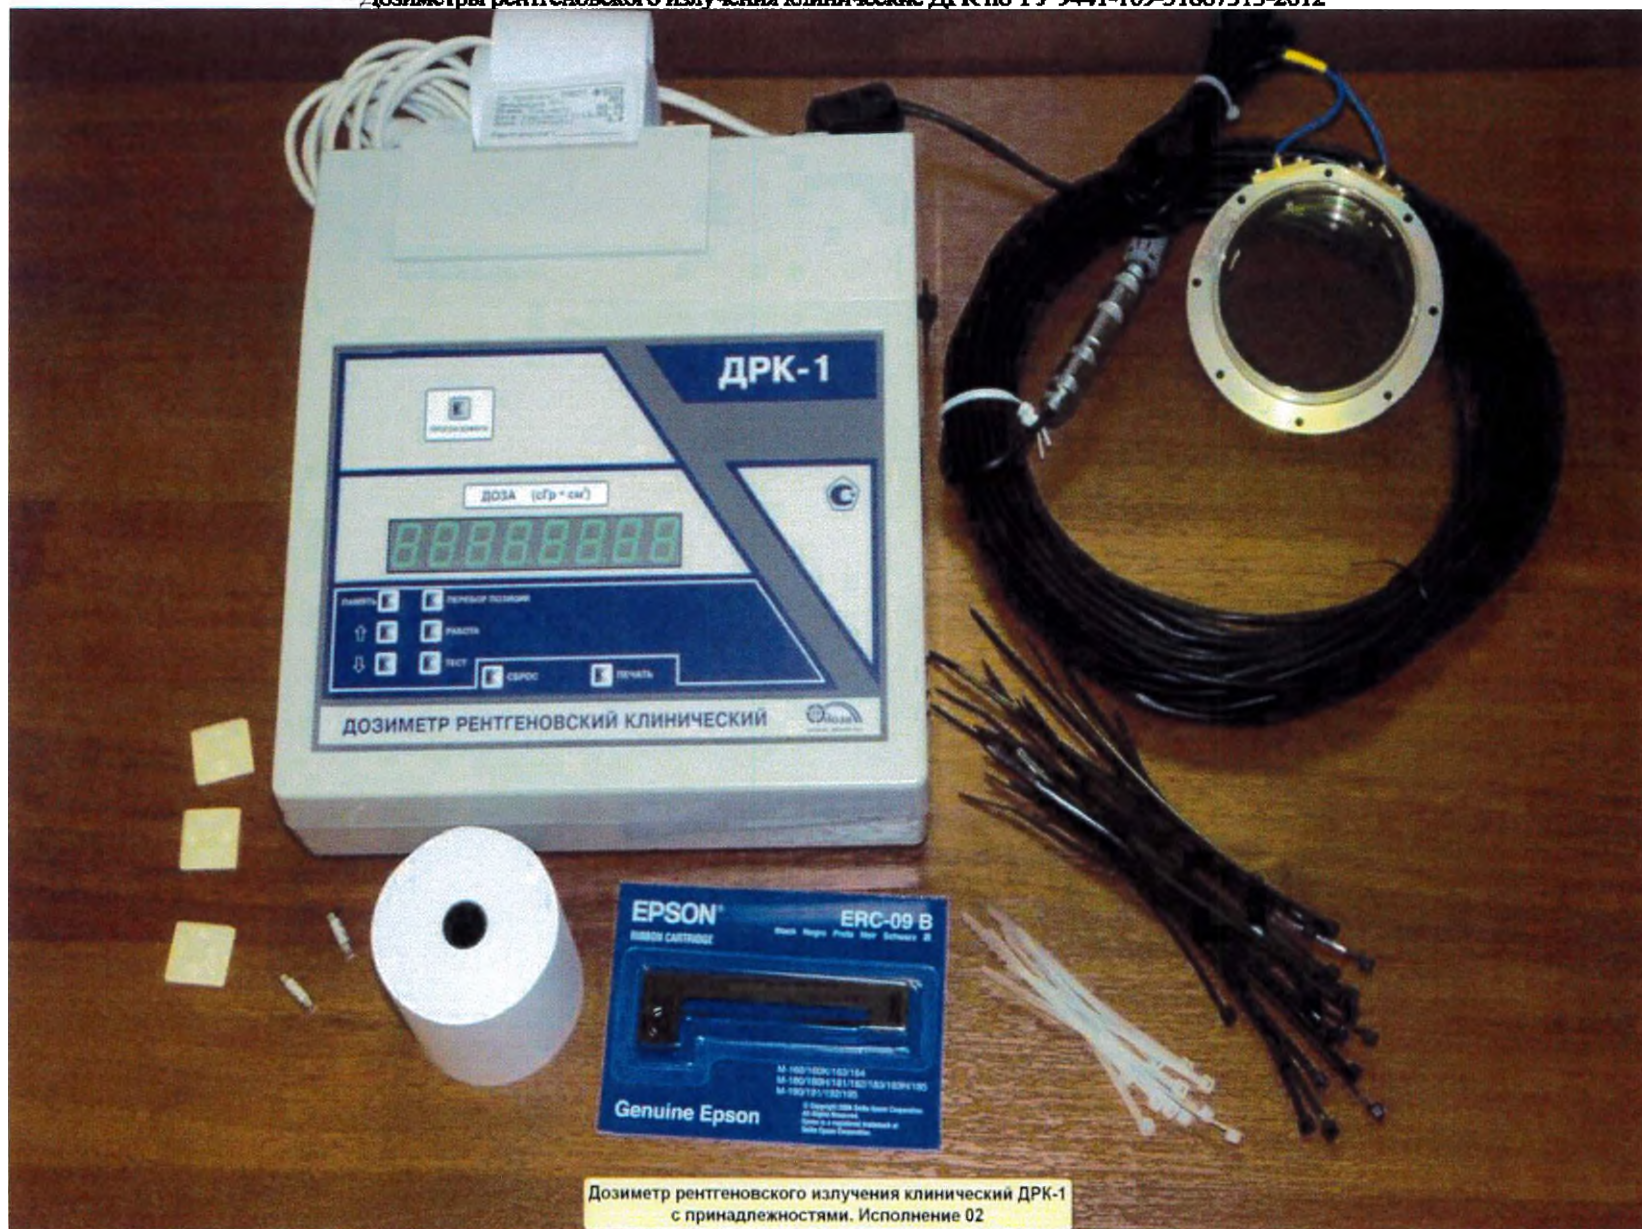

Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1
с принадлежностями. Исполнение 02

- или Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDapSystem

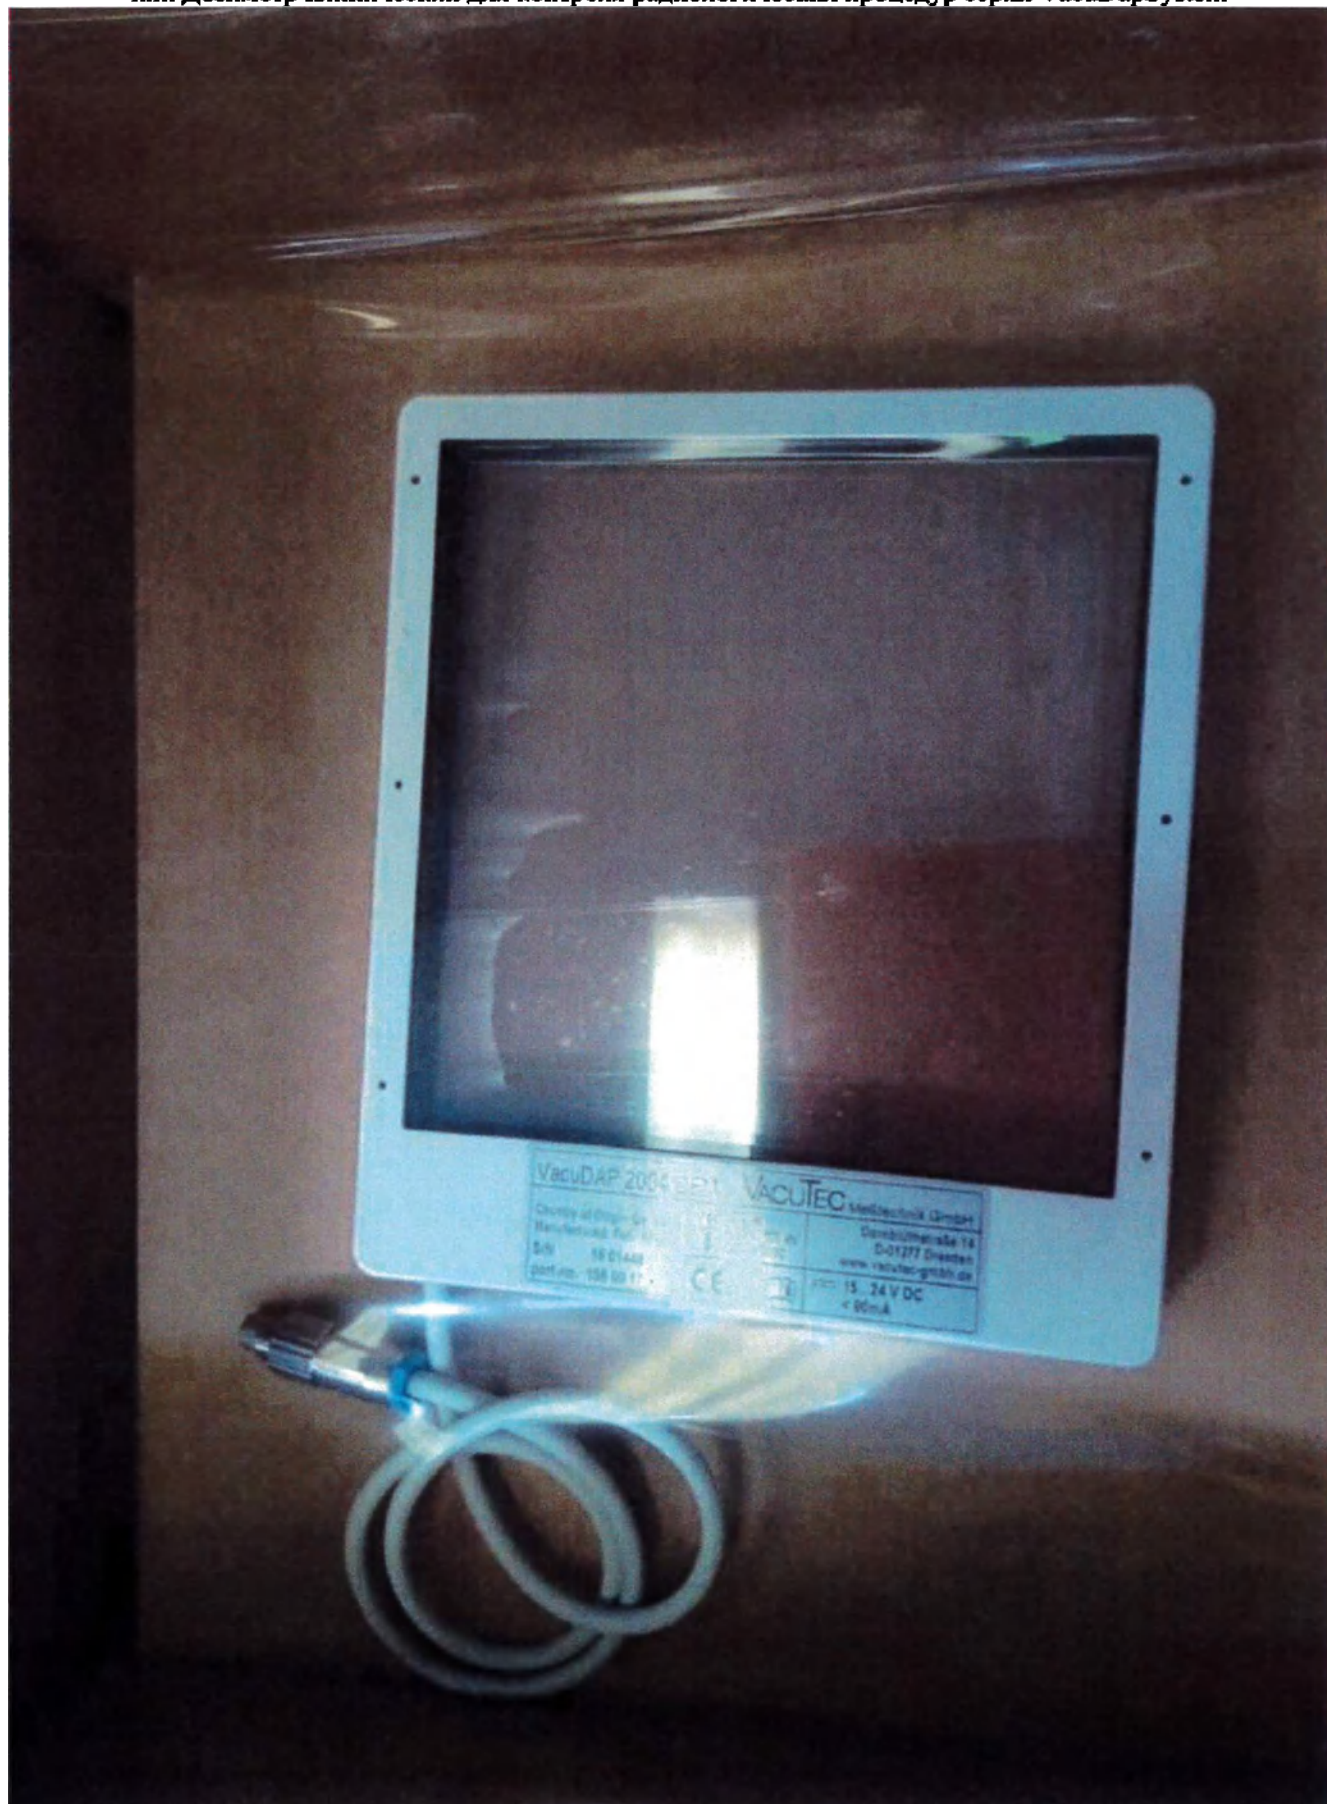


1.10 Кассеты радиографические с магнитным прижимом (при необходимости).

- Кассеты рентгеновские с экранами рентгеновскими в сборе:



42

- или Кассеты пластиковые рентгенографические "РЕНЕКС КРП" с усиливающими экранами по ТУ 9442-020-21009821-2014:

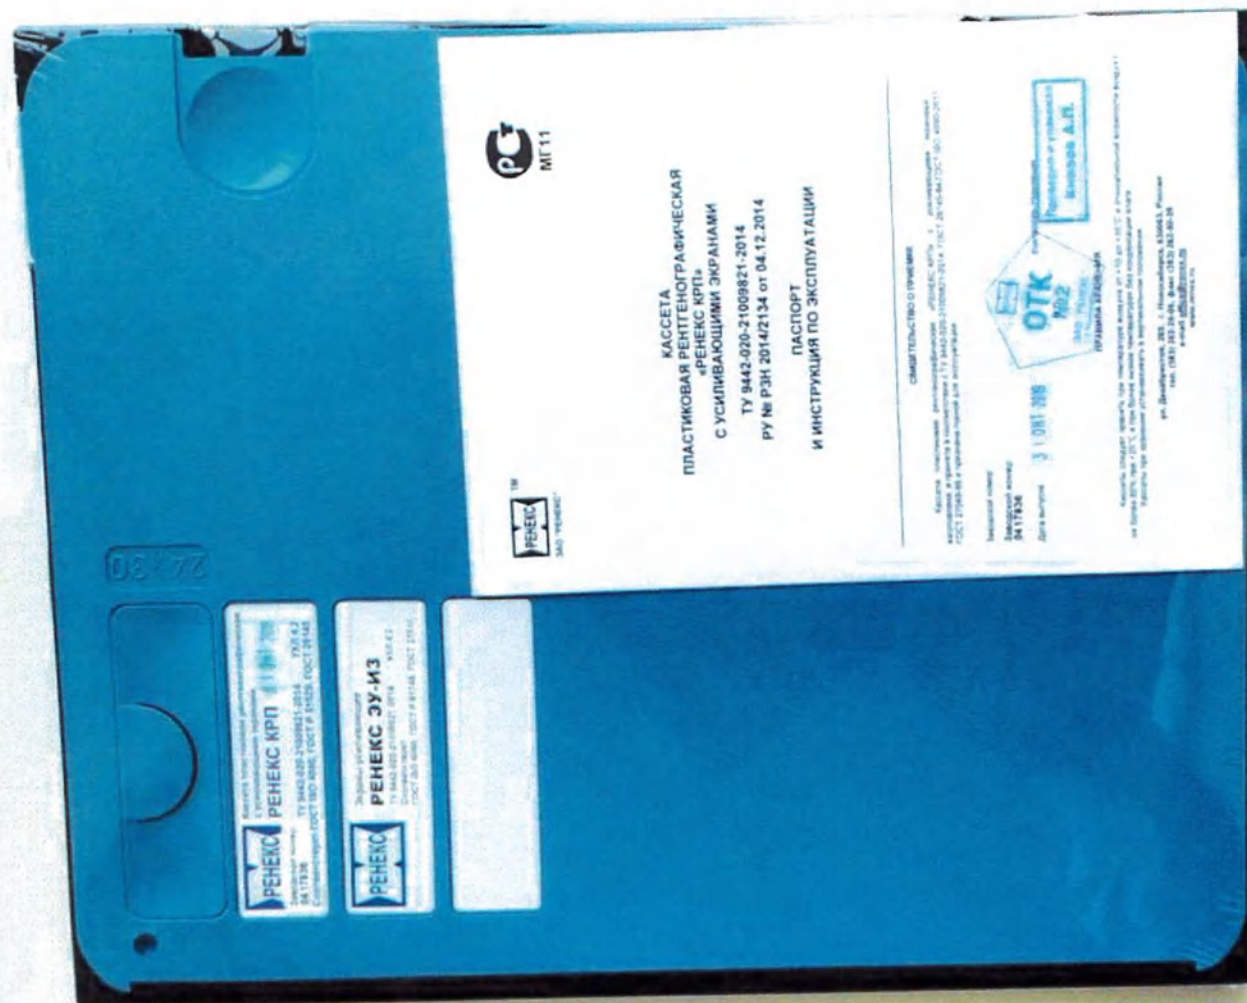

- или Кассеты медицинские рентгеновские AGFA CPB 200, CPB 400:



- или Кассеты рентгенографические медицинские с усиливающим экраном CAWO:



1.12 Система компьютерной радиографии (при необходимости).
- Система компьютерной радиографии REGIUS, модель 210 с принадлежностями:




- или Система компьютерной радиологии REGIUS 110 с принадлежностями:



- или Система компьютерной радиографии с принадлежностями, варианты исполнения: REGIUS SIGMA (DirectDigitizer REGIUS SIGMA), REGIUS SIGMA 2 (DirectDigitizer REGIUS SIGMA 2):



- или Система цифровой радиологии VitaFlex CR System с принадлежностями:

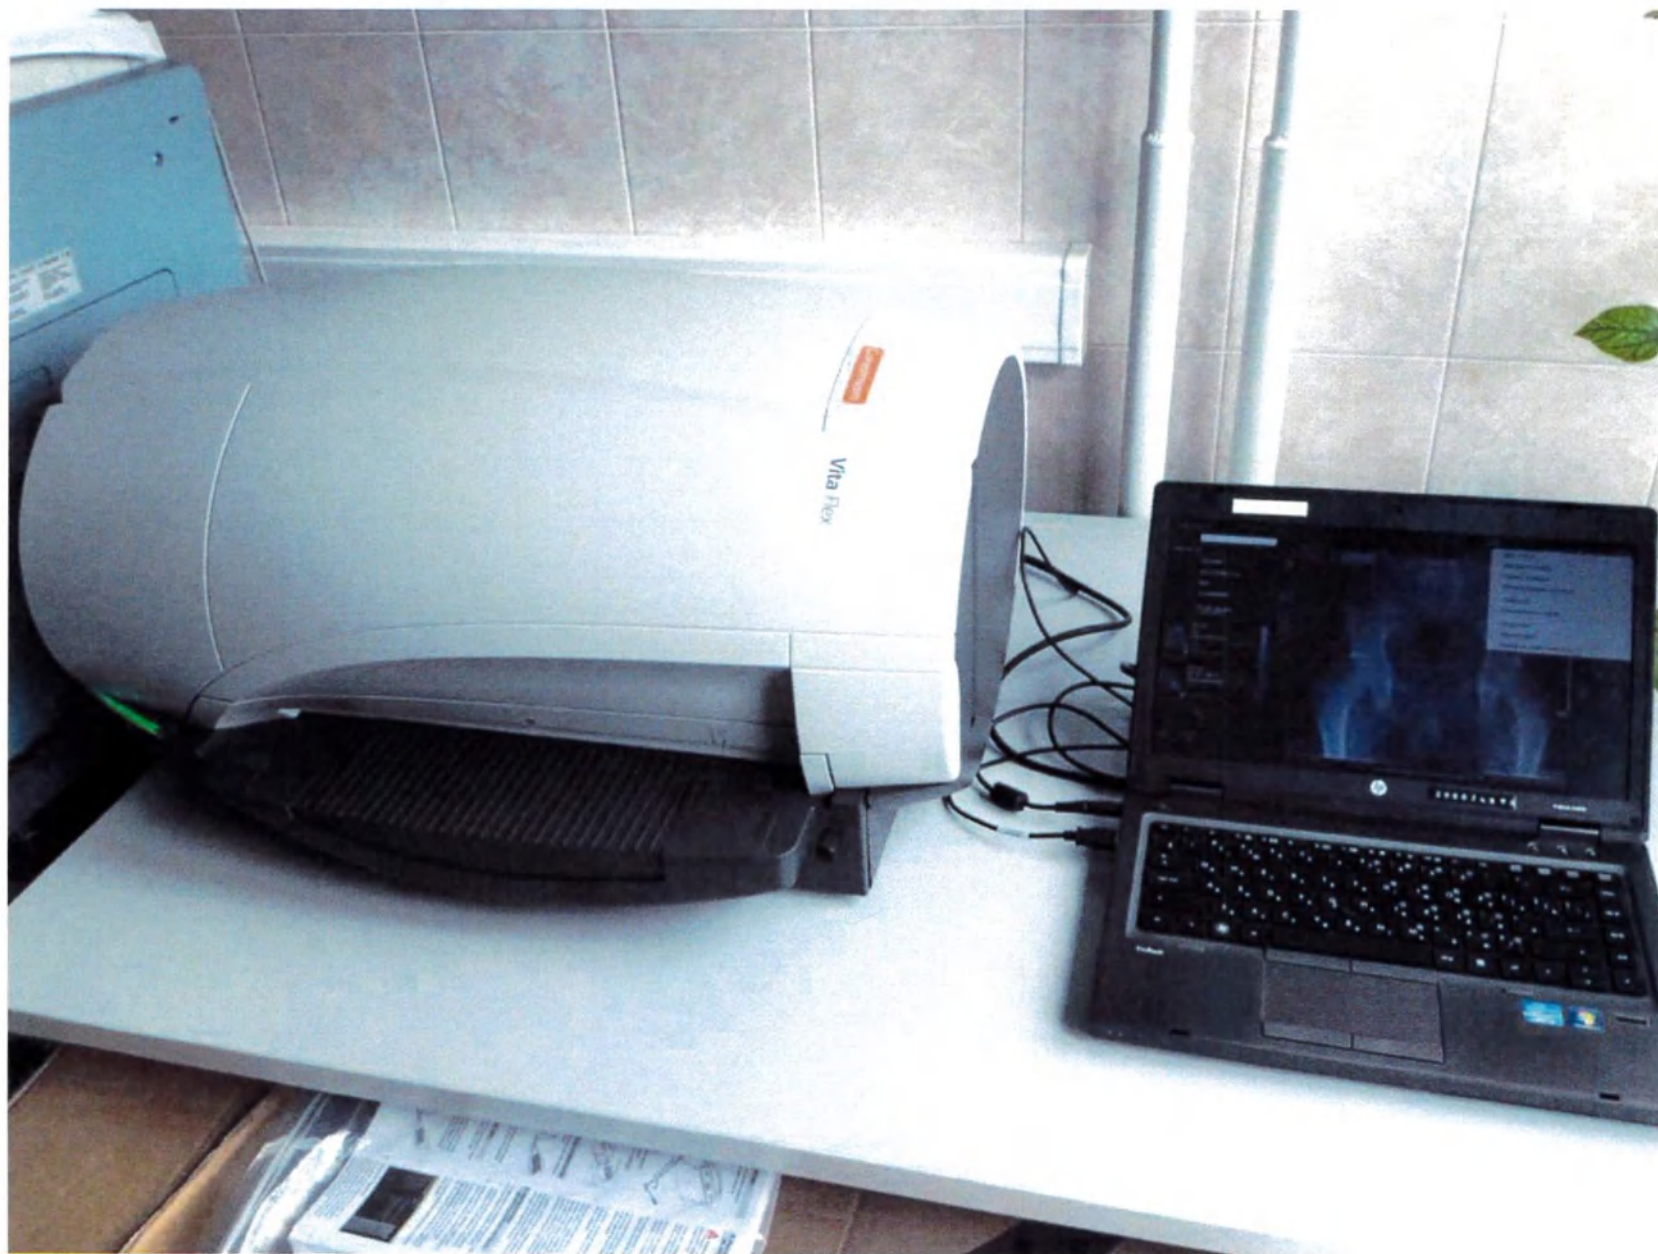

- или Система цифровой радиологии CR System на основе фотостимулируемых люминофоров, с принадлежностями:



- или Аппарат рентгеновский цифровой мобильный FCR GO2 (FCR-MB 201) с принадлежностями:



- или Аппарат цифровой радиологии на основе восстанавливаемых люминофоров CR-IR 391RU с принадлежностями:




- или Устройство для цифровой радиологии на основе фотостимулируемых люминофоров FCR Capsula XL2 (CR-IR 359), с принадлежностями:



- или Система компьютерной рентгенографии CR с принадлежностями:



- или Комплекс цифровой CR диагностический для получения и архивирования медицинских рентгеновских изображений с принадлежностями:

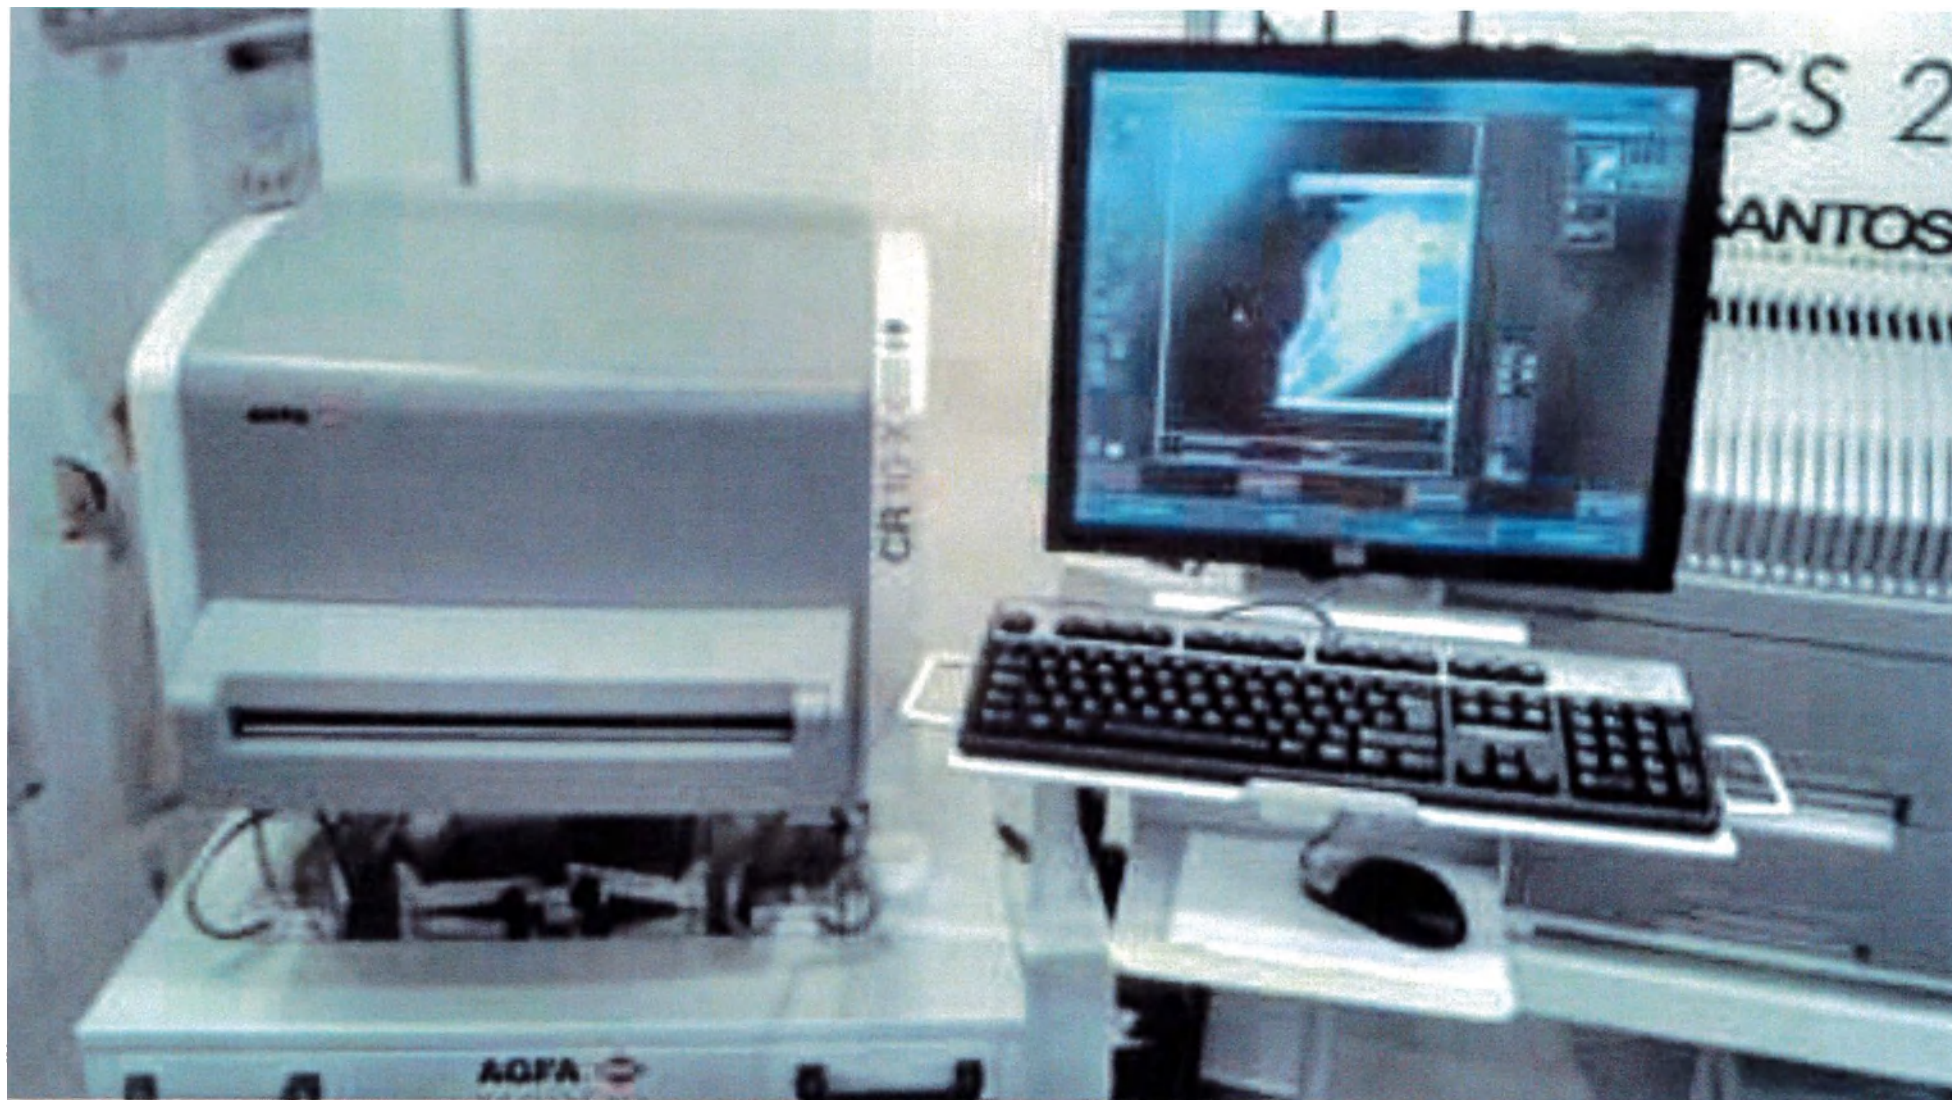

- или Комплекс цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений с принадлежностями, цифровой дигитайзер DX-G, DX-M





1.12 Камера лазерная мультиформатная медицинская (при необходимости).

- Камера лазерная мультиформатная медицинская DRYPRO, модель 873 (LaserImagerDRYPROModel 873) с принадлежностями:



- или Камера лазерная мультиформатная медицинская DRYPRO, модель 832 (LaserImagerDRYPRO, Model 832) с принадлежностями:



- или Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA с принадлежностями:



- или Камера мультиформатная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями:




- или Камера мультиматная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями:



- или Камера мультимедийная термографическая Drystar 5503 с принадлежностями:



- или Устройство печати цифровых диагностических медицинских изображений "Horizon":

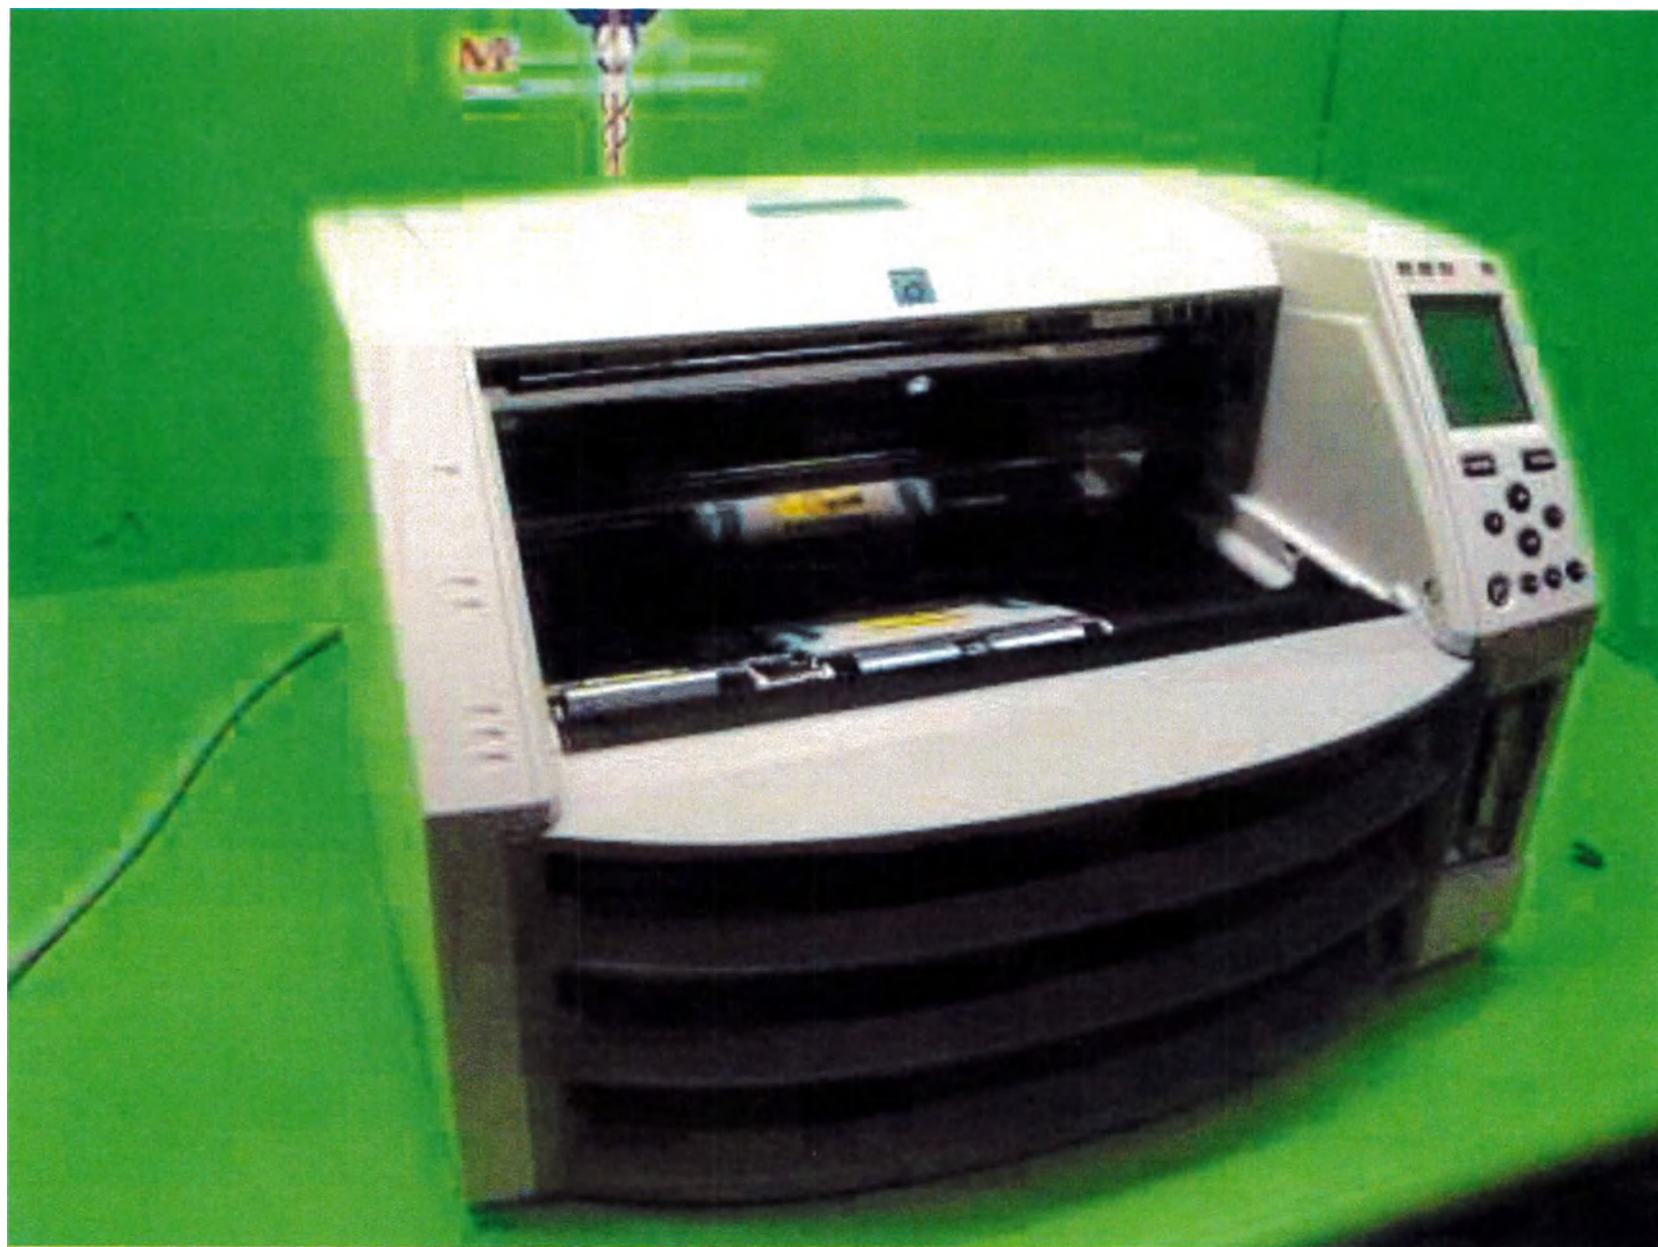

- или Камера лазерная мультиформатная DRYVIEW 5700 LaserImagingSystem для печати медицинских изображений, с принадлежностями:



- или Камера лазерная мультимедийная DRYVIEW 5950 LaserImagingSystem с принадлежностями:



- или камера лазерная мультиформатная медицинская: серии CarestreamDryView 5850 LaserImager:



- или Камера медицинская лазерная мультимедийная DryPixPrima (FM-DL 100) с принадлежностями:



- или Камера медицинская термографическая мультиматная DRYPIX 2000 исполнения DRYPIX Lite с принадлежностями:



1.13 Стартовый комплект (упаковка) расходных материалов для камеры мультимедийной медицинской (при необходимости)


- Пленка медицинская рентгеновская DRYVIEWDVB+LaserImagingFilm



DRYVIEW
Laser Imaging Film

[illegible]

Do not stack trays on each other
We put empty trays in barquettes
Stapeln Sie die Tische nicht übereinander
Do not use the barquettes
Stapel laden nie so hoch
Non dispose i vassoi uno sull'altro
Also empty tabuliers
不要将托盘堆放
トレイを重ねないでください
Spinnen sich die Köpfe.

[illegible]

本書は、戦後日本経済の発展に果たした役割を明らかにし、その意義を論じている。

78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 5

www.elsevier.com/locate/jmr

DRYVIEW DVE

[illegible][illegible]

- или Пленка термографическая медицинская DrystarDT 10B



- или Пленка термографическая медицинская DrystarDT 1B

AGFA



DRYSTAR
DT 1B

DRY MEDICAL FILM

100 mm 33x43 14x17 cm



Agfa-Gevaert AG
Scheidtstrasse 1
40880 Zeitz, Germany
Member of Agfa Group
Productivity and performance are key.



- или Носители пленочные для термической печати диагностических медицинских изображений
DirectVista




28

- или Пленка рентгеновская, варианты исполнения: DRYVIEW DVE LaserImagingFilm, TRIMAX TXE LaserImagingFilm, TRIMAX TXB+ LaserImagingFilm



- или Пленка медицинская термографическая и лазерная: DI-AT, DI-HT, DI-HL, DI-HL2, DI-AL, DI-ML

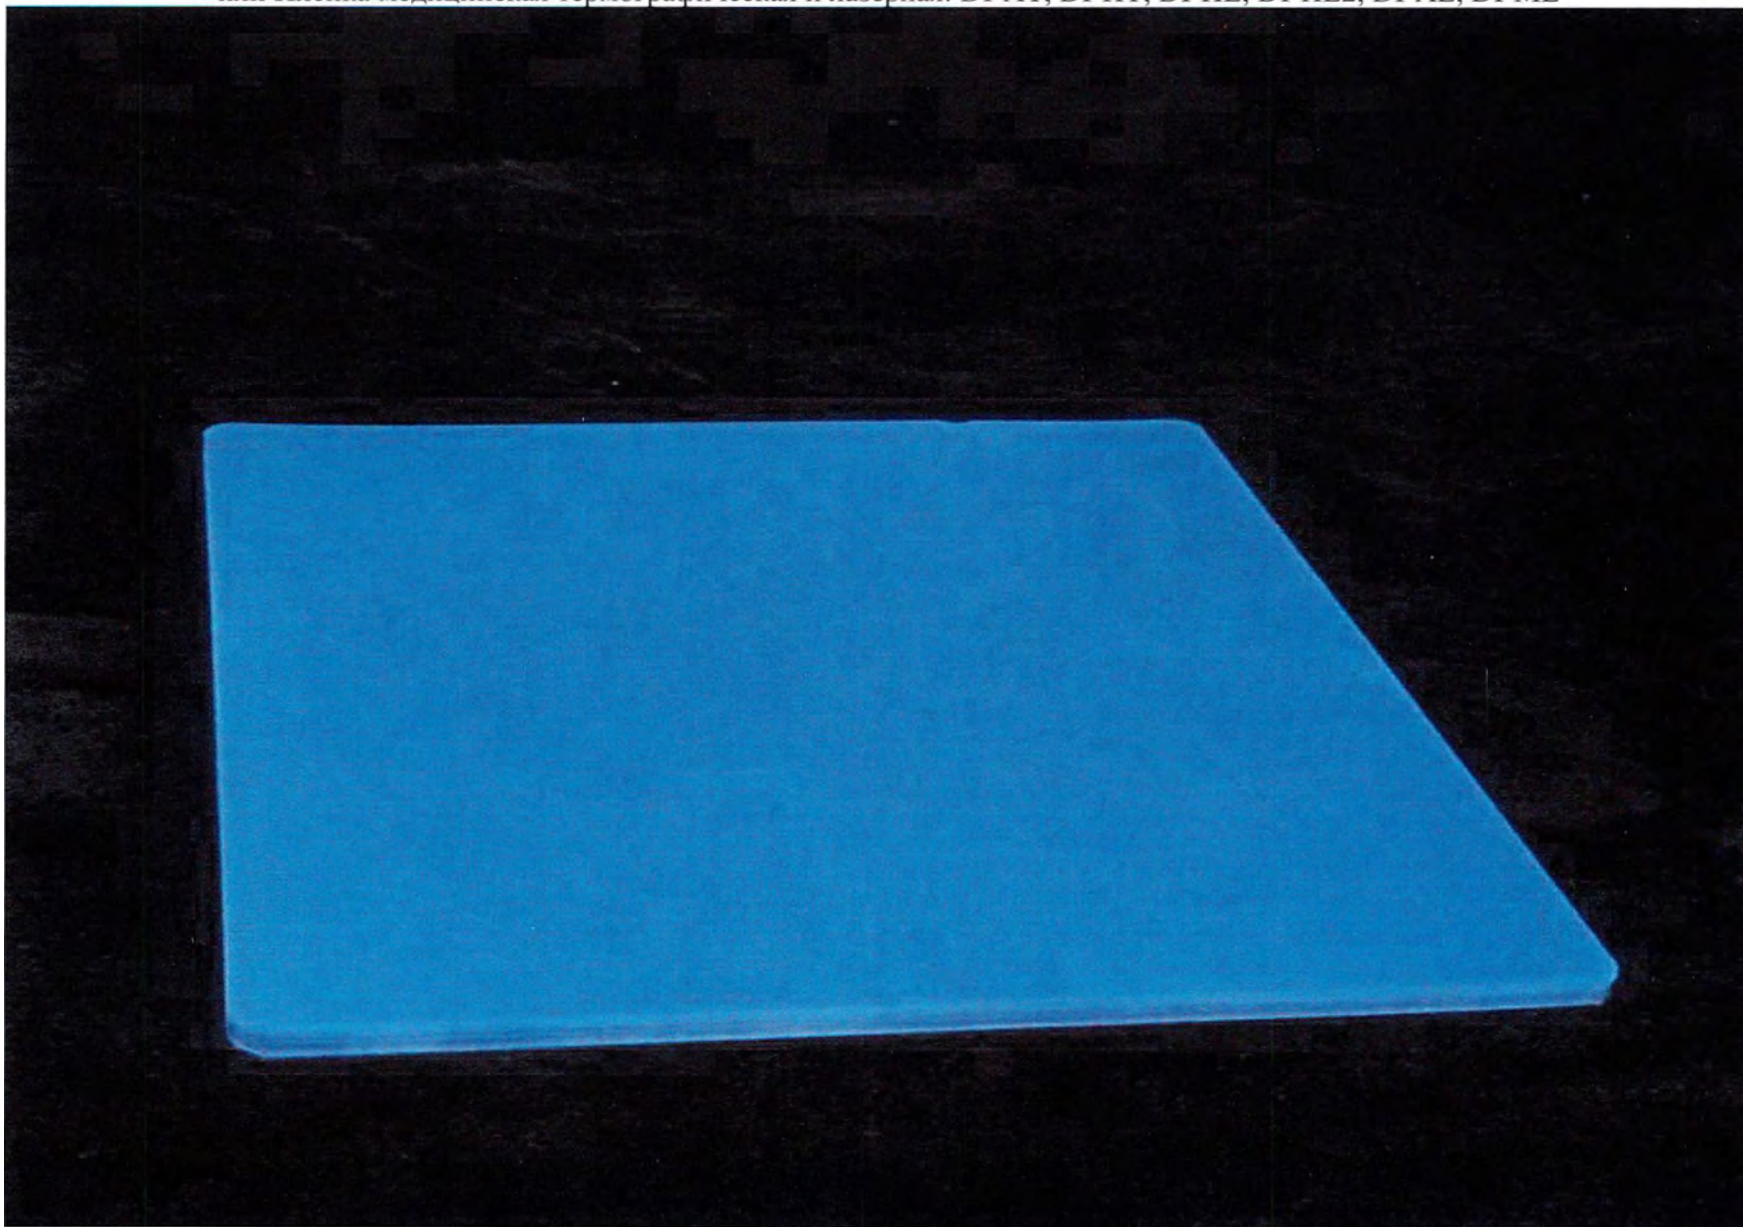

- или Пленка рентгеновская SD-S (MedicalImagingFilm SD-S) различных форматов



1.14 Машина для проявки медицинских рентгеновских пленок (при необходимости).


- Машины для проявления медицинских рентгеновских пленок модели: MedicalFilmProcessorSRX-101A с принадлежностями:



- или Машина для проявления медицинских рентгеновских пленок Medical X-rayProcessor 102 с принадлежностями



- или Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок «ОПТИМАКС-АМИКО» по ТУ 9452-008-34597883-2002:

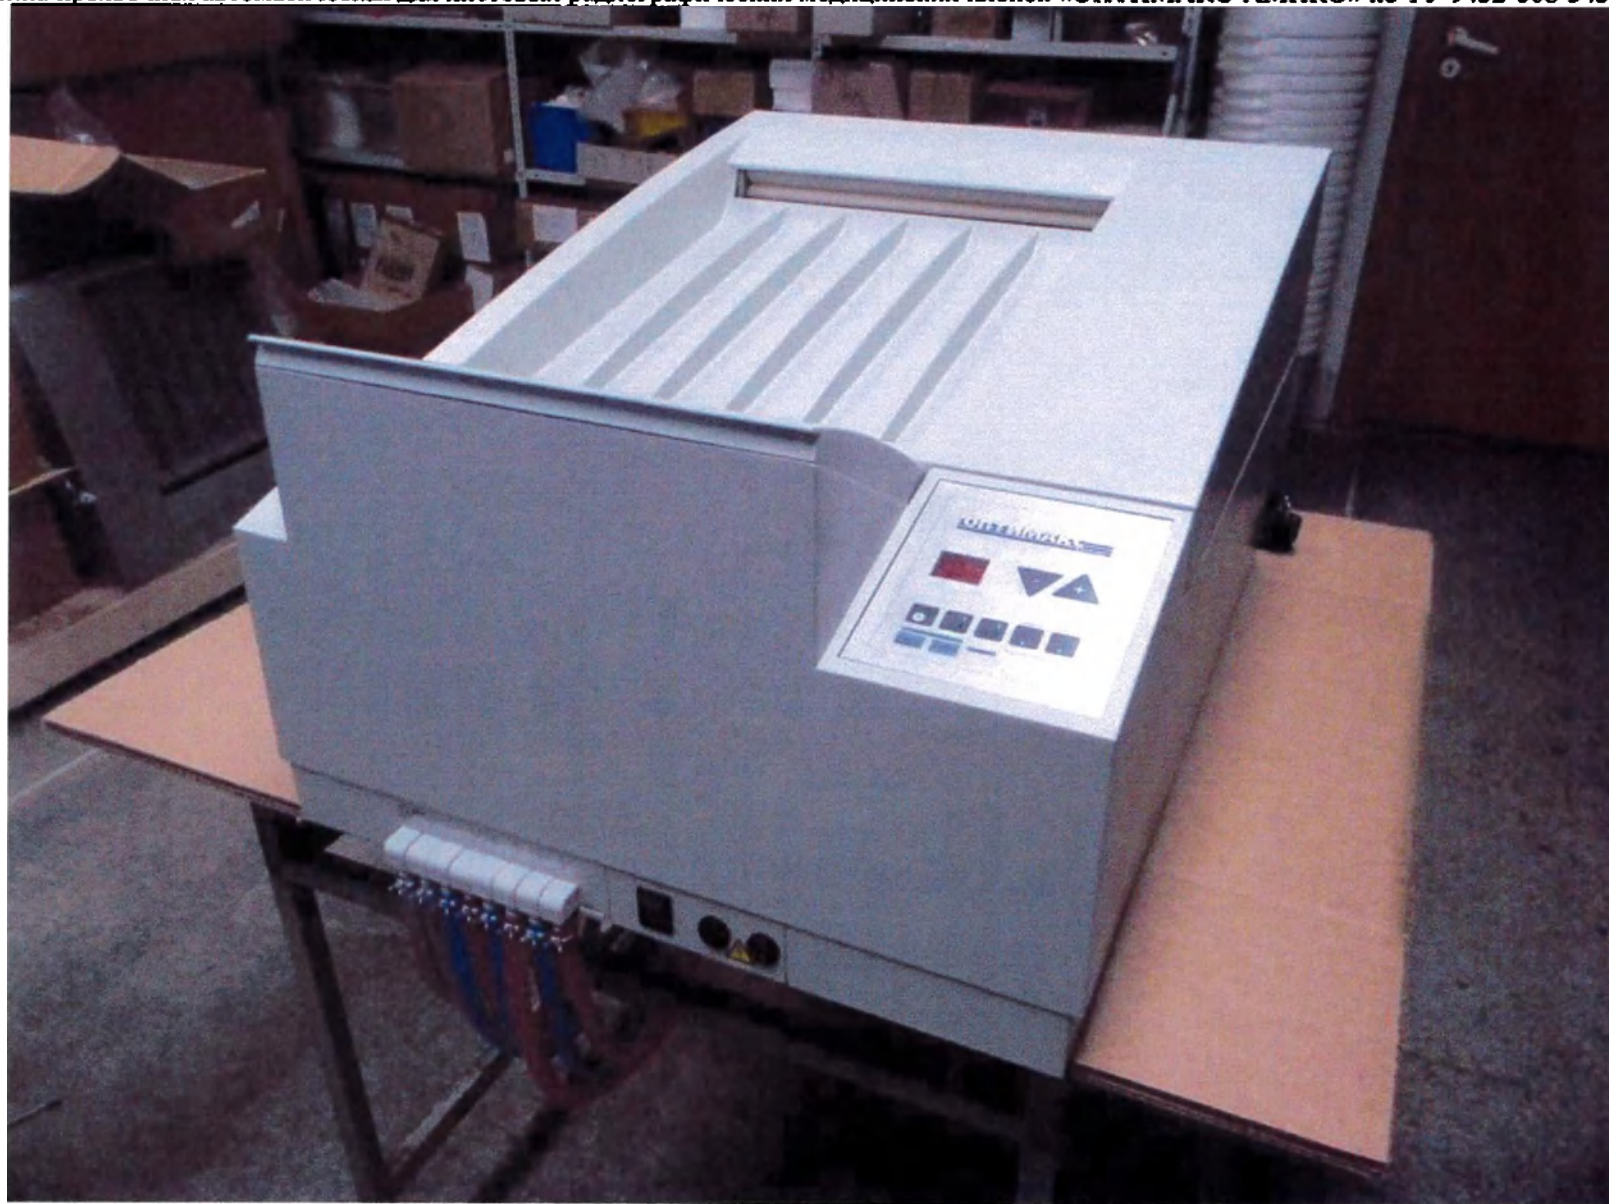

- или Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок "МиниМед-4МТ" по ТУ 9452-037-47245915-2012



1.15 Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований (АРМ врача) (при необходимости).


- Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» по ТУ 9440-001-98944313-2007:



- или Комплекс аппаратно-программный для регистрации и цифровой обработки рентгеновского изображения «ВизиР-МТ» по ТУ 9442-035-47245915-2011:



- или Комплексы аппаратно-программные для ввода, обработки и хранения диагностической информации в составе: АРМ врача-диагноста "Гамма Мультивокс Д1" и "Гамма Мультивокс Д2"; АРМ для просмотра изображений "Гамма Мультивокс П"; АРМ медицинской сестры/рентгенлаборанта "Гамма Мультивокс Р" и сервер базы данных "Гамма Мультивокс С" по ТУ 9452-005-42879986-2006:

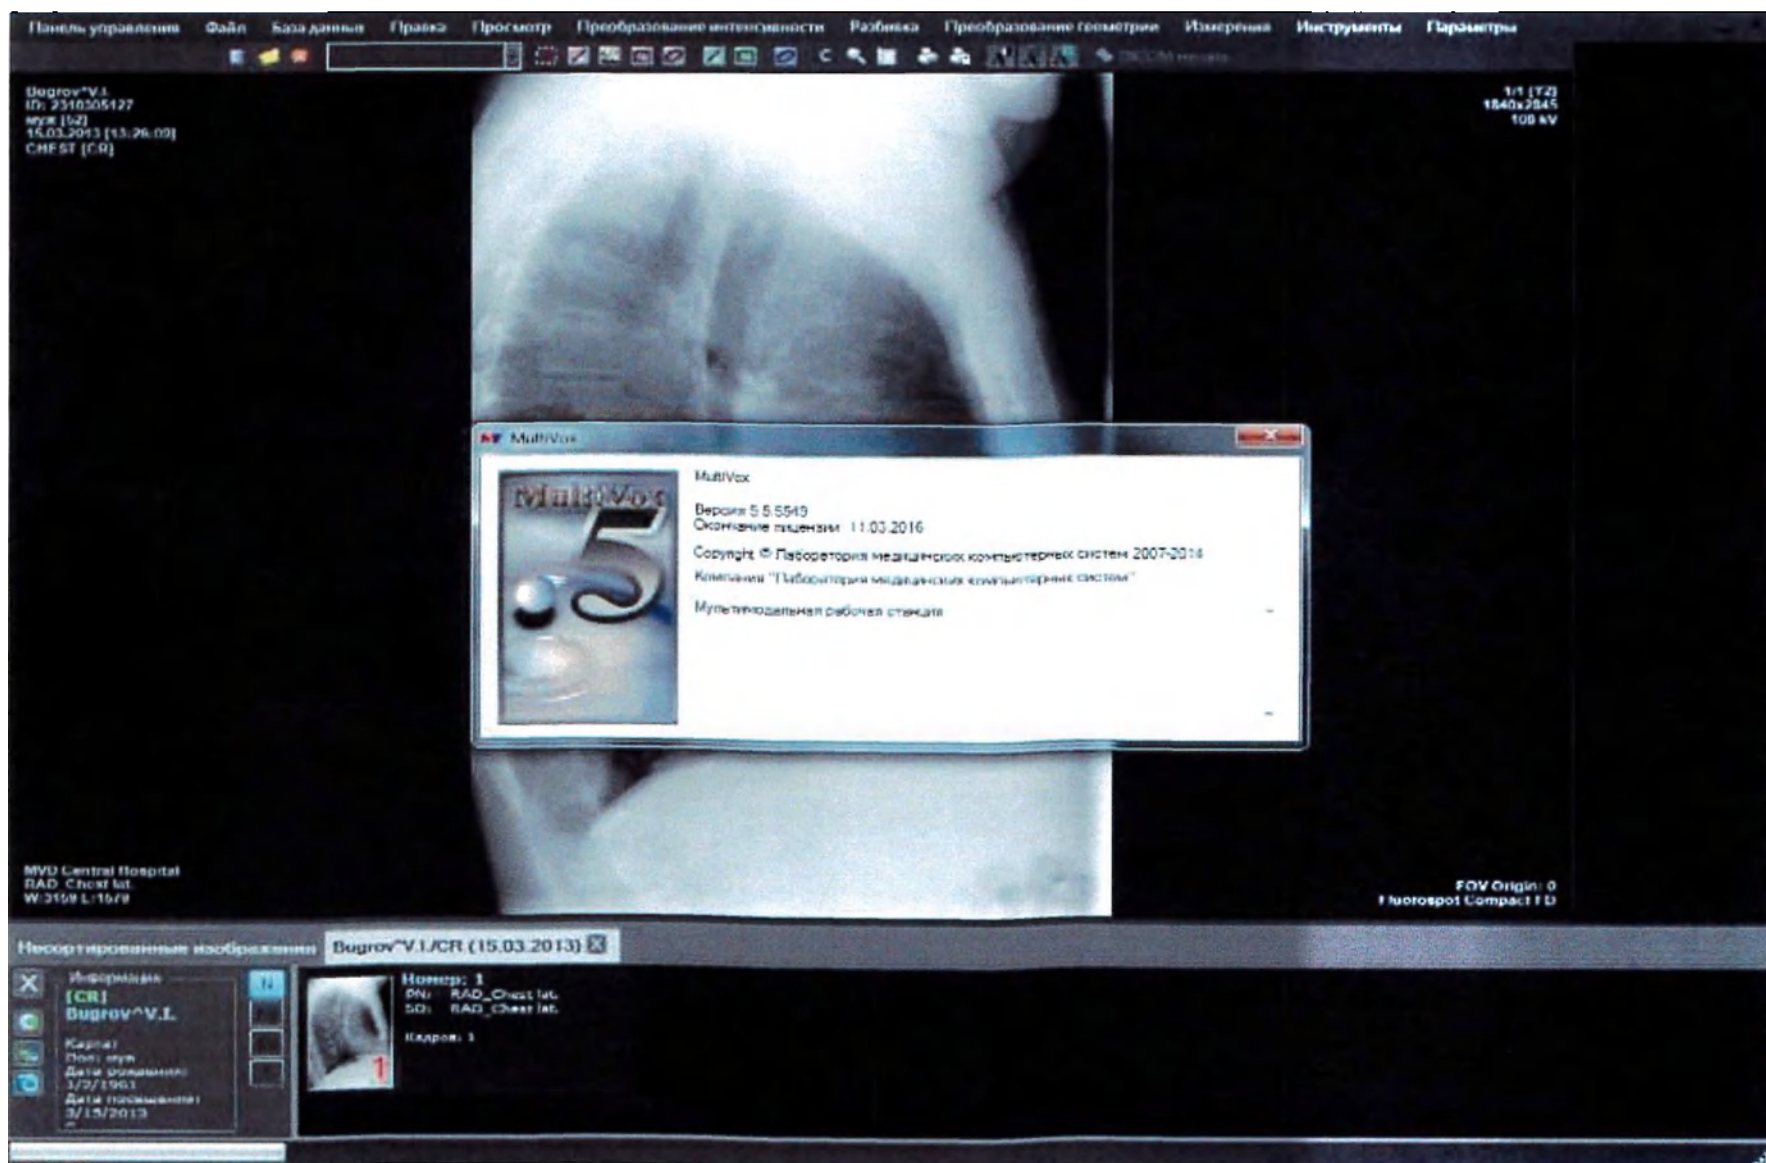

- или Комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон Рабочая станция врача» по
ТУ 9442-233-38226244-2015 с принадлежностью:



- или Комплекс программ для визуализации, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон DICOM Архив» по ТУ 9442-133-38226244-2015 с принадлежностями:




92

- или Комплекс программ для архивирования, протоколирования и экспорта медицинских данных и изображений «ЛИНС LookInside» по ТУ 5090-380-38226244-2015:



- или Комплекс аппаратно-программный для получения, обработки, передачи и архивирования цифровых медицинских рентгеновских изображений «ДИАРМ-МТ»
по ТУ 9442-029-47245915-2008;

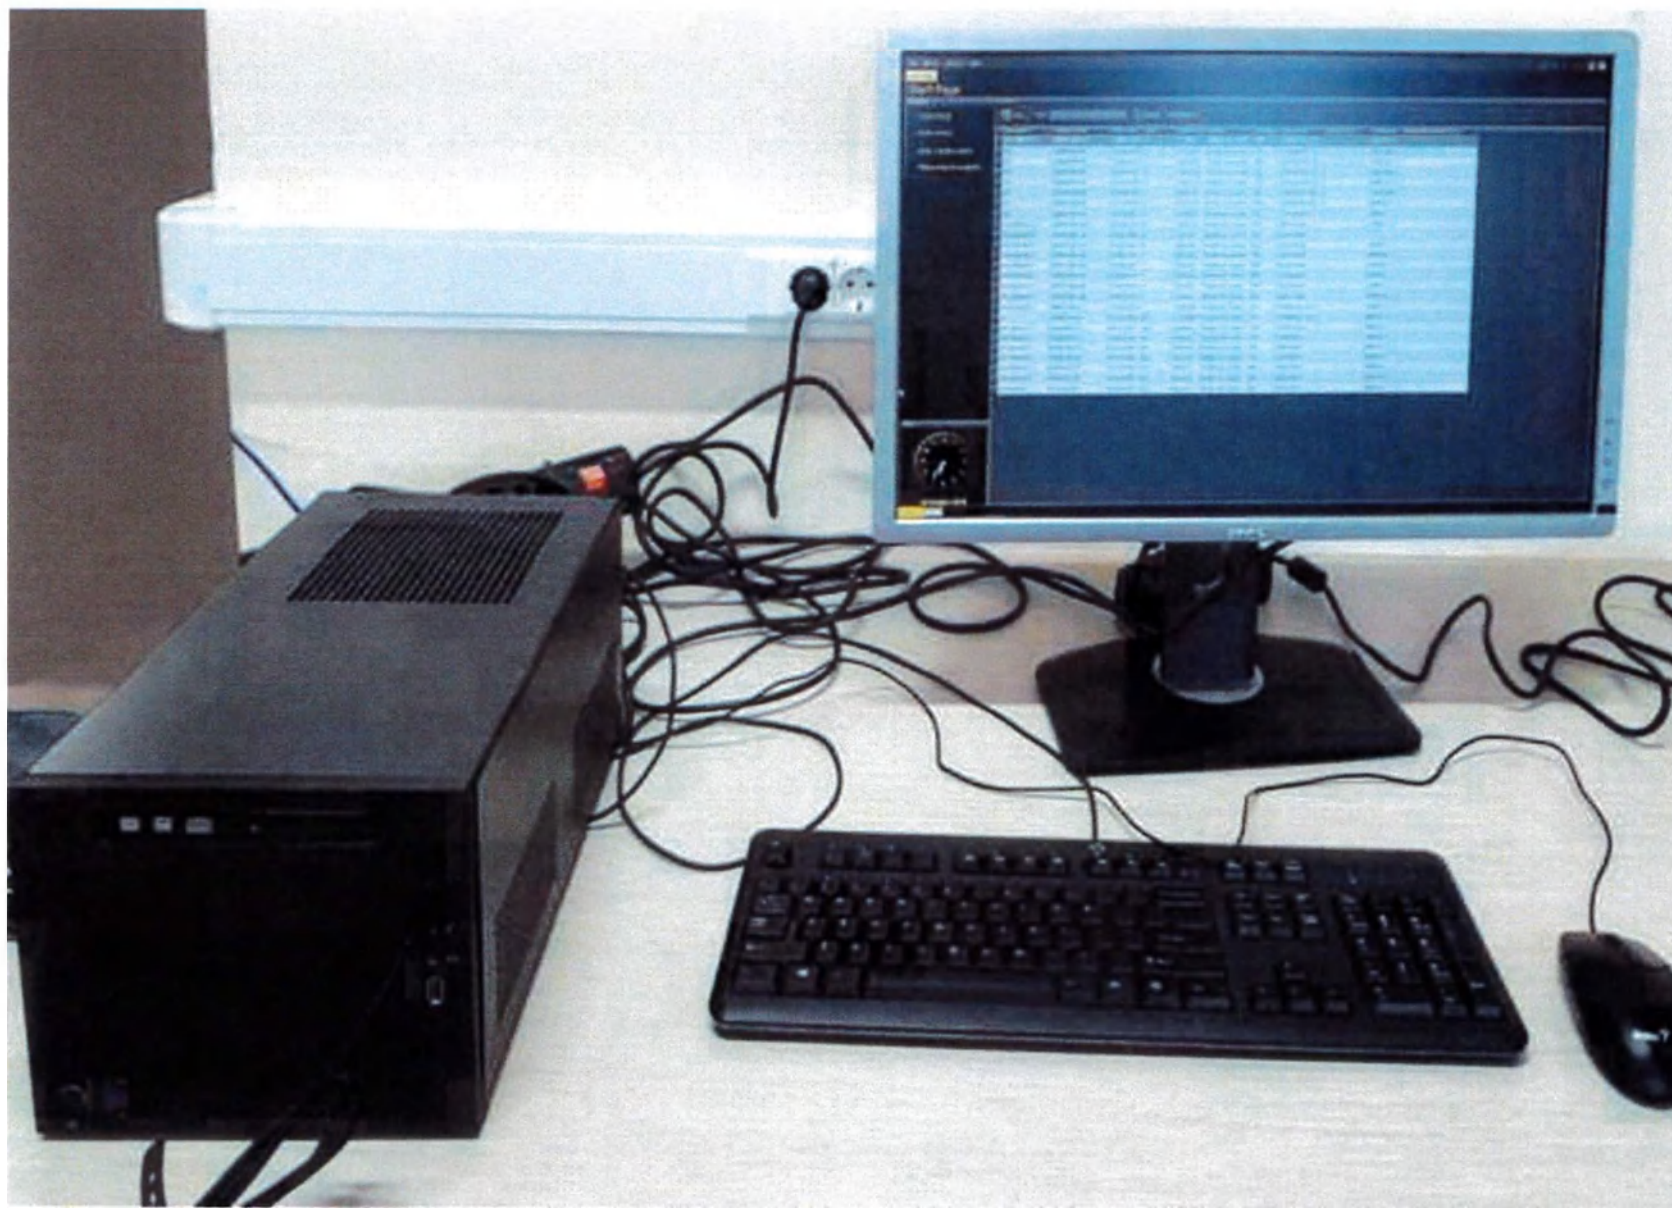

- или Комплекс программный для получения, обработки, передачи и архивирования цифровых медицинских рентгеновских изображений «ДИАРМ-5МТ» по ТУ 9442-032-47245915-2010:



- или DSSD



- или Комплекс аппаратно-программный для регистрации и обработки рентгеновских изображений «СОЛО ДР-МТ» по ТУ 26.60.11-059-47245915-2017 в исполнениях: - «СОЛО ДР-МТ»-1.1; - «СОЛО ДР-МТ»-1.2; -«СОЛО ДР-МТ»-1.3; «СОЛО ДР-МТ»-2.1; - «СОЛО ДР-МТ»-2.2; «СОЛО ДР-МТ»-2.3.



- или Комплекс аппаратно-программный для регистрации и обработки рентгеновских изображений «СОЛО ДТ-МТ» по ТУ 26.60.11-060-47245915-2018:



- или Система медицинской визуализации цифровая "PrestoDR", с принадлежностями:



- или Система получения, обработки и архивирования цифровых рентгеновских изображений под торговой маркой Millennium® по ТУ 9452-004-68428554-2012



- или Программный комплекс автоматизированной обработки и архивирования медицинских изображений и данных под торговой маркой Millennium® по ТУ 9442-005-68428554-2012



Millennium

Паритет - Рентген

Комплекс программный
автоматизированной обработки и
архивирования медицинских изображений
и данных под торговой маркой
«Millennium»



Все права защищены © 2015 ООО «Паритет-Рентген»

1.16 Монитор высокого разрешения (при необходимости):
- WIDE



103

- или BEACON:



- или LCD-монитор медицинский с принадлежностями



105

- или Монитор для медицинской визуализации под торговой маркой Millennium с принадлежностями




DC-IN

LCD Monitor **Millennium®** CE


Model: G22SP

Input: 12V $\pm$ 0.07A

S/N: 
G22SPA15490004

 CAUTION: High voltage in the monitor, only a qualified can open it!

SHENZHEN BEACON DISPLAY TECHNOLOGY CO.,LTD
Manufactured in China


ML2010*BAJFNSC4

1.17 Рентгенопрозрачный стол-каталка (при необходимости).

- Стол-каталка СК в исполнениях СК и СК-Е:



1.18 Рентгенозащитная ширма (при необходимости).

- Ширмы рентгенозащитные по ТУ 9452-010-46782692-2001;
- или Ширмы рентгенозащитные цельнометаллические свинцовые по ТУ 9452-009-17459079-2002;
- или Ширмы рентгенозащитные передвижные ШР "Щит" по ТУ 9452-002-63179980-2012:



1.19 Крепление детское универсальное (при необходимости).
- Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010:



- или Устройство для укладки детей УУД:



144


- или Устройство для рентгеновских исследований детей РЕНЕКС УРИД-1:




- или Люлька детская двойного поворота передвижная для полипозиционных исследований ЛДДП-1 по ТУ 9442-027-11396834-2006




1.20 Негатоскоп (при необходимости).
- Негатоскоп "ИКСВЬЮ" по ТУ 9441-023-74487176-2011:

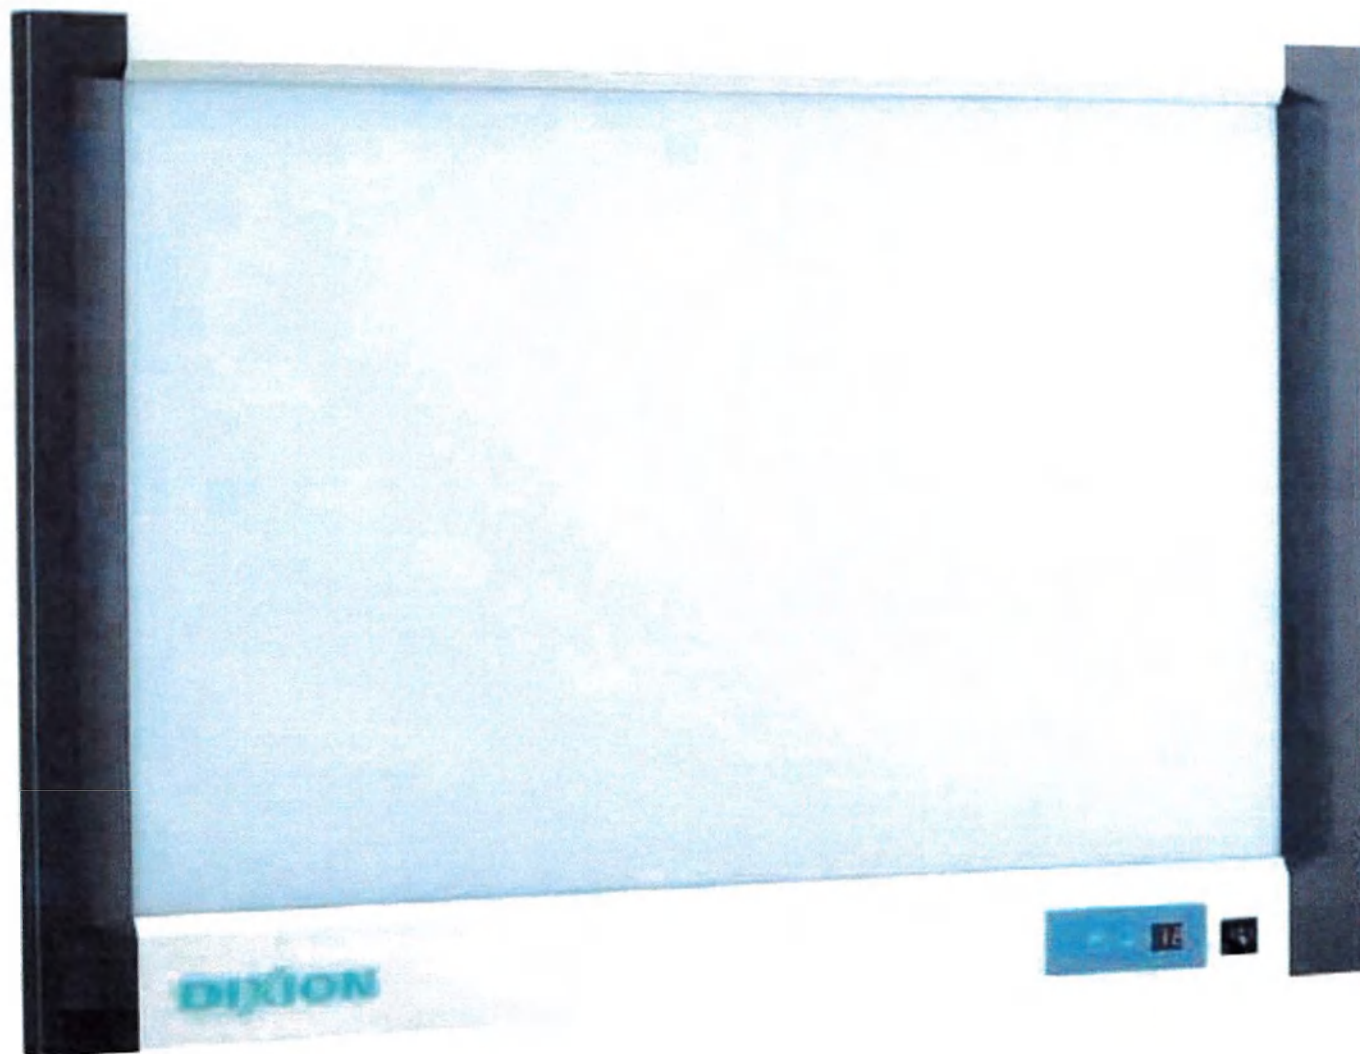

- или Негатоскопы "РЕНЕКС НЦП-1", "РЕНЕКС НЦП-2", "РЕНЕКС НЦП-4" по ТУ 9442-008-01416381-2002:

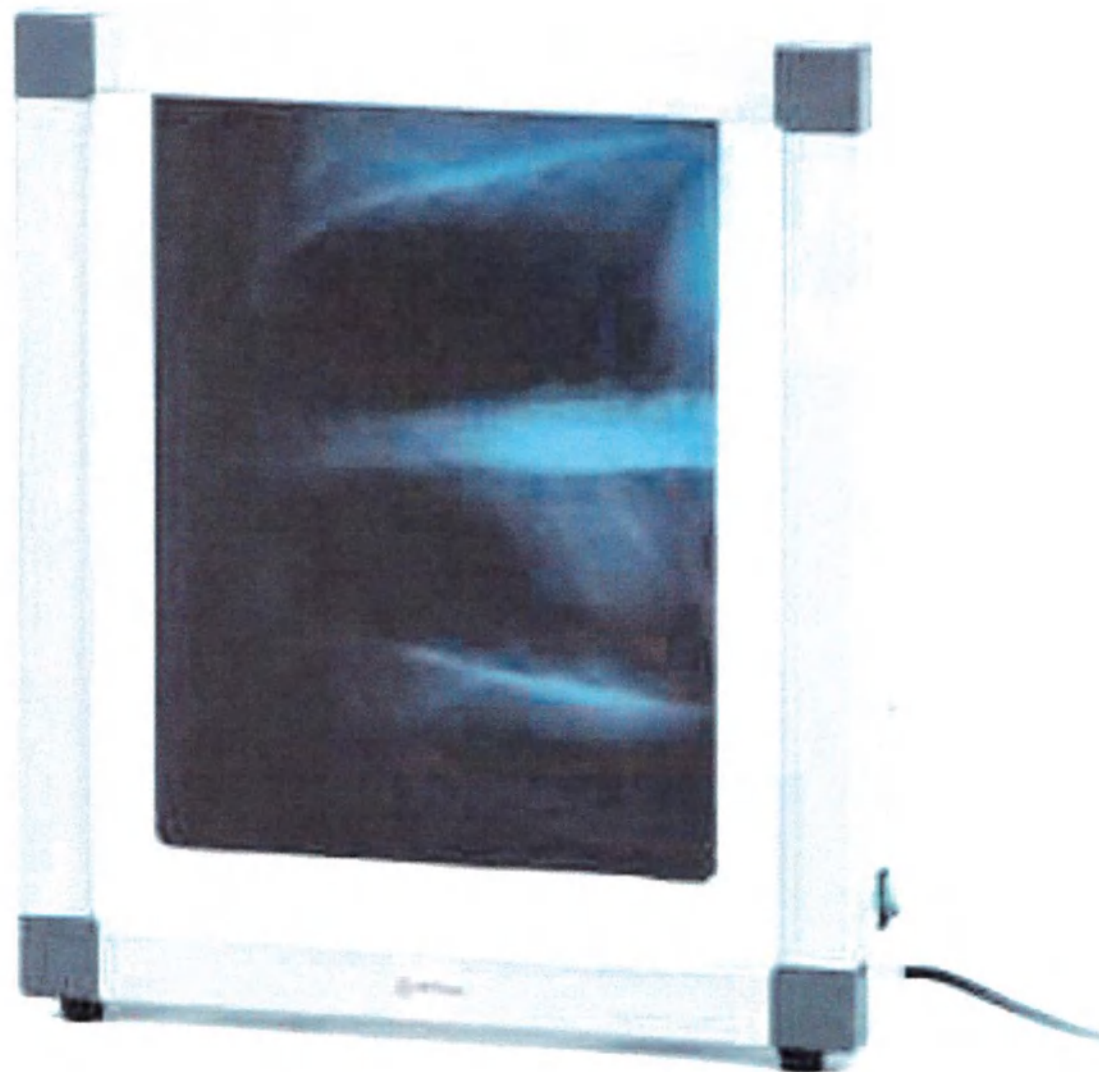


- или Негатоскопы общего назначения НР-"ПОНИ" по ТУ 9452-011-17459079-2011:

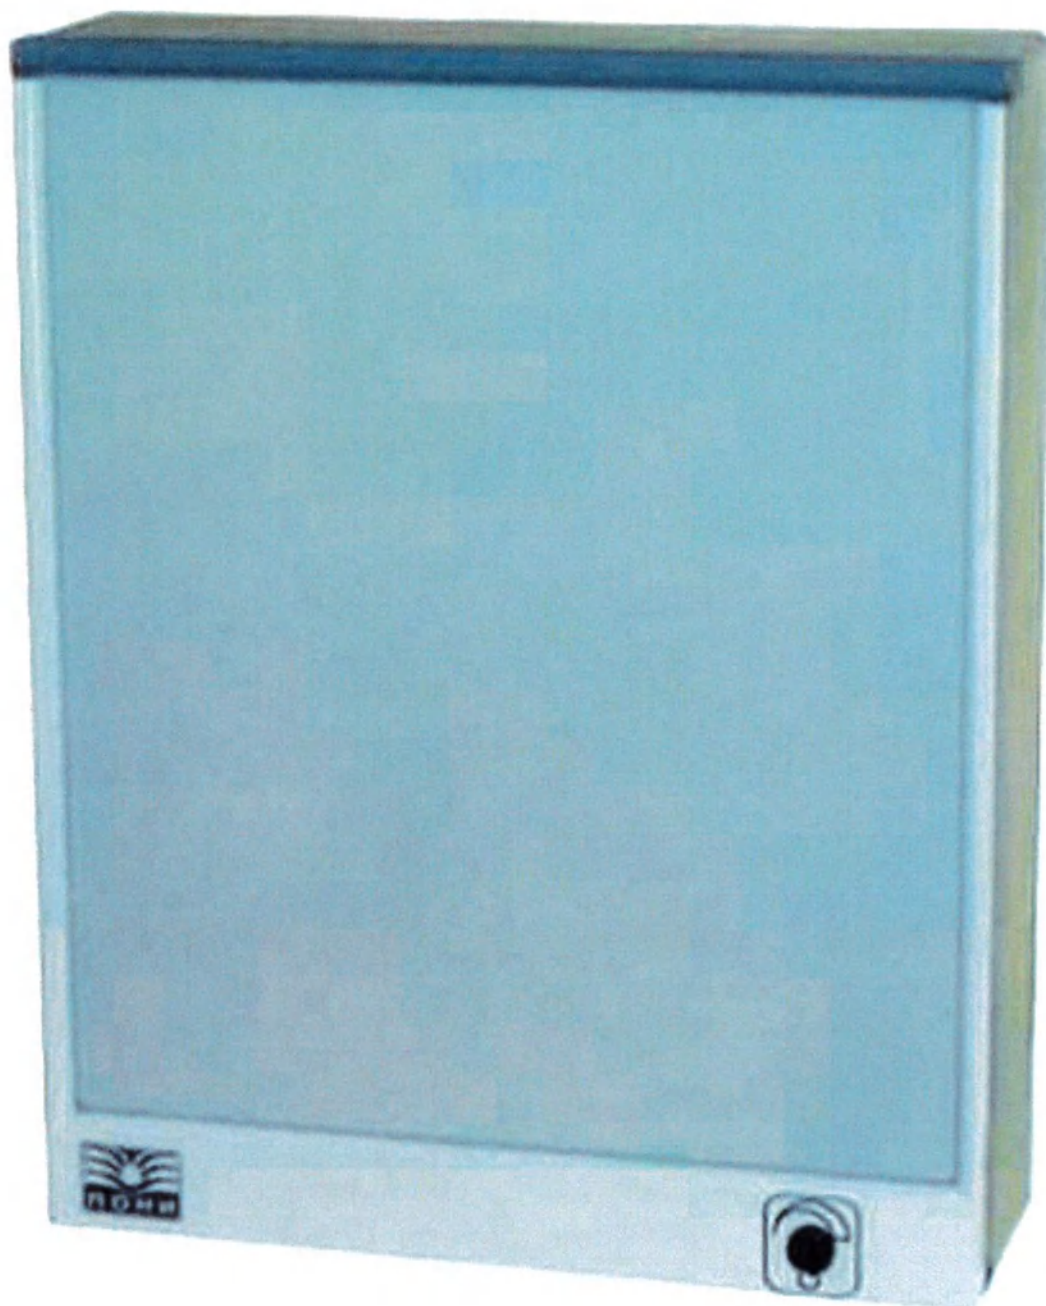


Принадлежности (при необходимости):

1. Комплект средств защиты от рентгеновского излучения:



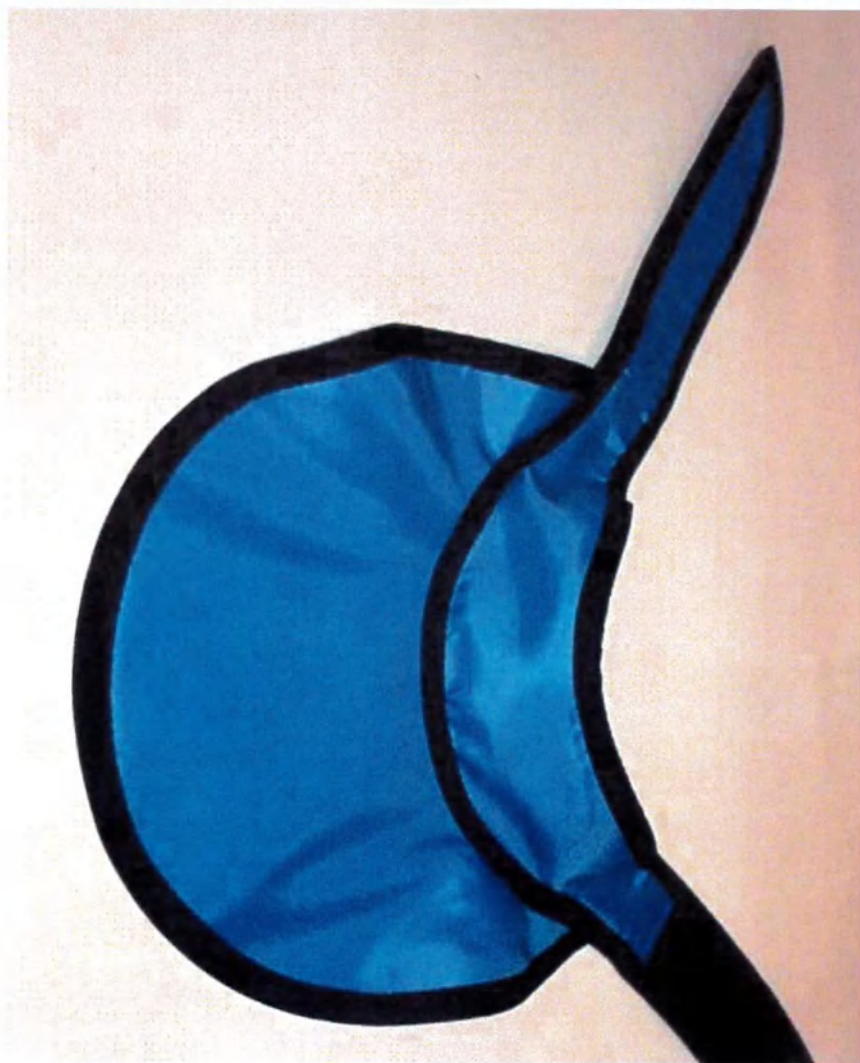


2. Комплект рентгеновских кассет

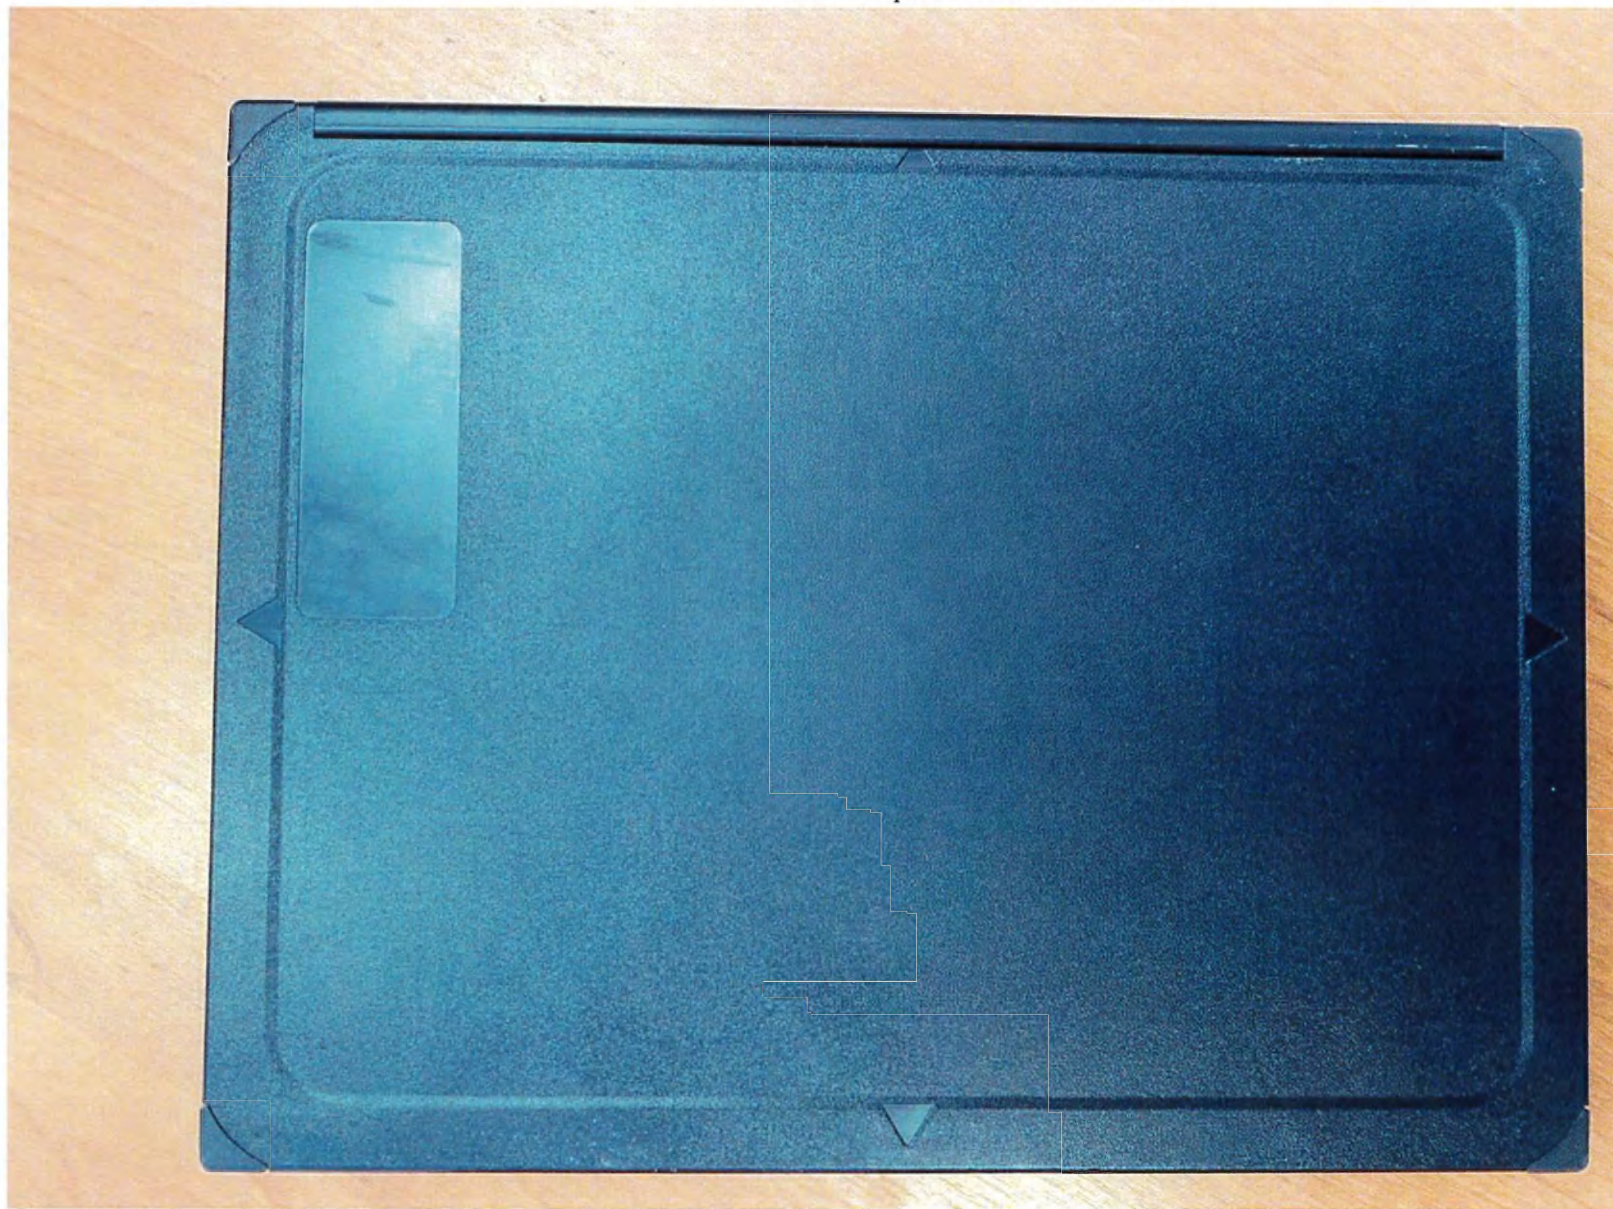



ВІРВІТІ СІМВОЛІ КОДІ 3.0

120

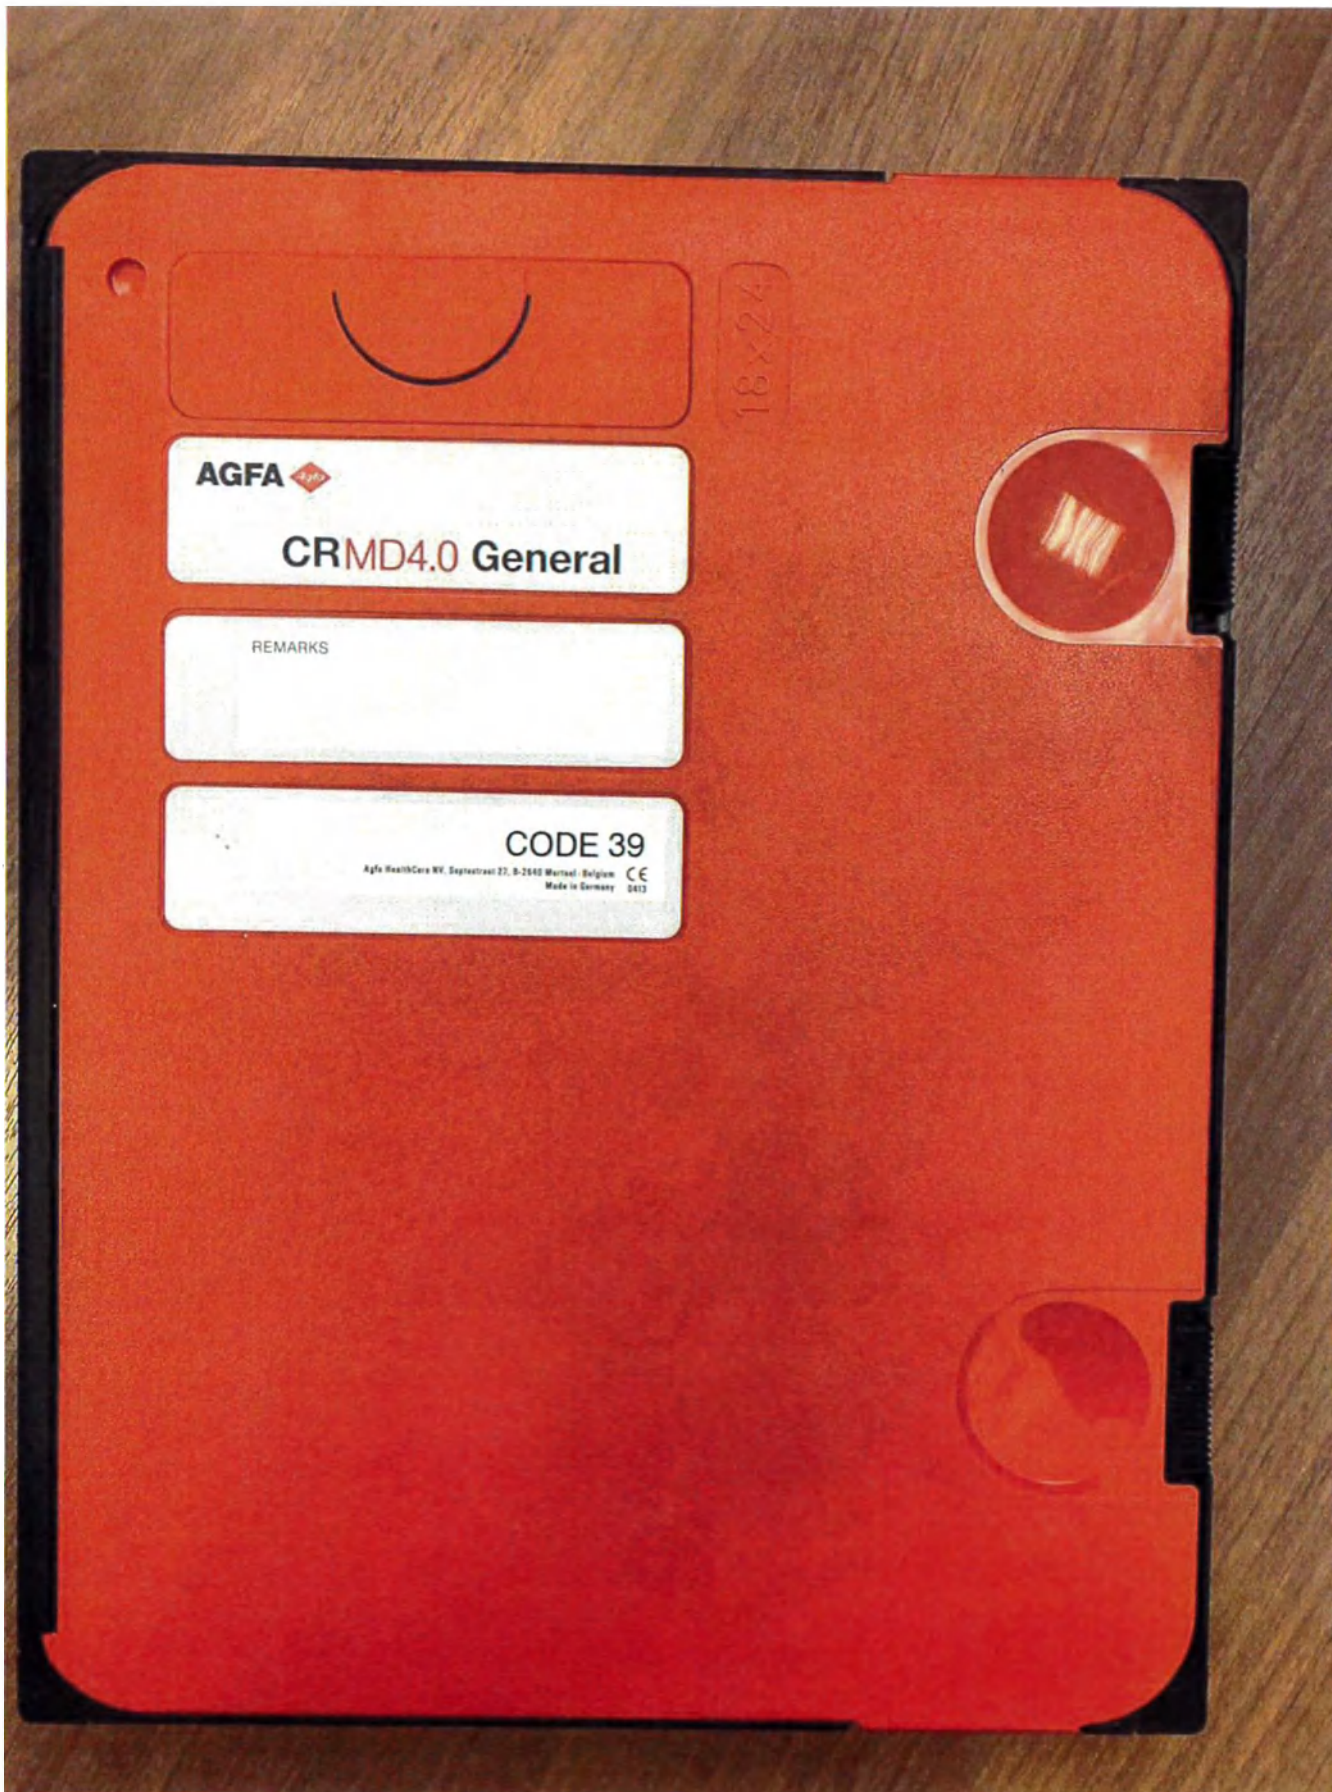

18x24

AGFA

CRMD4.0 General

REMARKS

CODE 39

Agfa HealthCare NV, Sognestraat 22, B-2640 Mortsel, Belgium
Made in Germany

CE
0413

12

3. Рентгенозащитное стекло/окно:



4. Табло «НЕ ВХОДИТЬ»:




5. Переговорное устройство двухстороннее (лаборант-пациент):



6. Система видеонаблюдения для процедурной:




7. Подножка для пациента для снимков плоскостопия

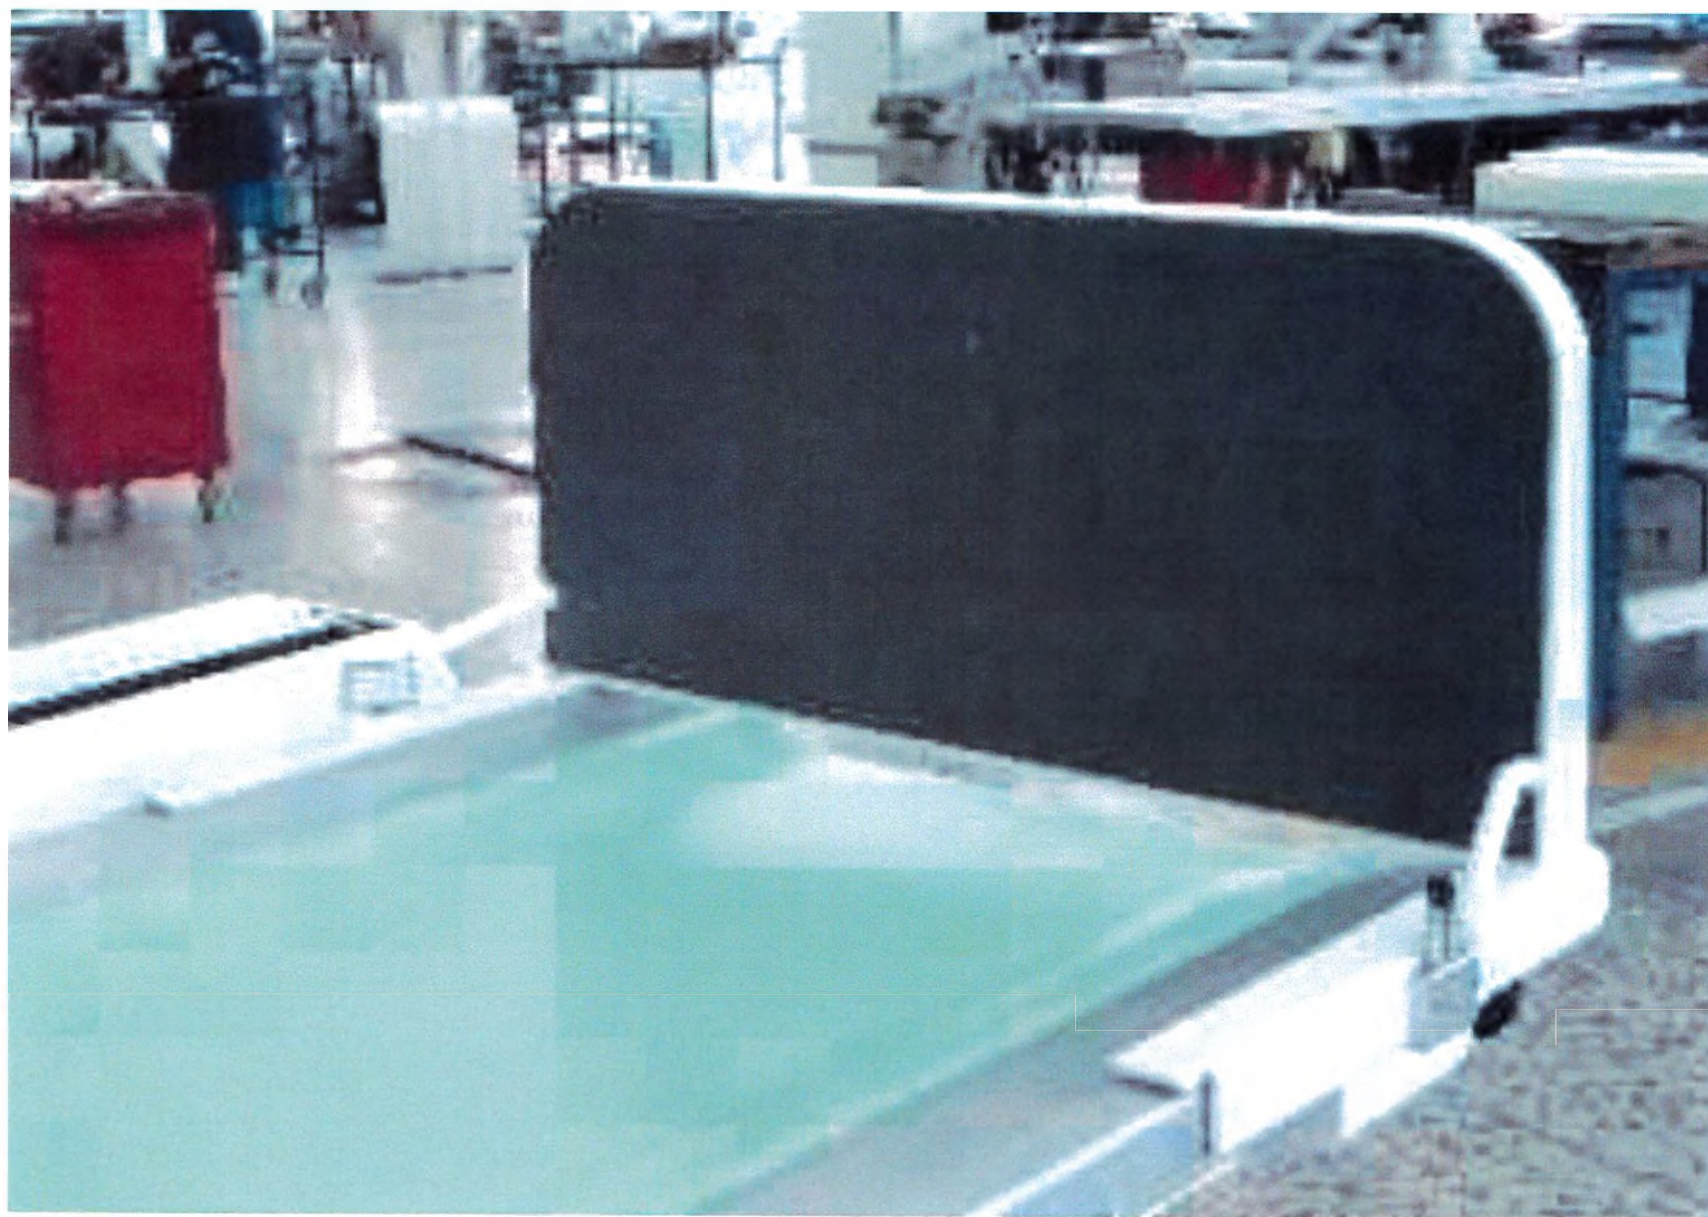

8. Климатическая установка:




9. Опоры под плечи:

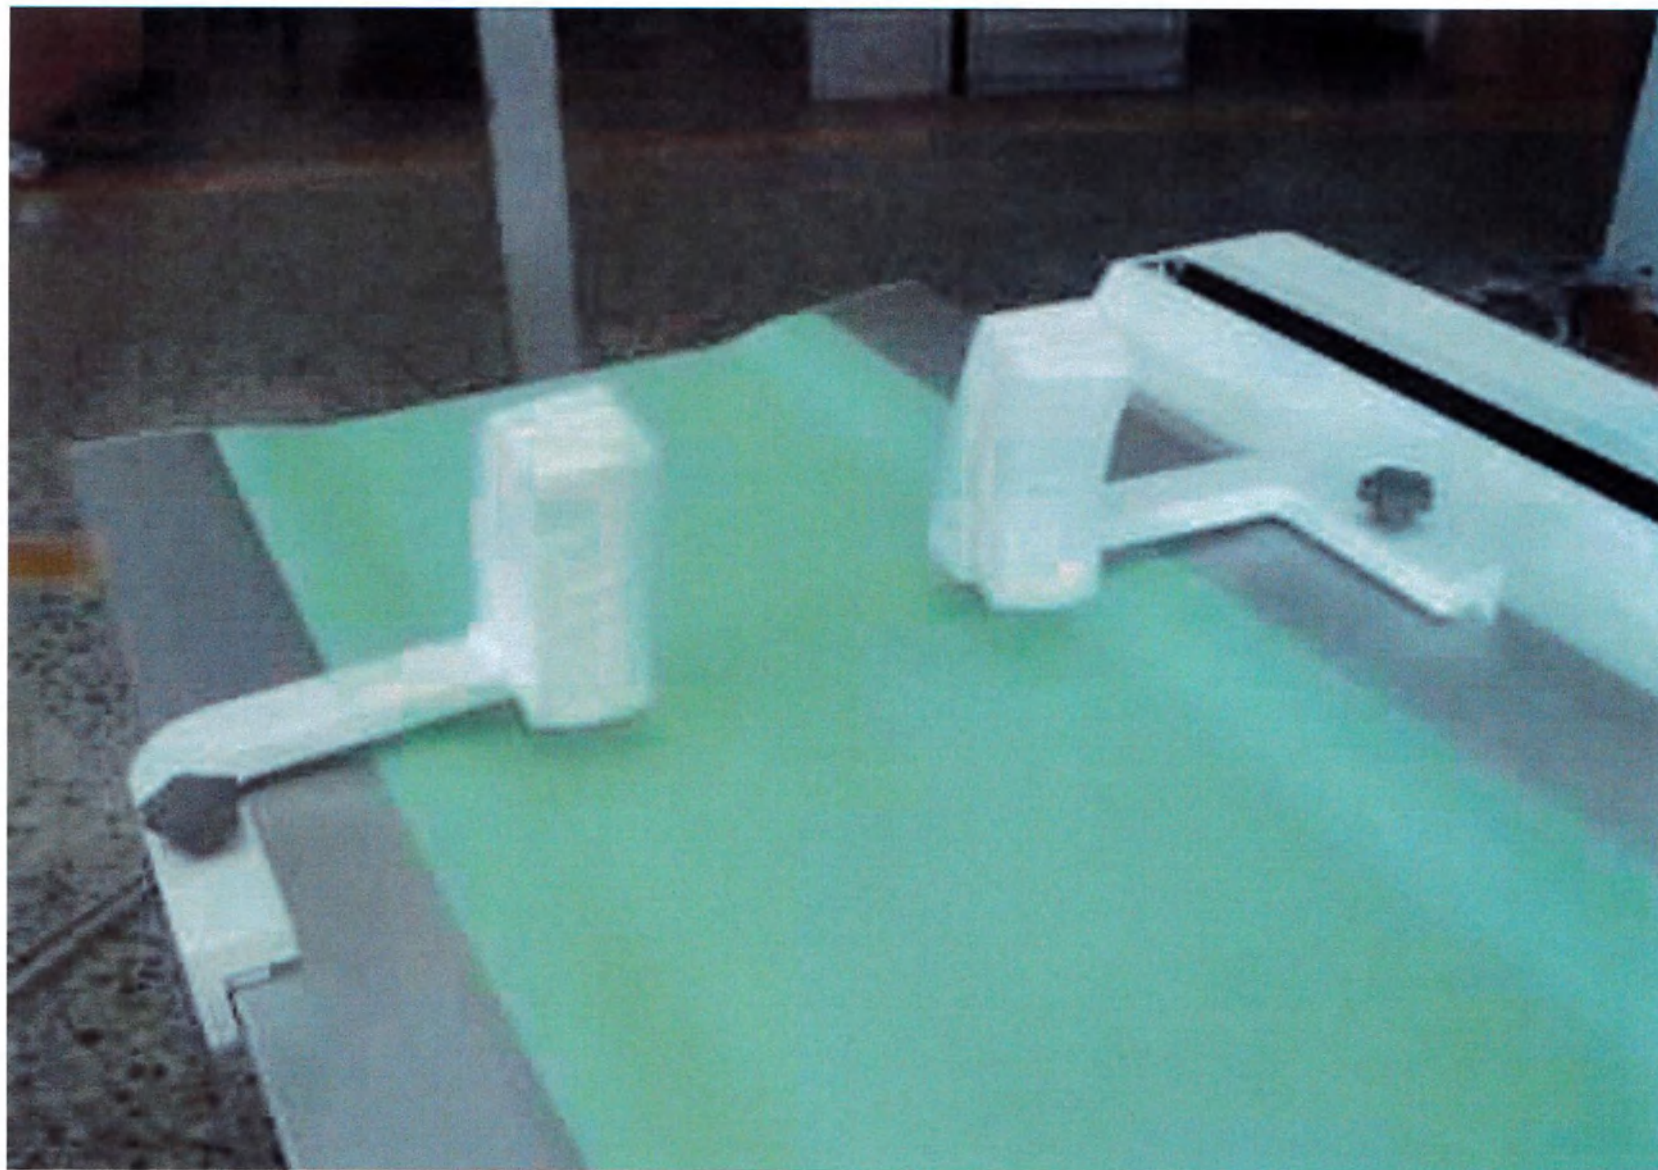

10. Упоры под колени



11. Компрессионный пояс:

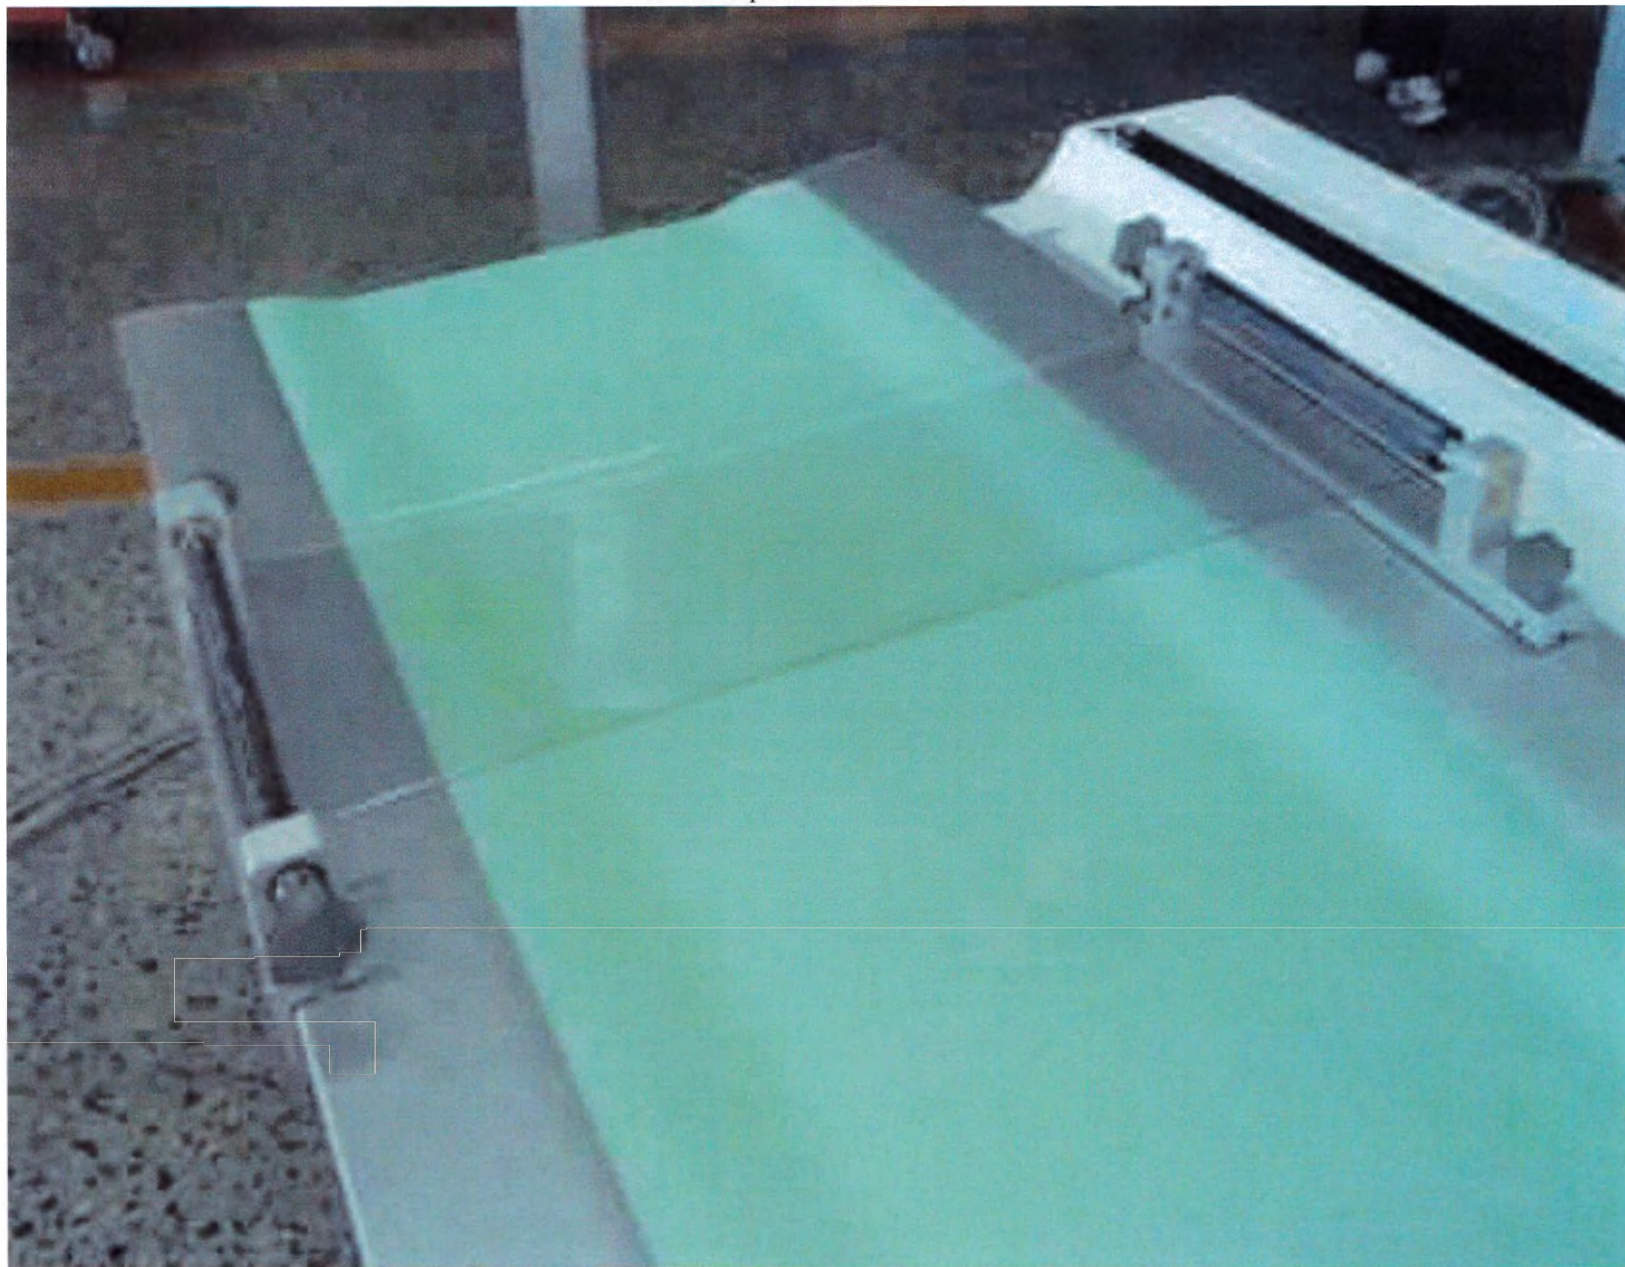


12. Ступенька для пациента



13. Блоки дверные



14. Держатель кассет для съемки в латеральной позиции

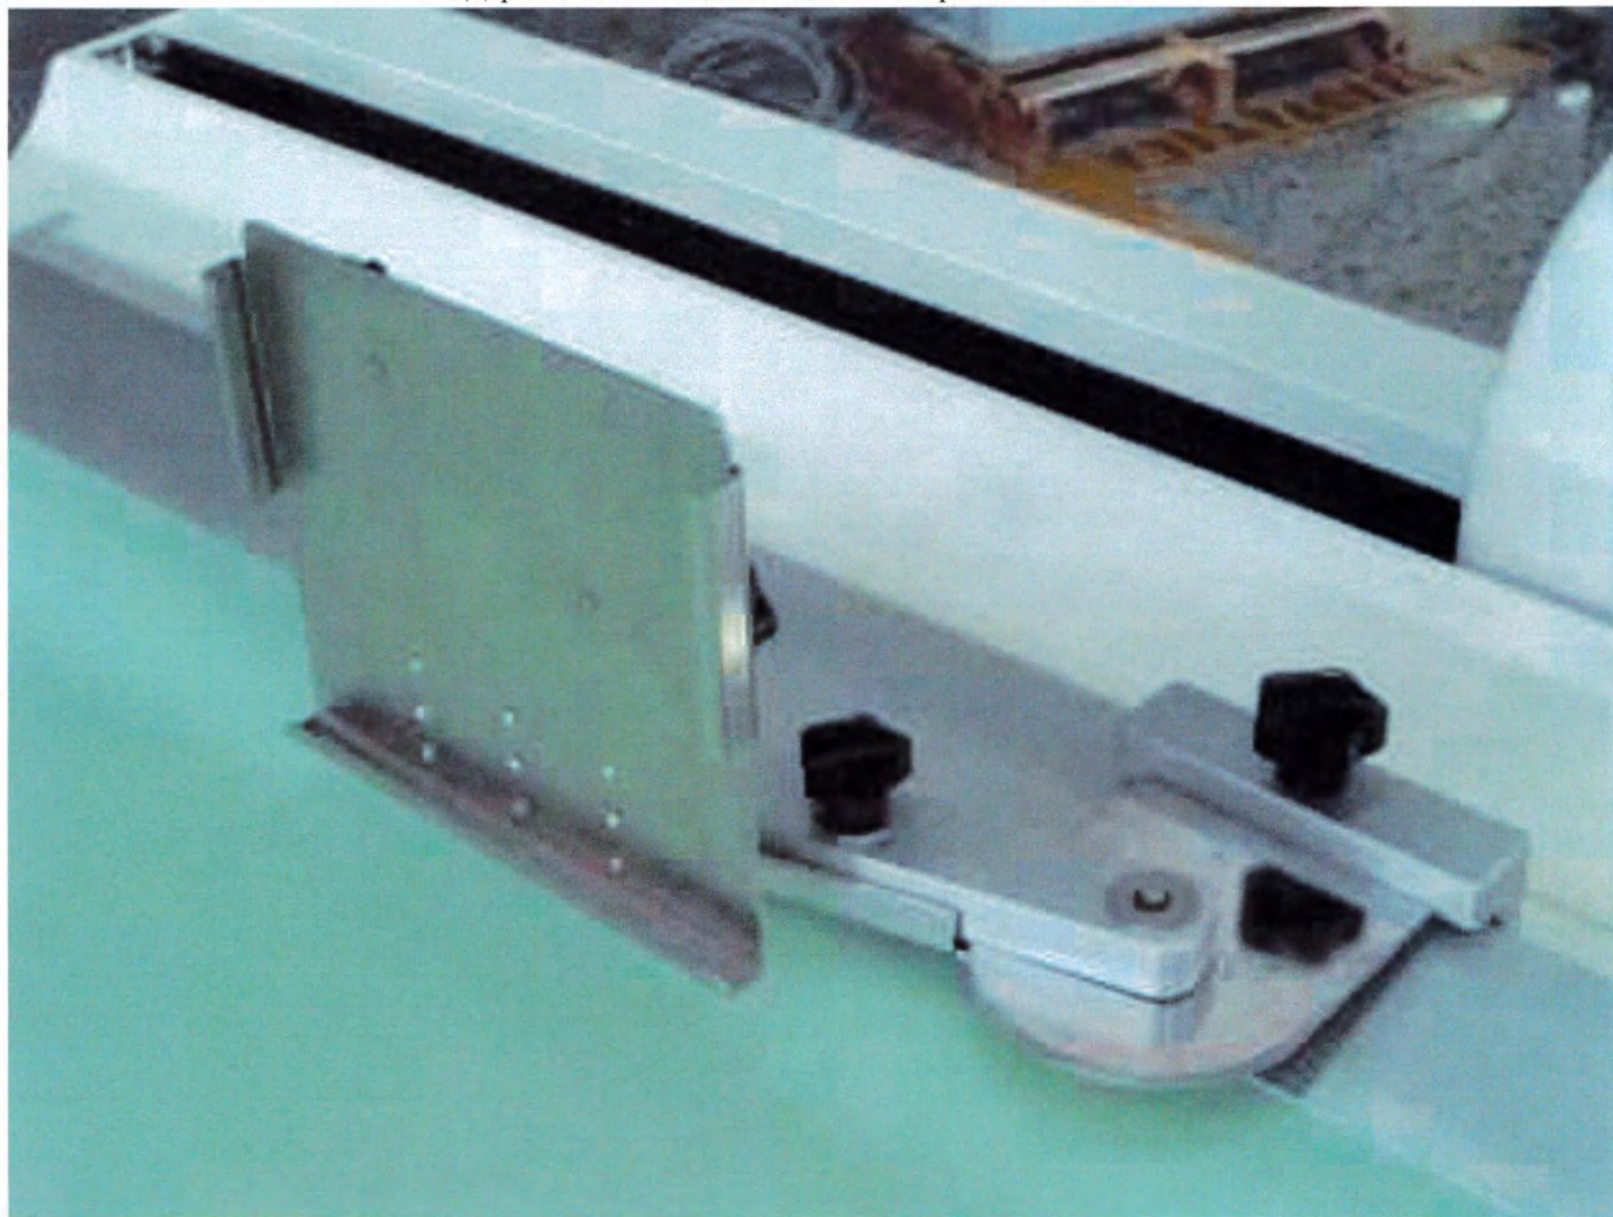

15. Источник бесперебойного питания (однофазный, трехфазный):



16. Системный блок (персональный компьютер):



17. Ноутбук




18. Моноблок



19. Сервер-архивы




20. Клавиатура

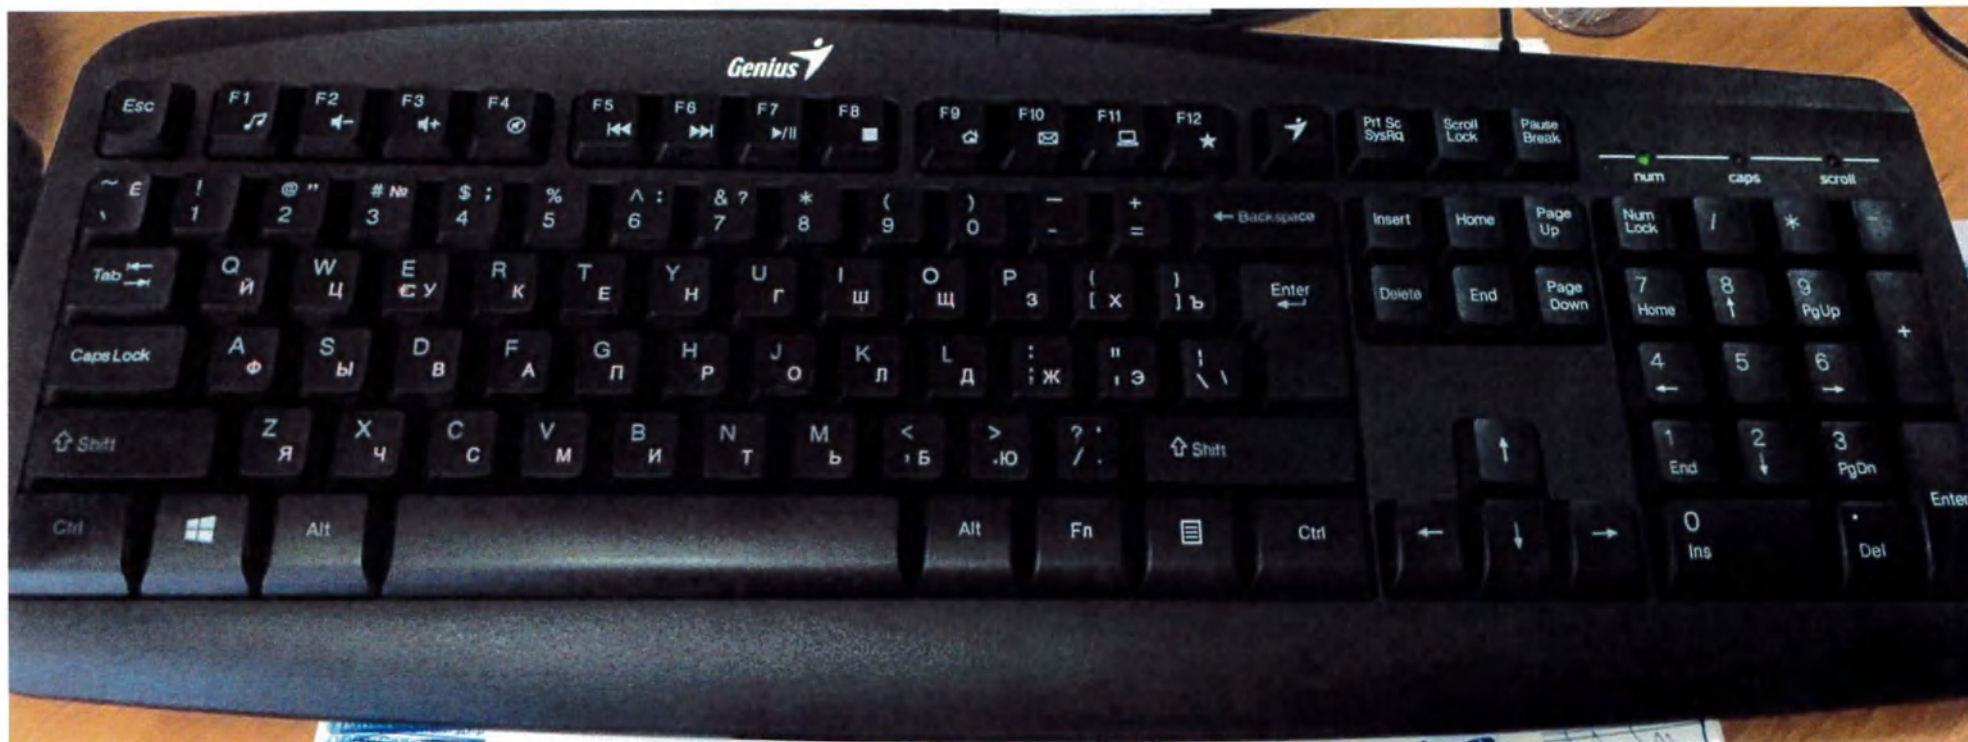

21. Мышь компьютерная



22. Монитор для персонального компьютера:

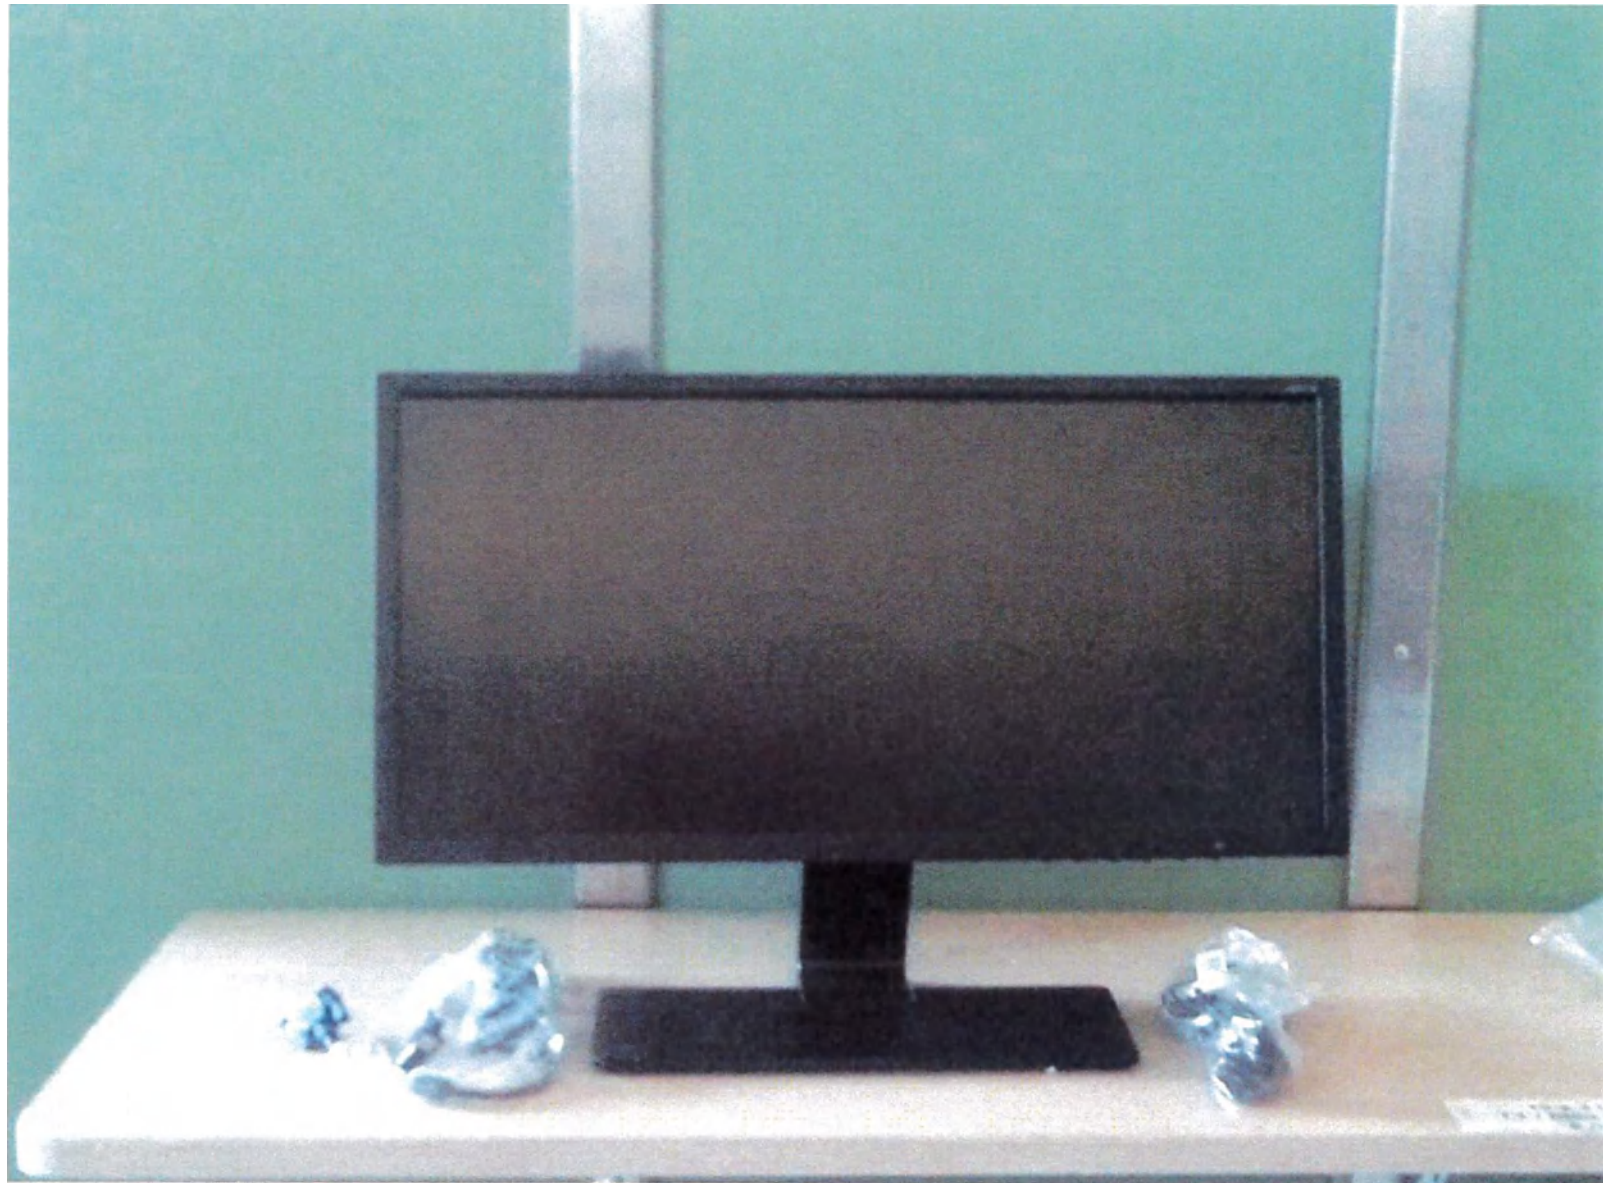



23. Стабилизатор напряжения (однофазный, трехфазный):

24/

24. Принтеры лазерные



25. Сетевой коммутатор




26. Маршрутизаторы




27. Комплект высоковольтных кабелей:



28. Щит электрический распределительный:

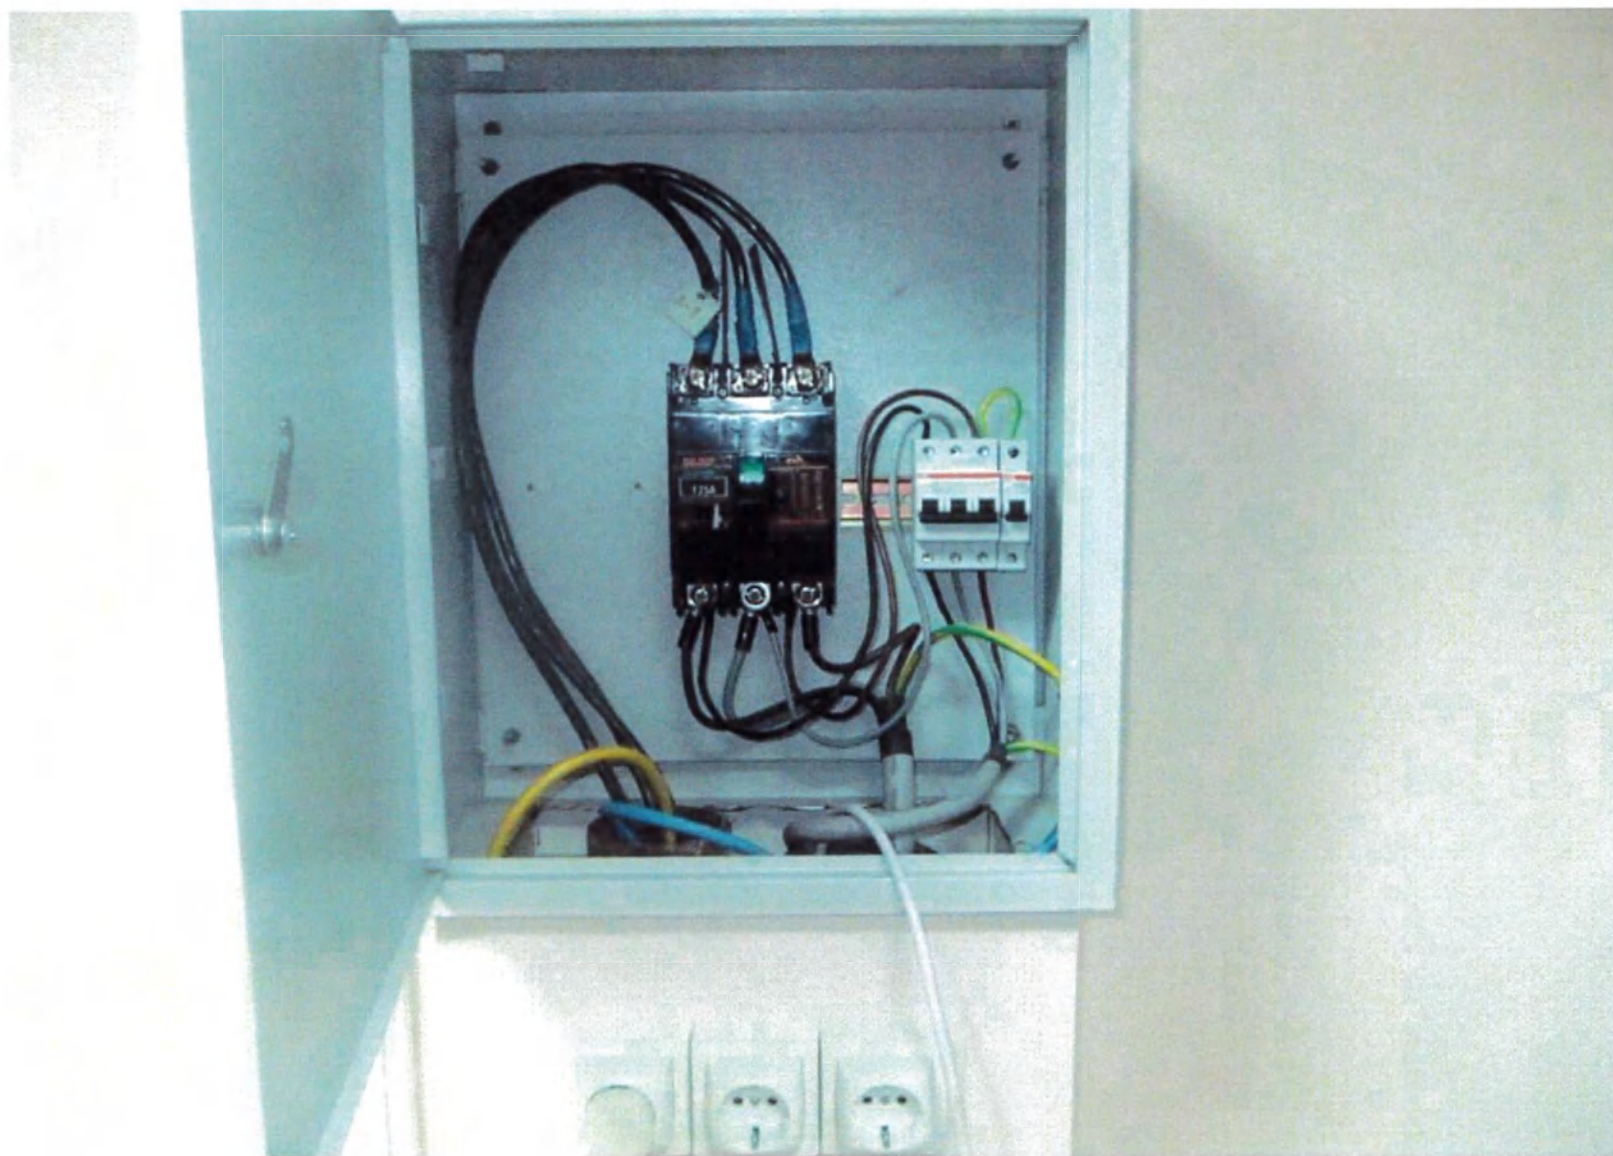

29. Монтажный комплект кабелей:

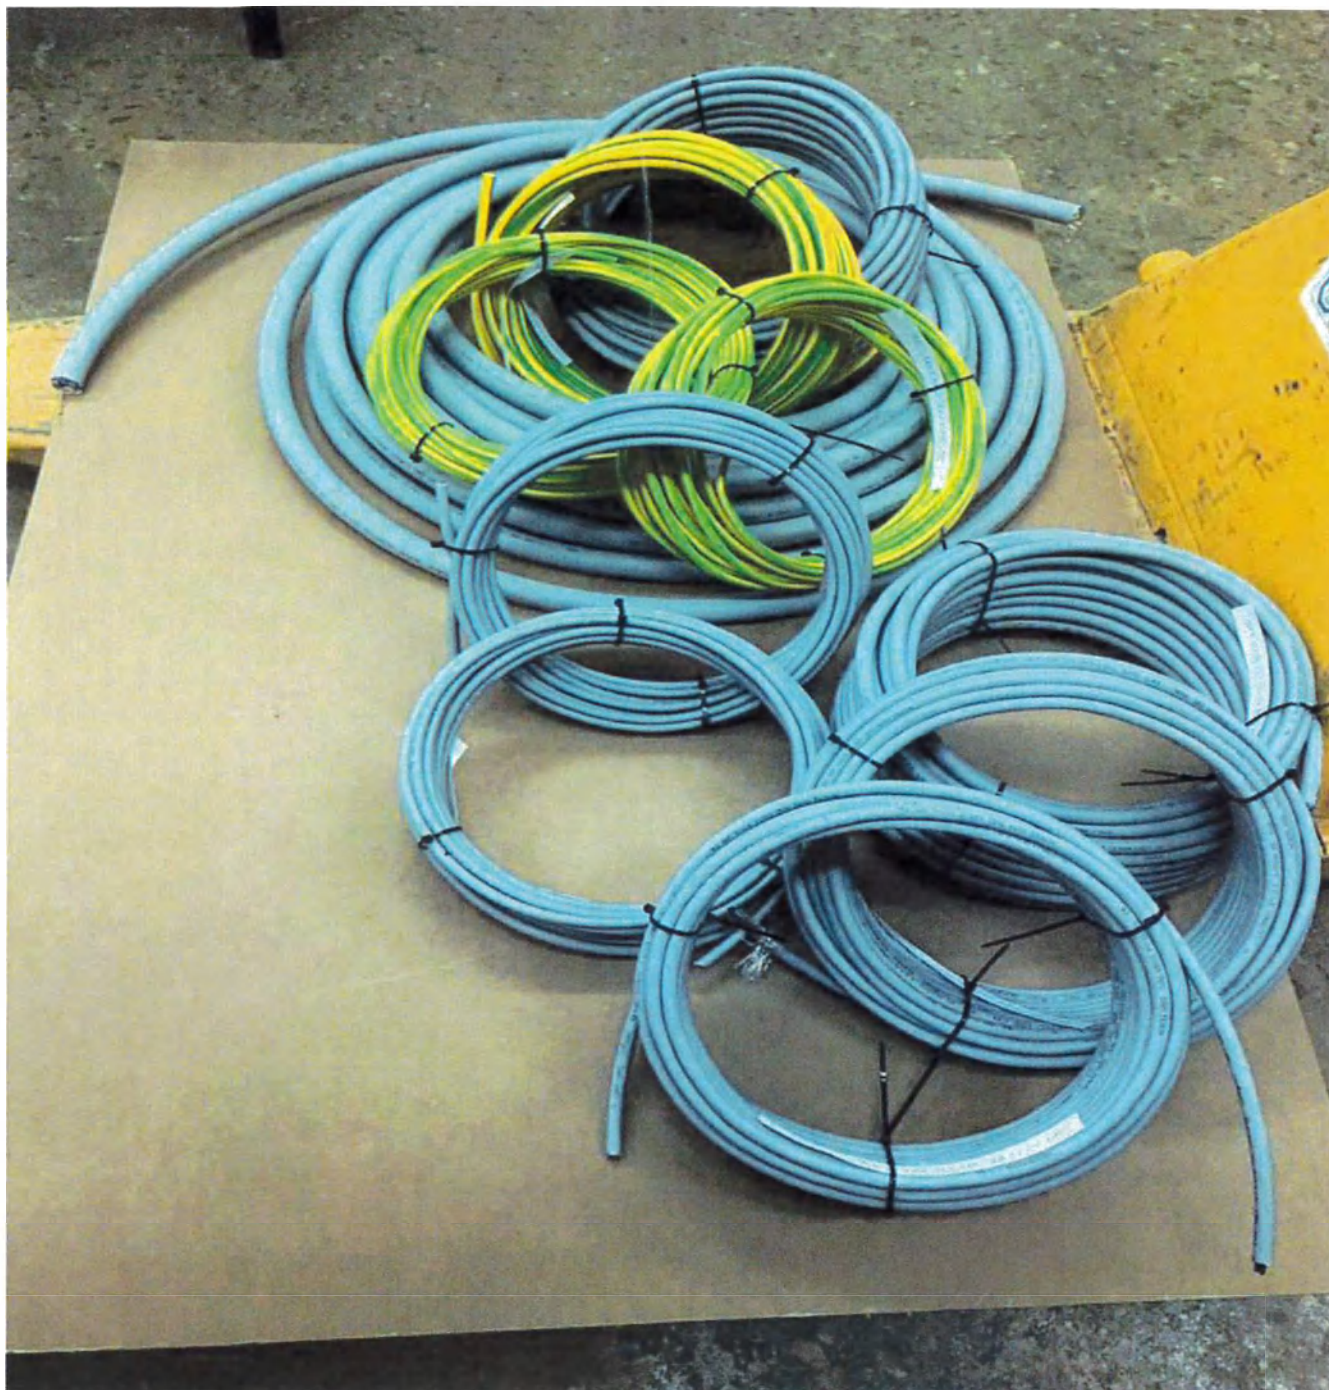

147

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
148 (Сто сорок восемь) листов

Генеральный директор
ООО «Паритет-Рентген»



А.Б. Лукьянов