

ООО «Дентсплай Сирона»

Левин К.Г.

«11» декабря 2021 г.

ДИРЕКТОР
ПО РЕГИСТРАЦИИ,
СНГ
ХАЙНДРАВА В.Г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/21 ОТ 01.10.2021

Наборы NEO Spectra ST для реставрации передних и боковых зубов в вариантах исполнения



Фото 1 – Набор NEO Spectra ST LV Intro Kit в шприцах (Общий вид)



Фото 2 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: A1



Фото 3 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: A2



Фото 4 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: A3



Фото 5 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: A3,5



Фото 6 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: A4



Фото 7 – Палетка пластиковая для смешивания CliXdish



Фото 8 – Аппликаторы



Фото 9 – Адгезив Prime & Bond® universal во флаконе 2.5 мл



Фото 10 – Маркировка i-Shade, Инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде - 2 шт, Вкладыш информационный

Набор NEO Spectra ST LV Intro Kit в шприцах

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН ####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.

 Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-ТреЙ-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 11 – Макет маркировки «Набор NEO Spectra ST LV Intro Kit в шприцах»



Фото 12 – Набор NEO Spectra ST LV Eco Kit в шприцах (общий вид)



Фото 13 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: A2



Фото 14 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: A3



Фото 15 – Палетка пластиковая для смешивания CliXdish



Фото 16 – Аппликаторы



Фото 17 – Адгезив Prime & Bond® universal во флаконе 2.5 мл



Фото 18 – Маркировка i-Shade, Инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде - 2 шт, Вкладыш информационный

Набор NEO Spectra ST LV Eco Kit в шприцах

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.

 Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-Тре-й-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 19 – Макет маркировки «Набор NEO Spectra ST LV Eco Kit в шприцах»

Фото 20 - Набор NEO Spectra ST HV Intro Kit в шприцах (Общий вид)

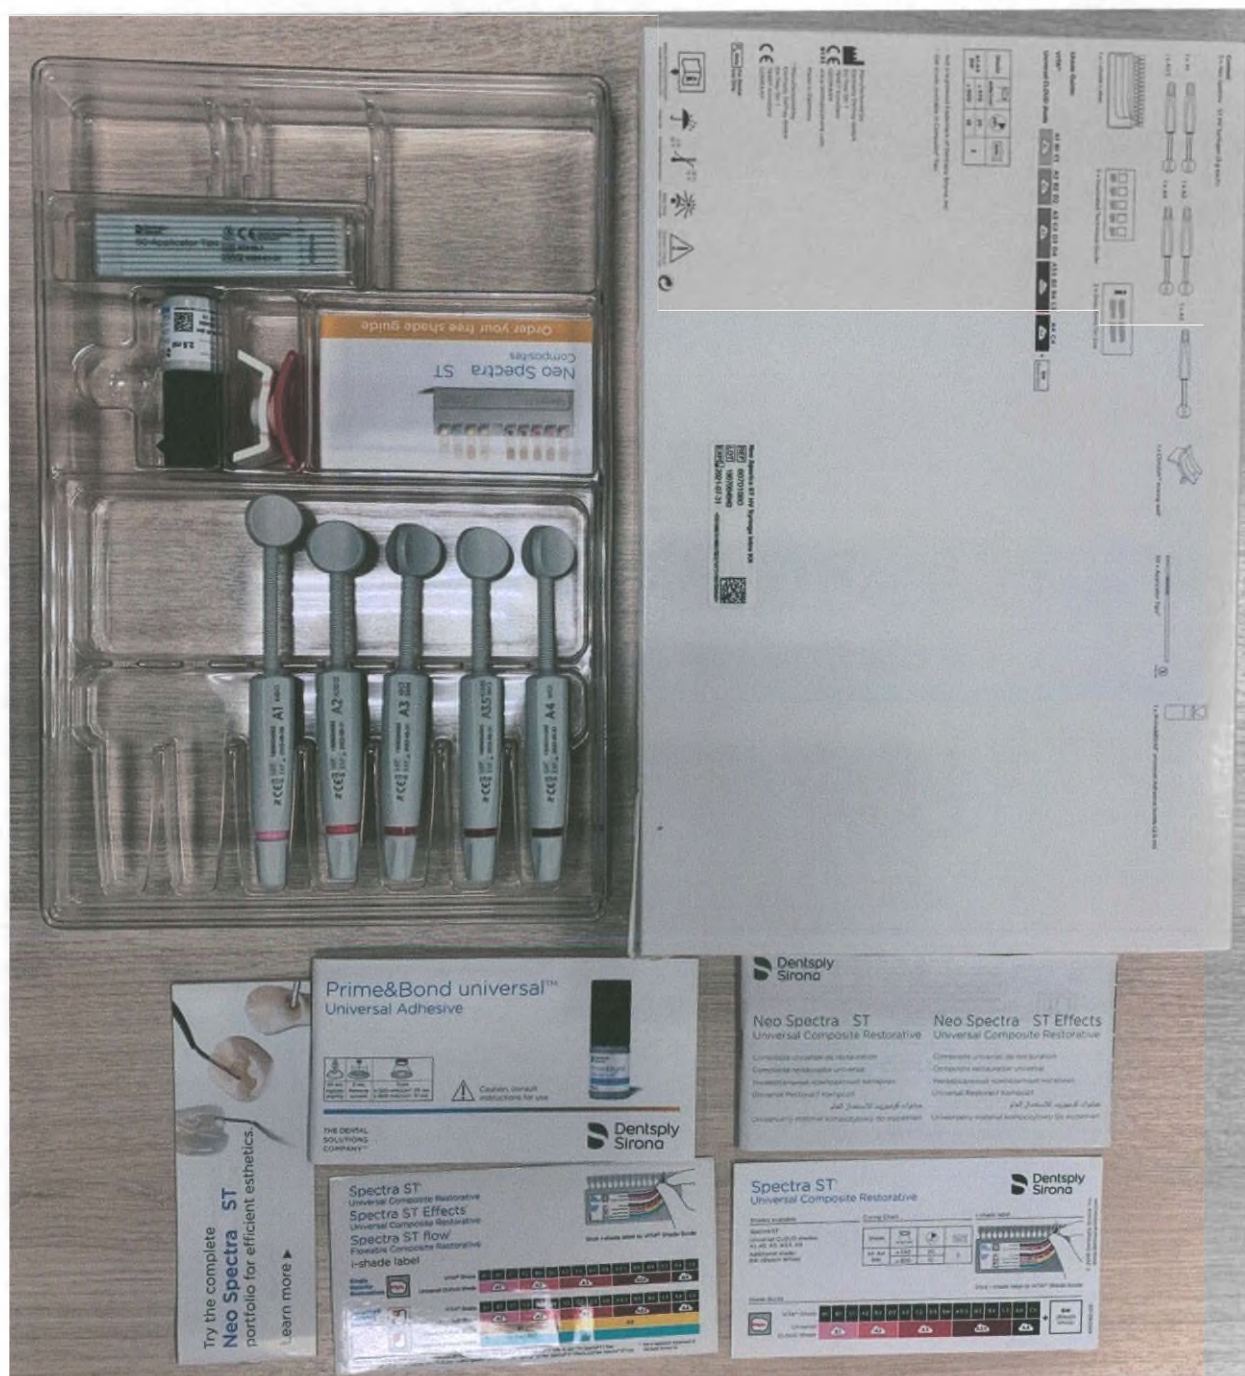




Фото 21 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: A1



Фото 22 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: A2



Фото 23 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: A3



Фото 24 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: A3,5



Фото 25 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: A4



Фото 26 – Палетка пластиковая для смешивания CliXdish



Фото 27 – Аппликаторы



Фото 28 – Адгезив Prime & Bond® universal во флаконе 2.5 мл



Фото 29 – Форма заказа расцветки NEO Spectra ST Shade Guide



Фото 30 – Иллюстрированное техническое руководство, Маркировка i-Shade, Инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде - 2 шт., Вкладыш информационный

Набор NEO Spectra ST HV Intro Kit в шприцах

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.



Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-Трей-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:
ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 31 – Макет маркировки набора NEO Spectra ST HV Intro Kit в шприцах



Фото 32 – Набор NEO Spectra ST HV Eco Kit в шприцах (Общий вид)



Фото 33 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: A2



Фото 34 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: A3



Фото 35 – Палетка пластиковая для смешивания CliXdish



Фото 36 – Аппликаторы



Фото 37 – Адгезив Prime & Bond® universal во флаконе 2.5 мл



Фото 38 – Форма заказа расцветки NEO Spectra ST Shade Guide



Фото 41 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: D1



Фото 42 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: D3



Фото 43 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: E1



Фото 44 – Маркировка i-Shade, Инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде, Иллюстрированное техническое руководство



Фото 45 – Индивидуальная упаковка материала стоматологического NEO Spectra ST Effects (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: D3, D1, E1

Набор NEO Spectra ST Effects Intro Kit в шприцах

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН ##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.

 Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-Тре-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 46 – Макет маркировки «Набор NEO Spectra ST Effects Intro Kit в шприцах»



Фото 47 – Набор NEO Spectra ST Intro Kit LV в компьютерных (Общий вид)



Фото 48 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A1



Фото 49 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A2



Фото 50 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A3



Фото 51 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A3,5



Фото 52 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A4



Фото 53 – Пистолет для компьют (Compules® Tips Gun)



Фото 54 – Палетка пластиковая для смешивания CliXdish



Фото 55 – Аппликаторы



Фото 56 – Адгезив Prime & Bond® universal во флаконе 2.5 мл



Фото 57 – Индивидуальная упаковка материала стоматологического NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A1, A2, A3, A3,5, A4



Фото 58 – Форма заказа расцветки NEO Spectra ST Shade Guide



Фото 59 – Иллюстрированное техническое руководство, Маркировка i-Shade, Инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде - 2 шт., Вкладыш информационный

Набор NEO Spectra ST Intro Kit LV в компьютерных

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.



■ Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-Тре-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 60 – Макет маркировки «Набор NEO Spectra ST Intro Kit LV в компьютерных »

Manufactured by
Dentsply DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY
CE 0123 www.dentsplysirona.com

Neo Spectra ST LV - Sample

Contents:
CompuLes® Tips (0.25 g each)
4 x LV (Low Viscosity) CompuLes® Tips, Shade A2
1 x Directions for Use
1 x Illustrated Technique Guide

Reorder 607.01.879

REF 60701879

LOT 1909000754 EXPI 2022-05-31

+0010607018791/5322053119090007545

Shade	mW/cm²	sec	mm
A1-A4	≥ 550	20	2
BW	≥ 800	10	2

Rx Only
For Dental Use Only



www.dentsplysirona.com
www.dentalsolutions.com



Storage Temperature
2°C to 30°C



Keep Dry



Keep Away From Sunlight



Caution, consult
directions for use



Made in Germany

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Dentsply
Sirona

Spectra ST¹ Universal Composite Restorative

Dentsply
Sirona

Shades available

Spectra ST
Universal CLOUD shades:
A1, A2, A3, A3.5, A4
Additional shade:
BW (Bleach White)

Curing Chart

Shade	mW/cm²	sec	mm
A1-A4	≥ 550	20	2
BW	≥ 800	10	2

i-shade label



Stick i-shade label to VITA® Shade Guide

Shade Guide

VITA® Shade	A1	B1	C1	A2	B2	D2	A3	C2	D3	D4	A3.5	B3	B4	C3	A4	C4	BW (Bleach White)
Universal CLOUD Shade	A1			A2			A3				A3.5				A4		

Dentsply
Sirona

Neo Spectra ST Universal Composite Restorative

Composite universel de restauration

Composite restaurador universal

Универсальный композитный материал

Universal Restauratif Kompozit

حشوات كومبوزيت للاستعمال العام

Uniwersalny materiał kompozytowy do wypełnień

Neo Spectra ST Effects Universal Composite Restorative

Composite universel de restauration

Composite restaurador universal

Универсальный композитный материал

Universal Restauratif Kompozit

حشوات كومبوزيت للاستعمال العام

Uniwersalny materiał kompozytowy do wypełnień



Фото 61 – Набор NEO Spectra ST Discovery Kit LV в компьютерных пакетах (общий вид)



Фото 62 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьютерных по 0.25 г, оттенок A2



Фото 63 – Индивидуальная упаковка материала стоматологического NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьютерных по 0.25 г, оттенок A2



Фото 64 – Иллюстрированное техническое руководство, Инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде - 1 шт.

Набор NEO Spectra ST Discovery Kit LV в компьютерных

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.

 Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-Тре-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 65 Макет маркировки «Набор NEO Spectra ST Discovery Kit LV в компьютерных»

Manufactured by
Dentsply DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY
www.dentsplysirona.com

Shade	mW/cm ²	sec.	mm
A1-A4	≥ 550	20	2
BW	≥ 800	10	

R₀ Only
For Dental Use Only

Neo Spectra ST HV - Sample

Contents:
Compules® Tips (0.25 g each)
4 x HV (High Viscosity) Compules® Tips, Shade A2
1 x Directions for Use
1 x Illustrated Technique Guide

Reorder 607.01.979

REF 60701979
LOT 1910001155 EXP 2022-09-30

*D010807019791/\$\$32209301910001155/



www.dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.ru



Storage Temperature: Keep Dry



Keep Away From Sunlight



Caution, consult directions for use



Made in Germany

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

**Dentsply
Sirona**

Spectra ST¹ Universal Composite Restorative

**Dentsply
Sirona**



Shade selection

Use the VITA® Shade Guide and i-shade label or the Spectra ST shade fingers.

Conditioning and/or bonding

Apply acid conditioner followed by adhesive or self-etching adhesive. Consult directions for use.

Placement of restorative

Place increments of a maximum of 2 mm.

Light curing

Light cure each increment according to provided curing chart.

Finishing and polishing

Shape and contour, finish and polish (e.g. with Enhance® Finishing System and Enhance® PoGel® Polishing System).

¹ Depending on market location, Spectra ST is available as either TPH Spectra® ST, Censium Spectra™ ST, or Neo Spectra™ ST.

² Not a registered trademark of Dentsply Sirona, Inc.

Caution, consult directions for use

**Dentsply
Sirona**

Neo Spectra ST Universal Composite Restorative

Composite universel de restauration

Composite restaurador universal

Универсальный композитный материал

Universal Restoratif Kompozit

حشوات كومبوزيت للاستعمال العام

Uniwersalny materiał kompozytowy do wypełnień

Neo Spectra ST Effects Universal Composite Restorative

Composite universel de restauration

Composite restaurador universal

Универсальный композитный материал

Universal Restoratif Kompozit

حشوات كومبوزيت للاستعمال العام

Uniwersalny materiał kompozytowy do wypełnień



Фото 66 – Набор NEO Spectra ST Discovery Kit HV в компьютерлах (общий вид)



Фото 67 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A2



Фото 68 – Индивидуальная упаковка материала стоматологического NEO Spectra ST HV (Compules® tips) в компьюлах по 0.25 г, оттенок A2



Фото 69 – Иллюстрированное техническое руководство, Инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде - 1 шт.

Набор NEO Spectra ST Discovery Kit HV в компьютерных

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.



■ Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-Тре-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 70 Макет маркировки «Набор NEO Spectra ST Discovery Kit HV в компьютерных»



Фото 72 – Материал
стоматологический NEO Spectra ST
LV (Compules® tips) в компьюле по
0.25 г, оттенок: A1



Фото 73 – Материал
стоматологический NEO Spectra ST
LV (Compules® tips) в компьюле по
0.25 г, оттенок: A2



Фото 74 – Материал
стоматологический NEO Spectra ST
LV (Compules® tips) в компьюле по
0.25 г, оттенок: A3



Фото 75 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A3,5



Фото 76 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A4



Фото 77 – Пистолет для компьют (Compules® Tips Gun)



Фото 78 – Палетка пластиковая для смешивания CliXdish



Фото 79 – Аппликаторы



Фото 80 – Адгезив Prime & Bond® universal во флаконе 2.5 мл

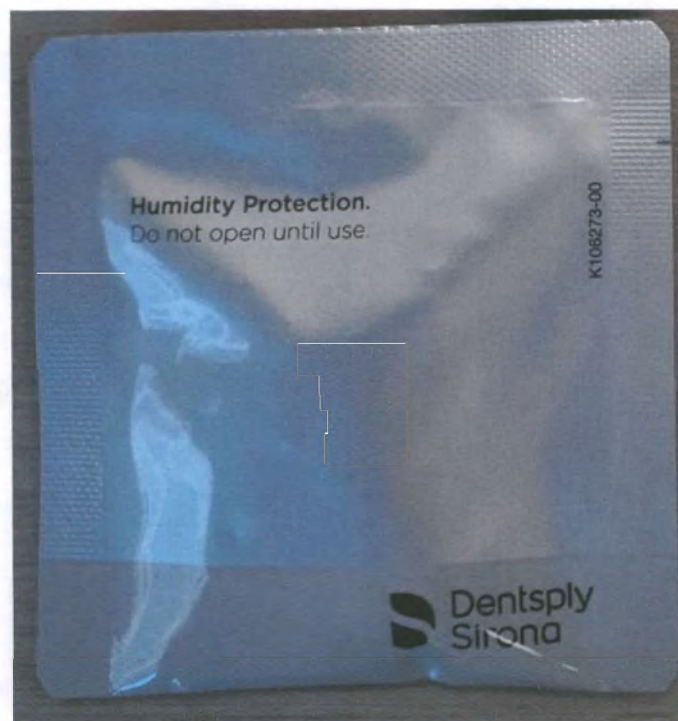


Фото 81 – Индивидуальная упаковка материала стоматологического NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A1, A2, A3, A3,5, A4



Фото 82 – Форма заказа расцветки NEO Spectra ST Shade Guide

Набор NEO Spectra ST LV Risk Free Trial Kit в компьютерных

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.



Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-Тре-й-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 84 Макет маркировки «Набор NEO Spectra ST LV Risk Free Trial Kit в компьютерных»



Фото 85 – Набор NEO Spectra ST Effects Intro Kit в компьютерных (общий вид)



Фото 86 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: D1



Фото 87 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: D3



Фото 88 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: E1



Фото 89 – Индивидуальная упаковка материала стоматологического NEO Spectra ST Effects (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: D1, D3, E1



Фото 90 – Маркировка i-Shade, Инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде - 1 шт,

Вкладыш информационный, Иллюстрированное техническое руководство

Набор NEO Spectra ST Effects Intro Kit в компьютерных

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.

 Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-Тре-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 91 Макет маркировки «Набор NEO Spectra ST Effects Intro Kit в компьютерных»



Фото 92 – Набор NEO Spectra ST, NEO Spectra ST Effects Sample в компьютерных (Общий вид)



Фото 93 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: D1



Фото 94 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A2



Фото 95 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: E1



Фото 96 – Индивидуальная упаковка для материала стоматологического NEO Spectra ST Effects (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: D1, E1 и материала стоматологического NEO Spectra ST HV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A2



Фото 97 – Иллюстрированное техническое руководство, Инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде - 1 шт.

Набор NEO Spectra ST, NEO Spectra ST Effects Sample в компьютерных

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.

 Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-Тре-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 98 – Макет маркировки «Набор NEO Spectra ST, NEO Spectra ST Effects Sample в компьютерных»



Фото 99 – Набор NEO Spectra ST Intro Kit HV в компьютерных пакетах (Общий вид)



Фото 100 – Материал
стоматологический NEO Spectra ST
HV (Compules® tips) в компьюле по
0.25 г, оттенок: A1



Фото 101 – Материал
стоматологический NEO Spectra ST
HV (Compules® tips) в компьюле по
0.25 г, оттенок: A2



Фото 102 – Материал
стоматологический NEO Spectra ST
HV (Compules® tips) в компьюле по
0.25 г, оттенок: A3



Фото 103 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A3,5



Фото 104 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A4



Фото 105 – Пистолет для компьют (Compules® Tips Gun)



Фото 106 – Палетка пластиковая для смешивания CliXdish



Фото 107 – Аппликаторы



Фото 108 – Адгезив Prime & Bond® universal во флаконе 2.5 мл



Фото 109 – Индивидуальная упаковка материала стоматологического NEO Spectra ST HV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A1, A2, A3, A3,5, A4



Фото 110 – Форма заказа расцветки NEO Spectra ST Shade Guide



Фото 111 – Иллюстрированное техническое руководство, Маркировка i-Shade, Инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде - 2 шт., Вкладыш информационный

Набор NEO Spectra ST Intro Kit HV в компьютерных

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.



Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-Тре-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:
ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 112 – Макет маркировки «Набор NEO Spectra ST Intro Kit HV в компьютерных»



Фото 113 – Набор NEO Spectra ST HV Risk Free Trial Kit в компьютерных (Общий вид)



Фото 114 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Compules® tips) в компьютер по 0.25 г, оттенок: A1



Фото 115 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Compules® tips) в компьютер по 0.25 г, оттенок: A2



Фото 116 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Compules® tips) в компьютер по 0.25 г, оттенок: A3



Фото 117 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A3,5



Фото 118 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A4



Фото 119 – Пистолет для компюл (Compules® Tips Gun)



Фото 120 – Палетка пластиковая для смешивания CliXdish

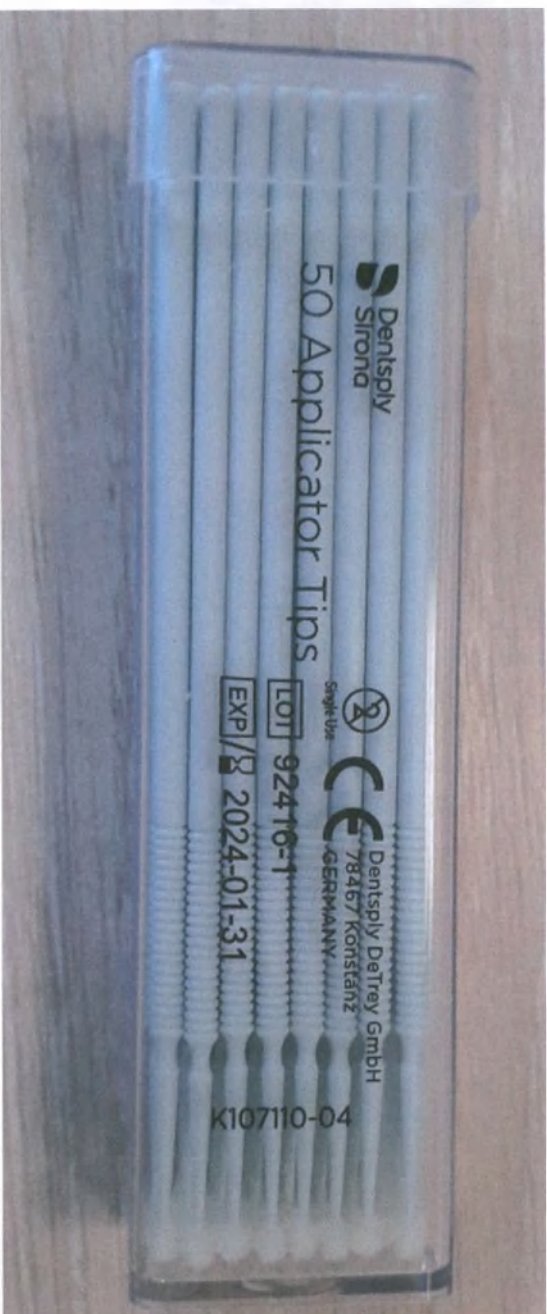


Фото 121 – Апликаторы



Фото 122 – Адгезив Prime & Bond® universal во флаконе 2.5 мл



Фото 123 – Индивидуальная упаковка материала стоматологического NEO Spectra ST HV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A1, A2, A3, A3,5, A4



Фото 124 – Форма заказа расцветки NEO Spectra ST Shade Guide



Фото 125 – Иллюстрированное техническое руководство, Маркировка i-Shape, Инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде - 2 шт., Вкладыш информационный

Набор NEO Spectra ST HV Risk Free Trial Kit в компьютерных

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.



Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-Трей-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:
ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 126 – Макет маркировки «Набор NEO Spectra ST HV Risk Free Trial Kit в компьютерных»

Сшито 91 листа(ов)

Директор по регистрации, СНГ

ООО «Дентсплай Сирона»



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/21 ОТ 01.10.2021

Хаиндрава В.Г. 