

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Дентсплай Сирона»


Левин К.Г.
«21» декабря 2021 г.
ДИРЕКТОР
«Дентсплай Сирона» ПО РЕГИСТРАЦИИ,
Dentsply Sirona LLC СНГ
ХАИНДРАВА В.Г.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/21 ОТ 01.10.2021



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Материал стоматологический светоотверждаемый реставрационный NEO Spectra ST для реставрации передних и боковых зубов в отдельных упаковках в вариантах исполнения с принадлежностями



Фото 1 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: A1



Фото 2 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: A2



Фото 3 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: A3



Фото 4 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: A3,5



Фото 5 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: A4

A1

Freifläche
22 x 42 mm

K102271-00

**Dentsply
Sirona**

Neo Spectra™ ST Universal Composite Restorative

Content:

Neo Spectra™ ST LV
1 x Syringe (3 g)



Available in five universal **CLOUD** shades:
A1, A2, A3, A3.5, A4

VITA® universal CLOUD shade	A1 B1 C1	A2 B2 D2	A3 C2 D3 D4

VITA® universal CLOUD shade	A3.5 B3 B4 C3	A4 C4	+ BW Bleach White

[†] Not a registered trademark of Dentsply Sirona, Inc.



www.dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.ru



Keep Dry



Storage
Temperature



Keep Away
from Sunlight



Caution, consult
directions for use



Rx Only

For Dental Use Only



Manufactured by
Dentsply DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY



0123 www.dentsplysirona.com

Made in Germany

Shade	mW/cm²	sec.	mm
A1-A4	≥ 550	20	2
BW	≥ 800	10	

Composite universel de restauration
Composite restaurador universal
Универсальный композитный
материал
Universal Restoratif Kompozit

حشوات كومبوزيت للاستعمال العام
Uniwersalny materiał kompozytowy do
wypełnień



with
SphereTEC®
Filler Technology

Фото 6 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: A1, A2, A3, A3.5, A4 (потребительская упаковка)

Материал стоматологический светоотверждаемый реставрационный NEO Spectra ST для реставрации передних и боковых зубов в отдельных упаковках в вариантах исполнения

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.



Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-Trey-Strasse 1, 78467 Konstanz, GERMANY / Дентсплай Ди Трей ГмбХ, Ди-Тре-й-Штрассе 1, 78467 Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона», Российская Федерация, 115432, Москва, проспект Андропова, д.18, корп. 6, офисы 1 39 40, тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 7 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: A1, A2, A3, A3.5, A4 (маркировка потребительской упаковки)



Фото 8 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьютер по 0.25 г, оттенок: A1



Фото 9 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьютер по 0.25 г, оттенок: A2



Фото 10 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьютер по 0.25 г, оттенок: A3



Фото 11 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A3,5



Фото 12 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: A4



Фото 13 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: BW



**Фото 14 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьюлах по 0.25 г, оттенки: A1, A2, A3, A3.5, A4, BW- 16 шт. в упаковке
(индивидуальная упаковка)**



Фото 15 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьютерных по 0.25 г, оттенки: A1, A2, A3, A3.5, A4, BW- 16 шт. в упаковке
(потребительская упаковка)

Материал стоматологический светоотверждаемый реставрационный NEO Spectra ST для реставрации передних и боковых зубов в отдельных упаковках в вариантах исполнения с принадлежностями

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН ##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.



Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-Трей-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 16 – Материал стоматологический NEO Spectra ST LV (Compules® tips) в компьютерных по 0.25 г, оттенки: A1, A2, A3, A3.5, A4, BW- 16 шт. в упаковке

(маркировка потребительской упаковки)

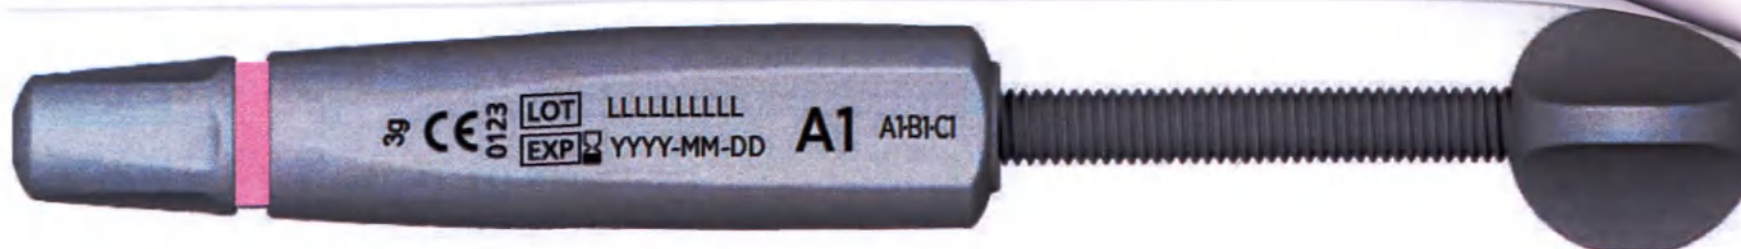


Фото 17 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: A1



Фото 18 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: A2



Фото 19 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: A3



Фото 20 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: A3,5



Фото 21 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: A4

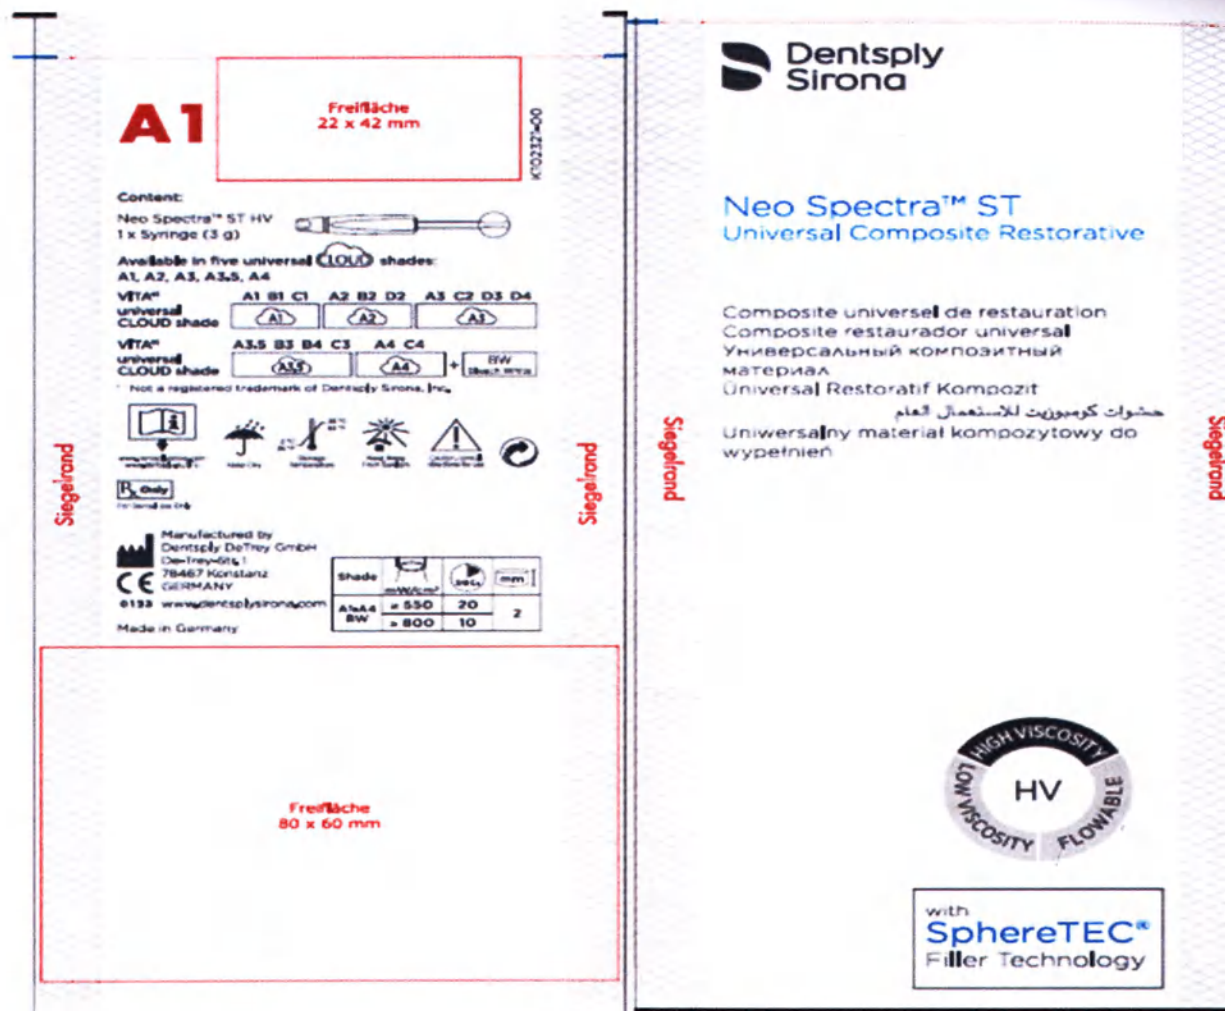


Фото 22 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: A1, A2, A3, A3.5, A4 – 1 шт. в упаковке;
(потребительская упаковка)

Материал стоматологический светоотверждаемый реставрационный NEO Spectra ST для реставрации передних и боковых зубов в отдельных упаковках в вариантах исполнения с принадлежностями

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.



Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-Трей-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 23 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: A1, A2, A3, A3.5, A4 – 1 шт. в упаковке;
(маркировка потребительской упаковки)



Фото 23 – Материал
стоматологический NEO Spectra ST
HV (Compules® tips) в компьютере по
0.25 г, оттенок: A1



Фото 24 – Материал
стоматологический NEO Spectra ST
HV (Compules® tips) в компьютере по
0.25 г, оттенок: A2



Фото 25 – Материал
стоматологический NEO Spectra ST
HV (Compules® tips) в компьютере по
0.25 г, оттенок: A3



Фото 26 – Материал
стоматологический NEO Spectra ST
HV (Compules® tips) в компьютере по
0.25 г, оттенок: A3,5



Фото 27 – Материал
стоматологический NEO Spectra ST
HV (Compules® tips) в компьютере по
0.25 г, оттенок: A4



Фото 28 – Материал
стоматологический NEO Spectra ST
HV (Compules® tips) в компьютере по
0.25 г, оттенок: BW



Фото 29 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Compules® tips) в कंप्यूлах по 0.25 г, оттенки: A1, A2, A3, A3.5, A4, BW - 16 шт. в упаковке;

(индивидуальная упаковка)

D1

Barcode, Recorder
42 x 22 mm
Frame will not be printed


Content:

16 x Neo Spectra™ ST HV Compules® Tips (0.25 g each)

Available in five universal CLOUD shades: A1, A2, A3, A3.5, A4

VITA®

universal CLOUD shade



* Not a registered trademark of Dentsply Sirona, Inc.



Manufactured by
Dentsply De Trey GmbH
Dentweg 1
78467 Konstanz
GERMANY
0133 www.dentsplysirona.com

Shade	mm/cm²	mm	mm
A1/A4	± 550	30	7
BW	± 800	10	7

Made in Germany



www.dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.ru



**Dentsply
Sirona**

Neo Spectra™ ST Universal Composite Restorative

Composite universel de restauration

Composite restaurador universal

Универсальный композитный материал

Üniversal Restoratif Kompozit

حشوات كومبوزيت للاستعمال العام

Uniwersalny materiał kompozytowy do wypełnień



with
SphereTEC®
Filler Technology

Фото 30 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Compules® tips) в компьютерных по 0.25 г, оттенки: A1, A2, A3, A3.5, A4, BW - 16 шт. в упаковке;

(потребительская упаковка)

Материал стоматологический светоотверждаемый реставрационный NEO Spectra ST для реставрации передних и боковых зубов в отдельных упаковках в вариантах исполнения с принадлежностями

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН ##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.



Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-ТреЙ-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 31 – Материал стоматологический NEO Spectra ST HV (Compules® tips) в компьютерных по 0.25 г, оттенки: A1, A2, A3, A3.5, A4, BW - 16 шт. в упаковке;
(маркировка потребительской упаковки)



Фото 32 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: D1




Фото 33 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: D3



Фото 34 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Compules® tips) в компьюле по 0.25 г, оттенок: E1



**Фото 35 – Общий вид индивидуальной упаковки для Материал стоматологический NEO Spectra ST LV, NEO Spectra ST HV, NEO Spectra ST Effects, (Compules® tips) в компьюлах по 0,25 мл
(индивидуальная упаковка)**

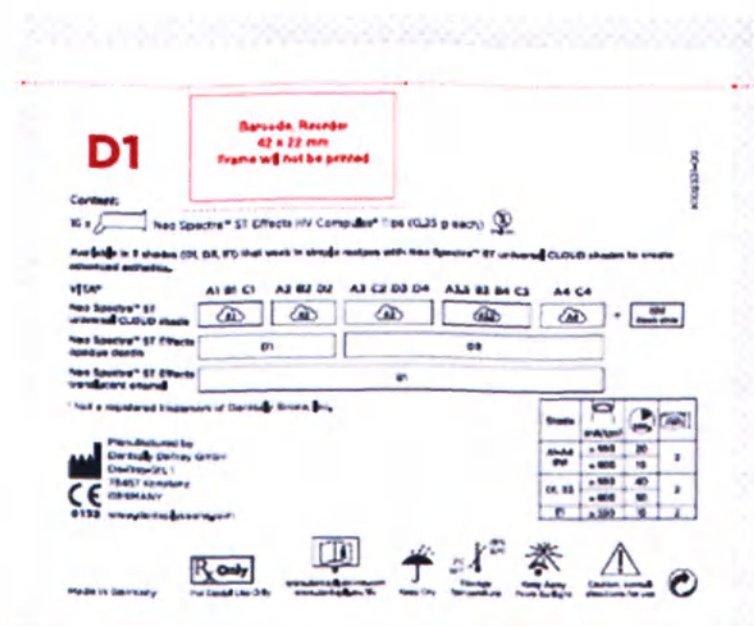

Freifläche für Länderetiketten
Format 160 x 80 mm

Dentsply
Sirona

Neo Spectra™ ST Effects Universal Composite Restorative

Composite universel de restauration

Composite restaurador universal

Универсальный композитный материал

Universal Restoratif Kompozit

مستحضرات كومبوزيت للاستعمال العام

Uniwersalny materiał kompozytowy do wypełnień



Фото 36 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Compules® tips) в компьютерных по 0.25 г, оттенки: D1, D3, E1 - 16 шт. в упаковке.

(потребительская упаковка)

Материал стоматологический светоотверждаемый реставрационный NEO Spectra ST для реставрации передних и боковых зубов в отдельных упаковках в вариантах исполнения с принадлежностями

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН ####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.



Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-ТреЙ-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 37 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Compules® tips) в компьюлах по 0.25 г, оттенки: D1, D3, E1 - 16 шт. в упаковке.

(маркировка потребительской упаковки)



Фото 38 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: D1



Фото 39 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: D3



Фото 40 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Syringe) в шприце по 3 г, оттенок: D3



Neo Spectra™ ST Effects Universal Composite Restorative

Composite universel de restauration
Composite restaurador universal
Универсальный композитный материал
Universal Restoratif Kompozit

حشوات كومبوزيت للاستعمال العام
Uniwersalny materiał kompozytowy do wypełnień

Siegelrand

Siegelrand



with
SphereTEC®
Filler Technology

Content:

Neo Spectra™ ST Effects HV
1 x Syringe (3 g)



Available in 3 shades (D1, D3, E1) that work in simple recipes with
Neo Spectra™ ST universal CLOUD shades to create advanced esthetics.

VITA®¹

Neo Spectra™ ST
universal CLOUD shade

A1 B1 C1	A2 B2 D2	A3 C2 D3 D4	A3.5 B3 B4 C3	A4 C4	+ BW
A1	A2	A3	A3.5	A4	

Neo Spectra™ ST Effects
opaque dentin

D1	D3
----	----

Neo Spectra™ ST Effects
translucent enamel

E1

¹ Not a registered trademark of Dentsply Sirona, Inc.



www.dentsplysirona.com
www.dentsplyeu.com



Keep Dry



Storage
Temperature



Keep Away
From Sunlight



Caution, consult
directions for use



For Dental Use Only

Manufactured by
Dentsply DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY



0123 www.dentsplysirona.com

Made in Germany

Shade	mW/cm²	sec.	mm
A1-A4	≥ 550	20	2
BW	≥ 800	10	
D1, D3	≥ 550	40	2
	≥ 800	30	
E1	≥ 550	10	2

Фото 41 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: D1, D3, E1 – 1 шт. в упаковке; (потребительская упаковка)

Материал стоматологический светоотверждаемый реставрационный NEO Spectra ST для реставрации передних и боковых зубов в отдельных упаковках в вариантах исполнения с принадлежностями

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.



Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply De Trey GmbH, De-
Trey-Strasse 1, 78467
Konstanz, GERMANY /
Дентсплай Ди Трей ГмбХ,
Ди-Трей-Штрассе 1, 78467
Констанц, ГЕРМАНИЯ

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



www.dentsplysirona.com/ru-ru

Инструкция в электронном виде

Страна происхождения:

Германия

Фото 42 – Материал стоматологический NEO Spectra ST Effects (Syringe) в шприцах по 3 г, оттенки: D1, D3, E1 – 1 шт. в упаковке; (маркировка потребительской упаковки)



Фото 43 – Пистолет для компьют (Compules® Tips Gun)



Фото 44 – Палетка пластиковая для смешивания CliXdish

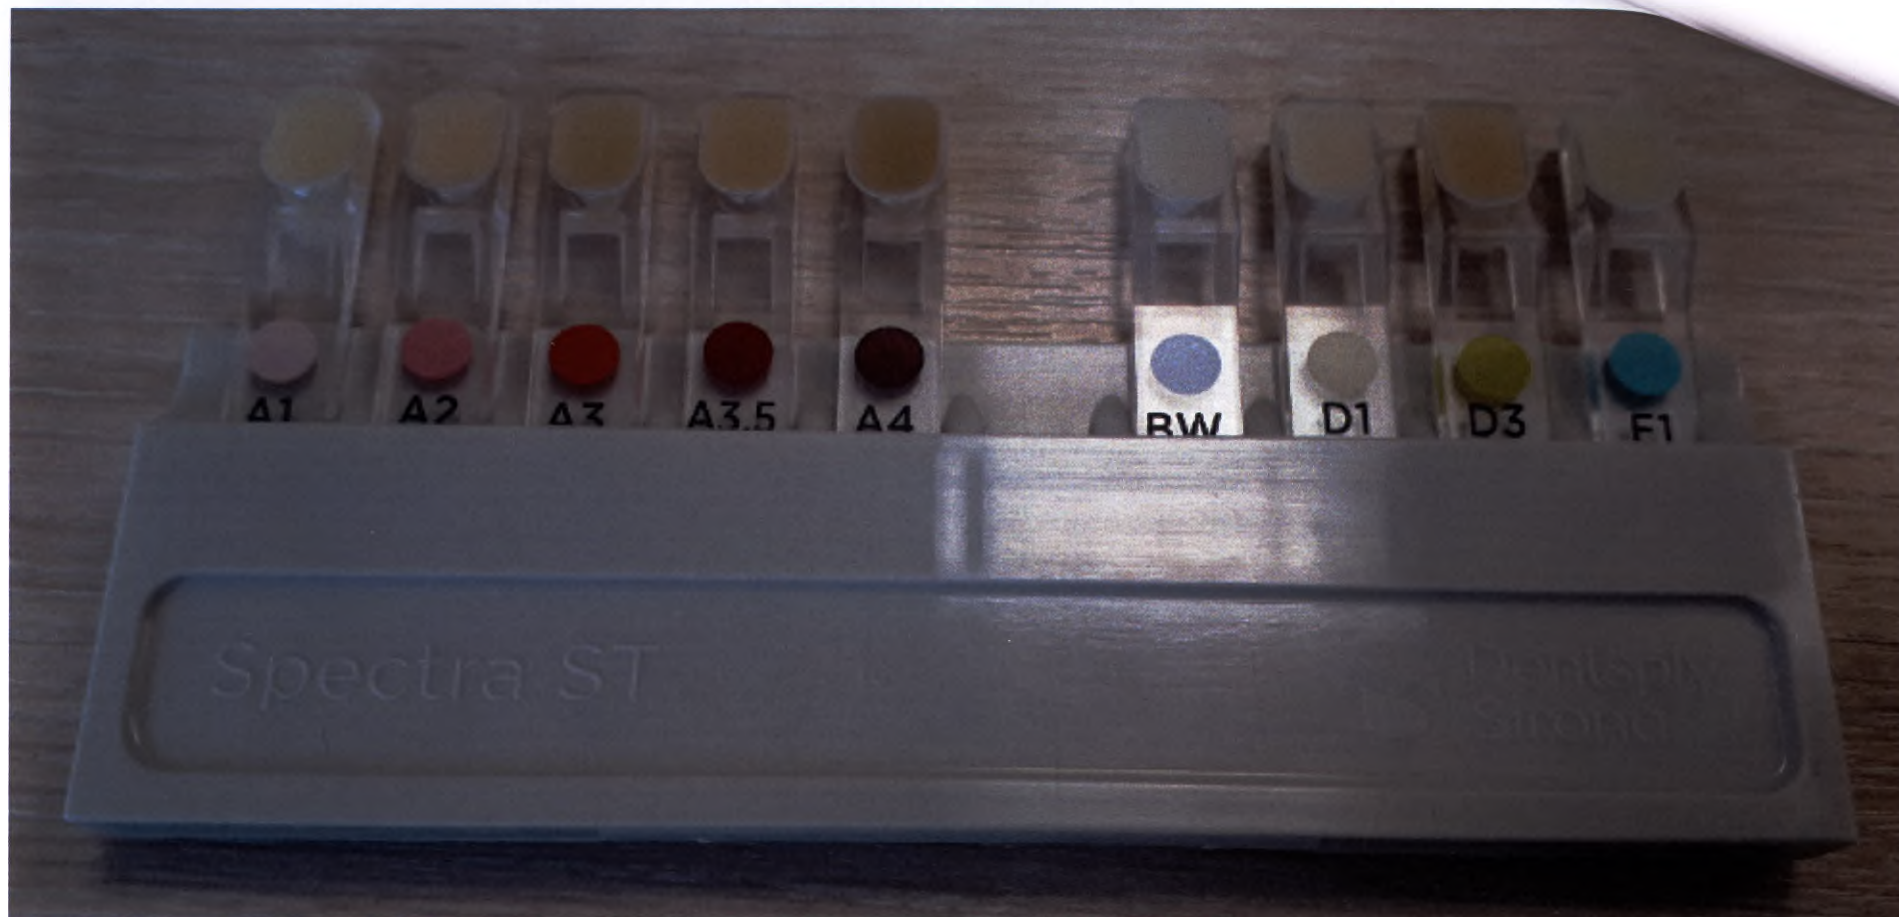


Фото 45 – Расцветка NEO Spectra ST Shade Guide

Сшито 30 листа(ов)

Директор по регистрации, СНГ

ООО «Дентсплай Сирона»

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

№ 1/21 ОТ 01.10.2021

Хаиндрава В.Г. 

