

ОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы по регистрации продукции
для in vitro диагностики, иммунохимия,
гематология и гемостаз
ООО «Сименс Здравоохранение»

Чигринцев Е.А.

2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину (ADVIA Centaur® aTgII Quality Control (ADVIA Centaur® aTgII QC)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur»

производства «Сименс Хелскэа Диагностикс продактс Лимитед», Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited, Великобритания

2023

SIEMENS
Healthineers

ADVIA Centaur®

aTgII QC

CONTROL 1 3 x 1.0 mL
コントロール 1

CONTROL 2 3 x 1.0 mL
コントロール 2

2°C - 8°C



IVD 体外診断用医薬品

siemens.com/eifu

For US / CA

RxOnly

For *in vitro* diagnostic use in monitoring the precision and accuracy of the ADVIA Centaur® aTgII assay.
Contains: Buffer • low or high level of monoclonal mouse anti-human thyroglobulin • goat serum • mouse serum • sodium azide (< 0.1%) • preservative.

Рисунок 1. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину (ADVIA Centaur® aTgII Quality Control (ADVIA Centaur® aTgII QC)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur. Общий вид

aTgII QC

シーメンスヘルスケア・
ダイアグノスティクス株式会社
東京都品川区大崎1-11-1
Siemens Healthcare Diagnostics

輸入

H412
P273, P501



Siemens Healthcare Diagnostics Products Ltd.
Glyn Rhonwy, Llanberis, Gwynedd LL55 4EL
United Kingdom



Siemens Healthcare Diagnostics
Manufacturing Ltd.
Chapel Lane
Swords, Co. Dublin, Ireland

siemens-healthineers.com

11208328_01


Рисунок 2. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину (ADVIA Centaur® aTgII Quality Control (ADVIA Centaur® aTgII QC)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur. Общий вид



Рисунок 3. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину (ADVIA Centaur® aTgII Quality Control (ADVIA Centaur® aTgII QC)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur. Общий вид



Рисунок 4. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину (ADVIA Centaur® aTgII Quality Control (ADVIA Centaur® aTgII QC)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur. Общий вид

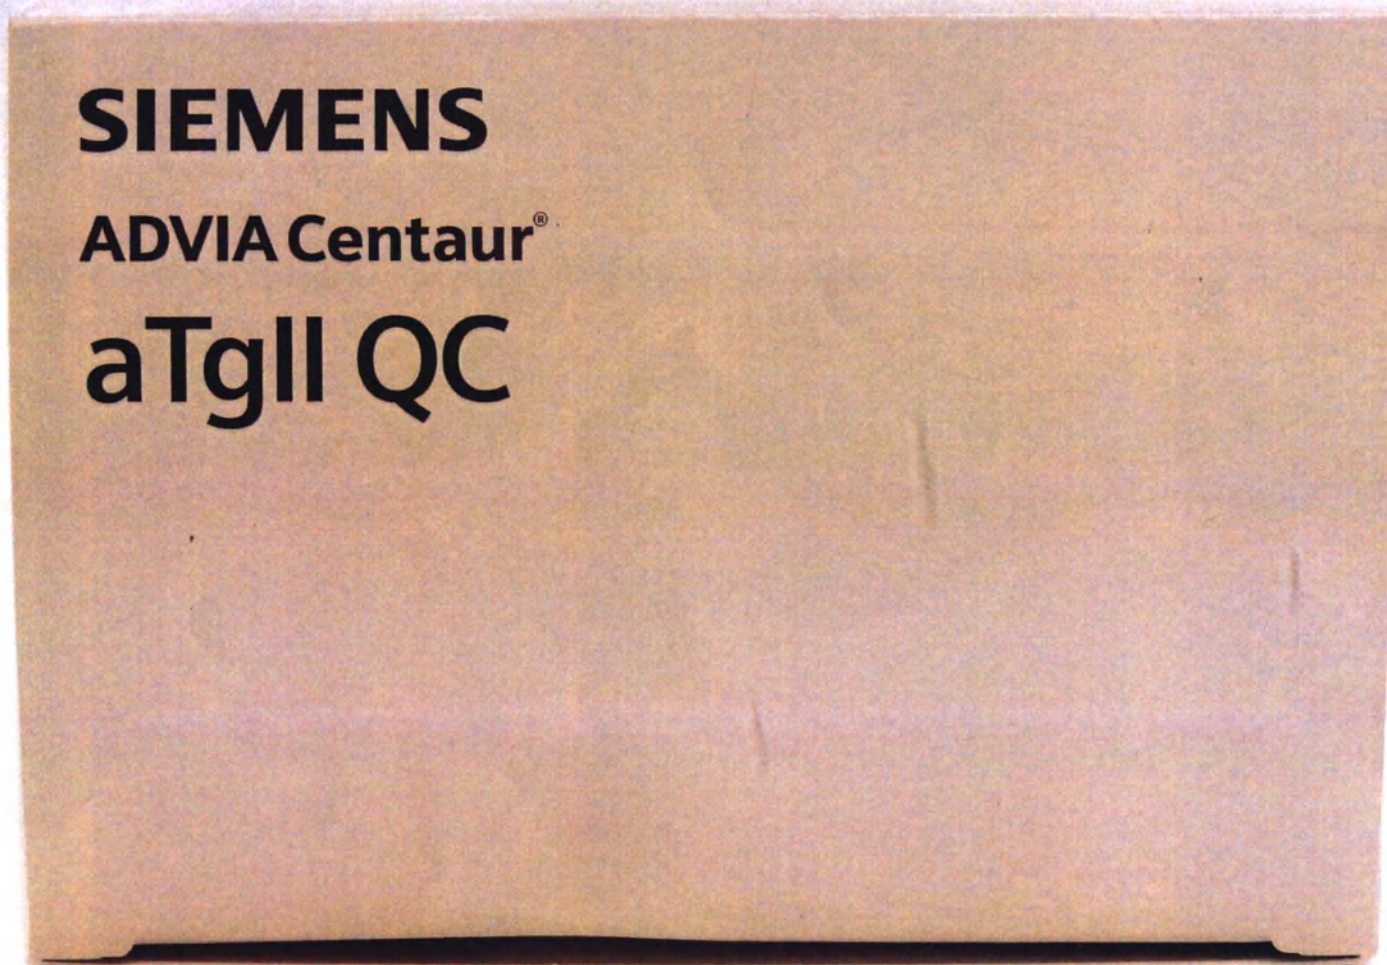

SIEMENS
ADVIA Centaur[®]
aTgII QC

Рисунок 5. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину (ADVIA Centaur[®] aTgII Quality Control (ADVIA Centaur[®] aTgII QC)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur. Общий вид

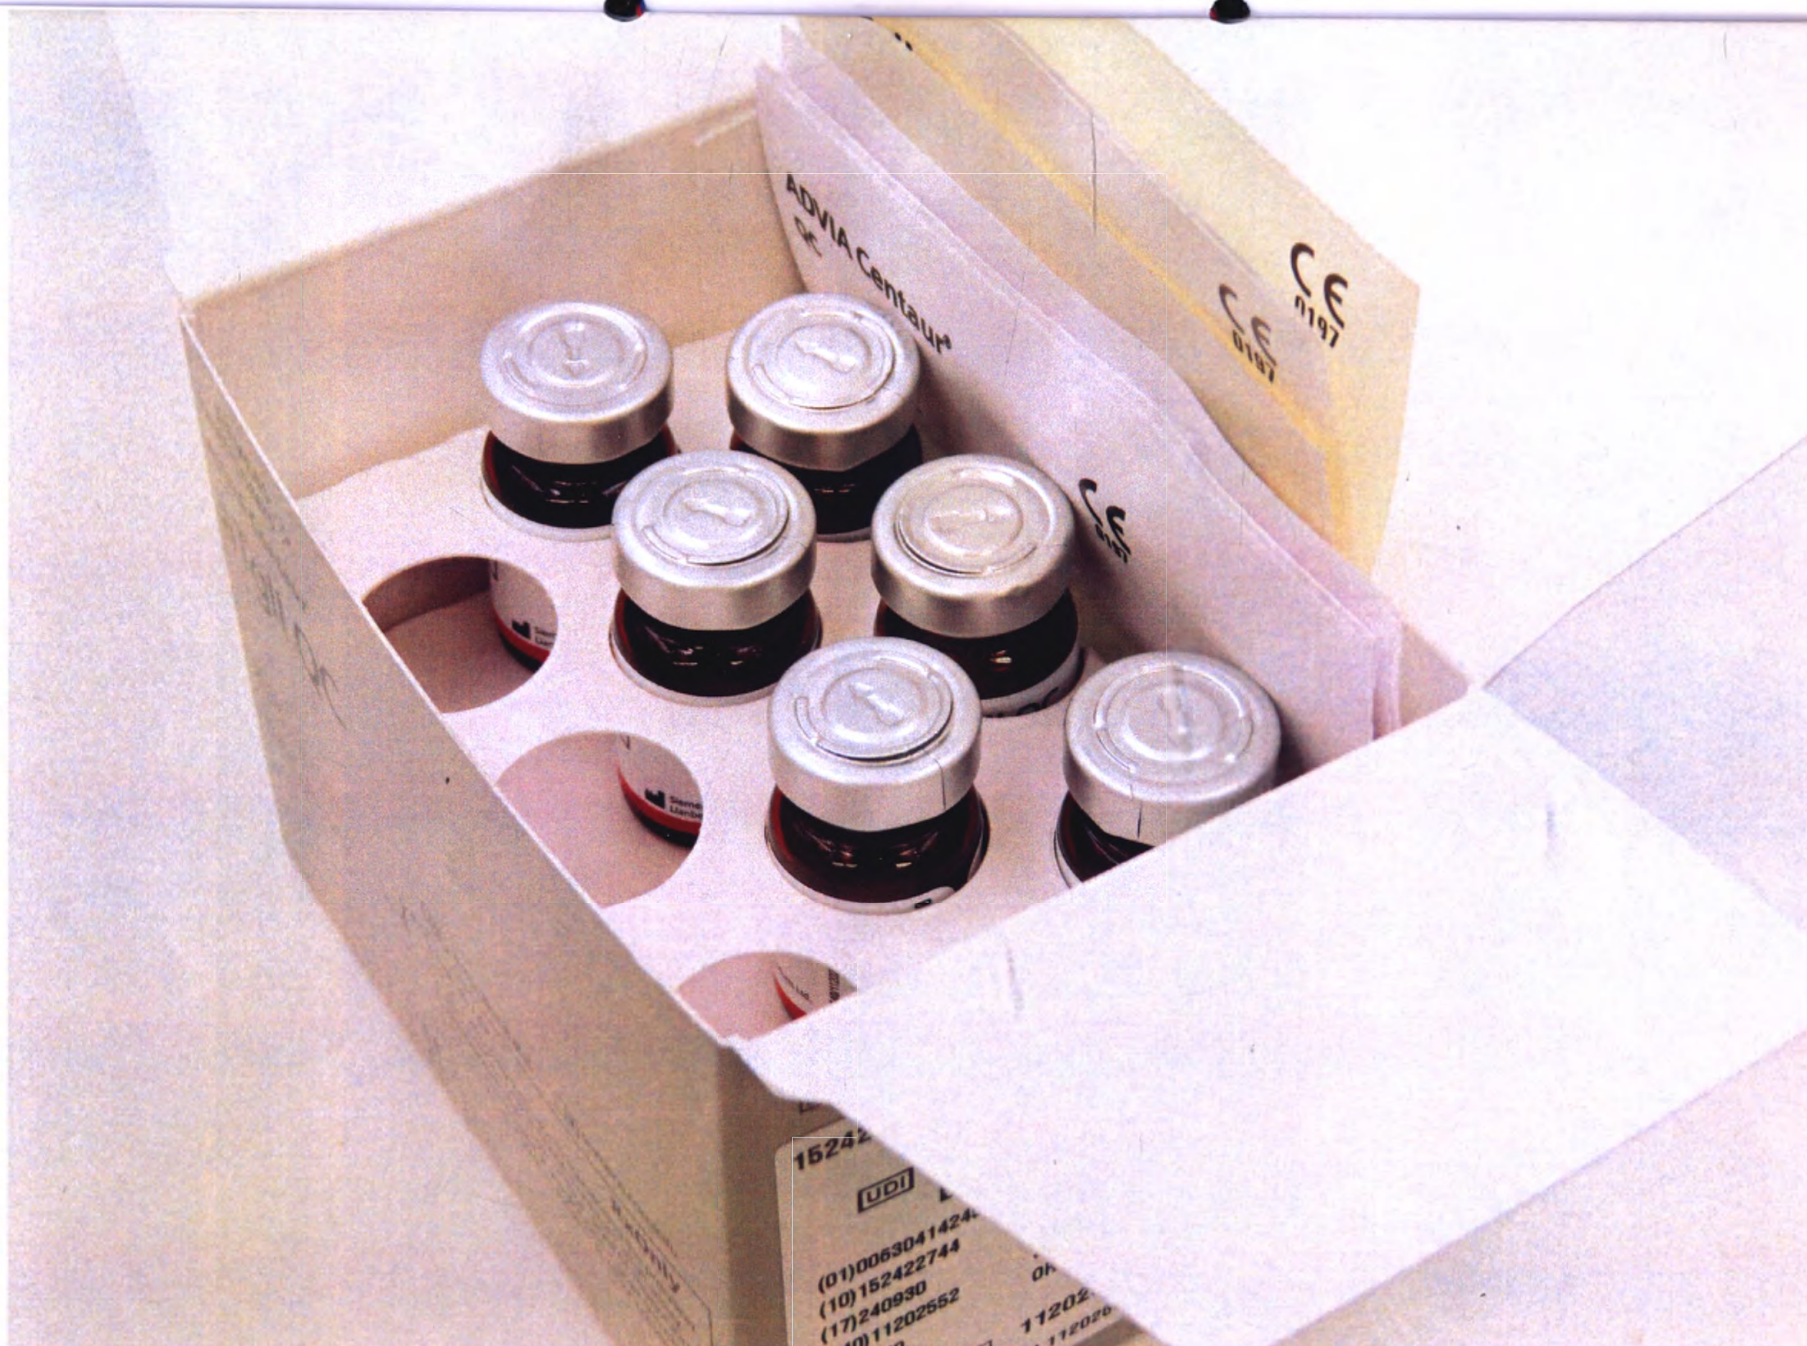


Рисунок 6. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину (ADVIA Centaur® aTgII Quality Control (ADVIA Centaur® aTgII QC)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur. Общий вид

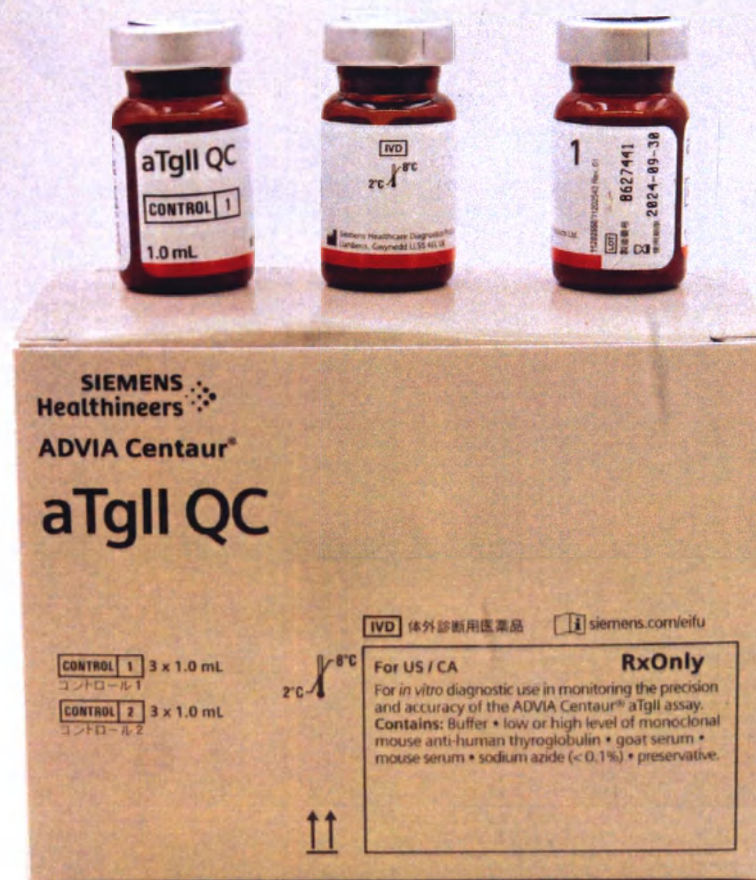


Рисунок 7. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину (ADVIA Centaur® aTgII Quality Control (ADVIA Centaur® aTgII QC)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur: Контроль качества 1-го уровня aTgII QC CONTROL 1, 1,0 мл

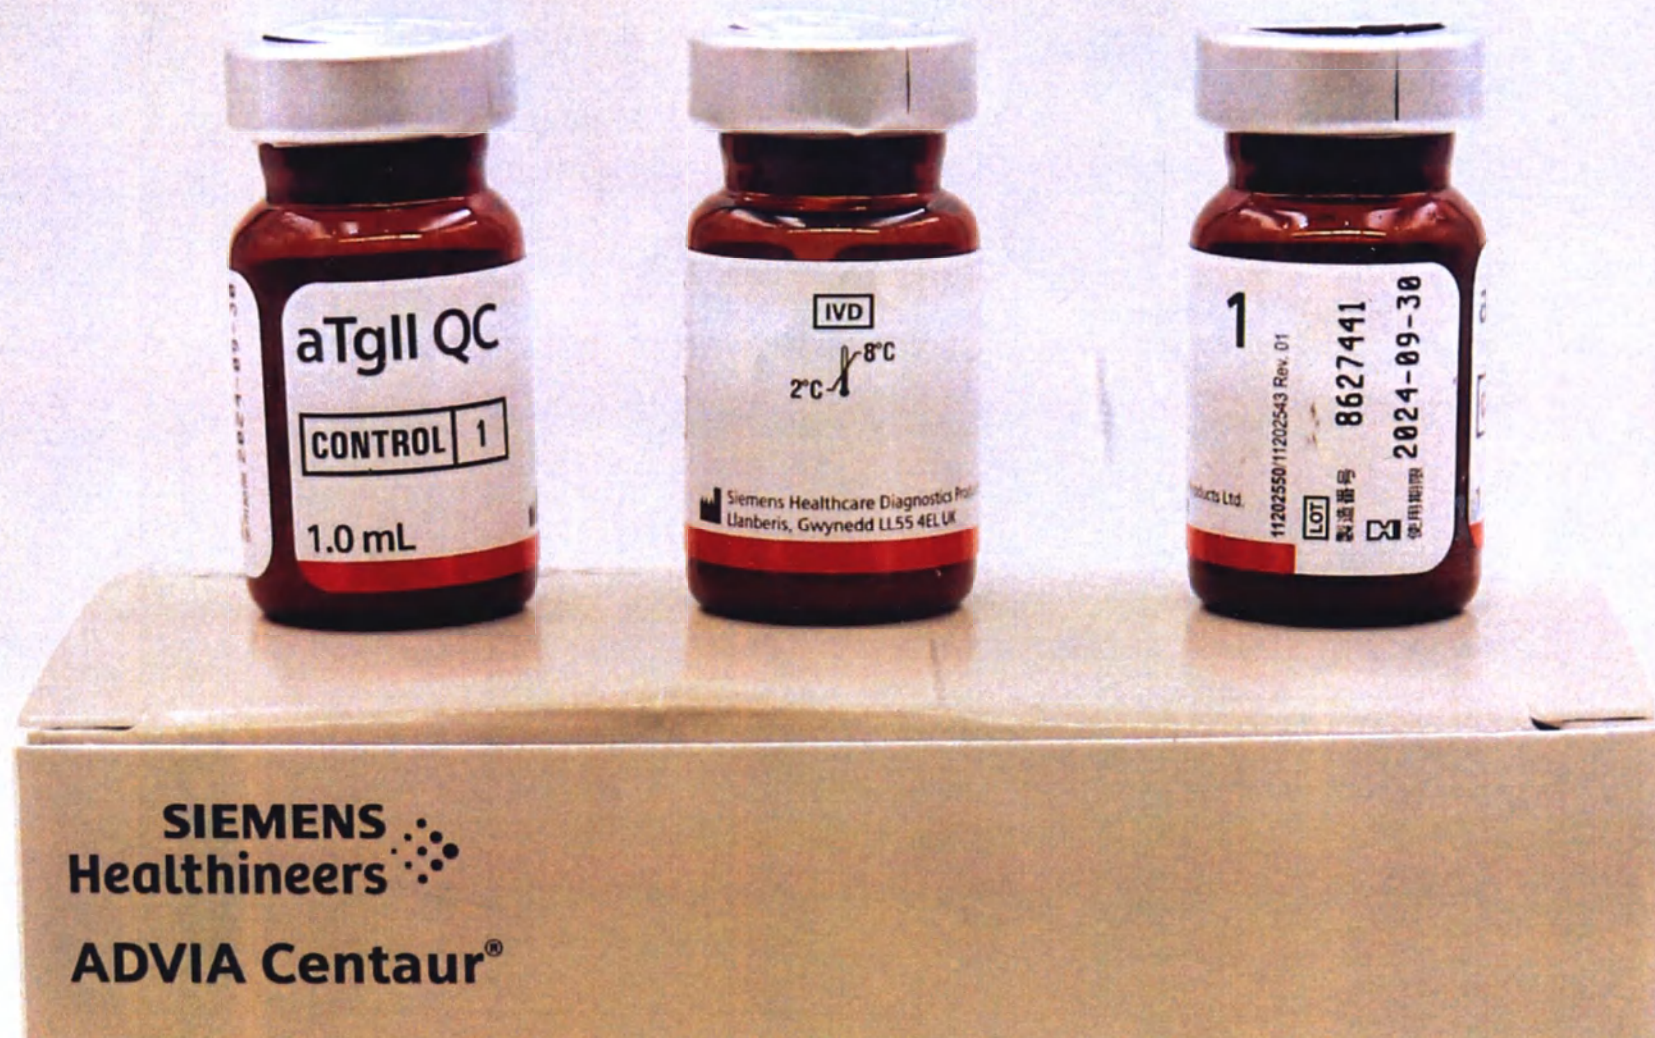


Рисунок 8. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину (ADVIA Centaur® aTgII Quality Control (ADVIA Centaur® aTgII QC)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur: Контроль качества 1-го уровня aTgII QC CONTROL 1, 1,0 мл

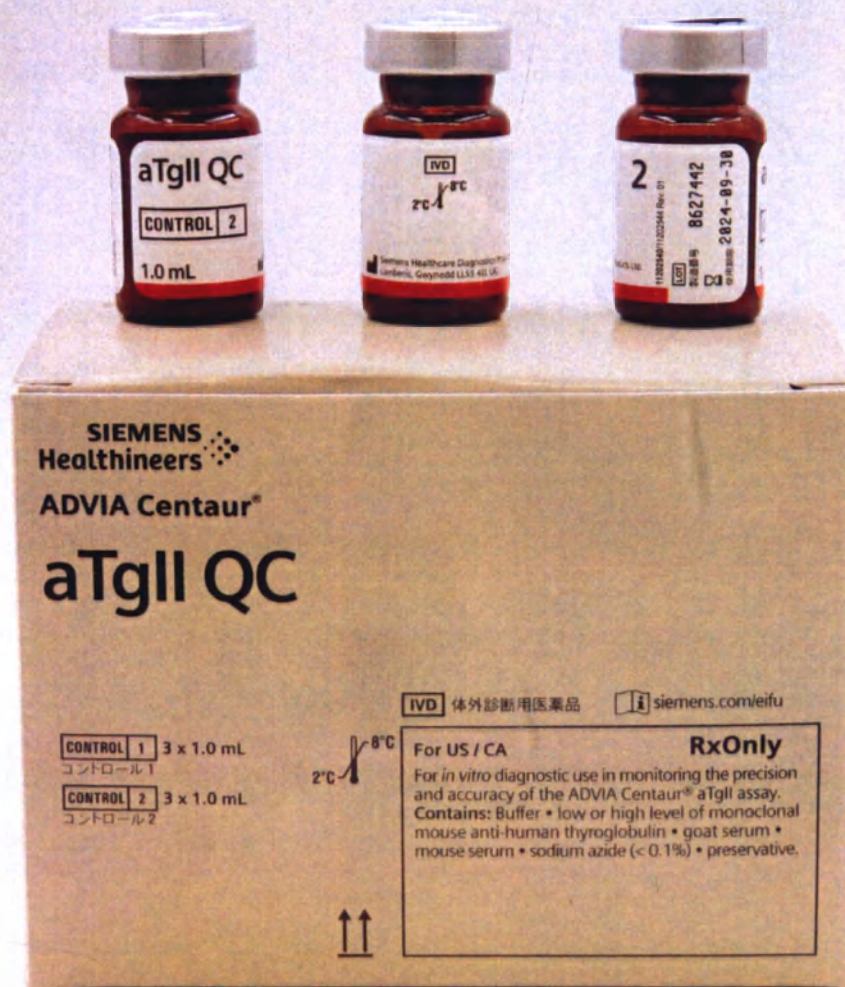


Рисунок 9. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину (ADVIA Centaur® aTgII Quality Control (ADVIA Centaur® aTgII QC)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur: Контроль качества 2-го уровня aTgII QC CONTROL 2, 1,0 мл

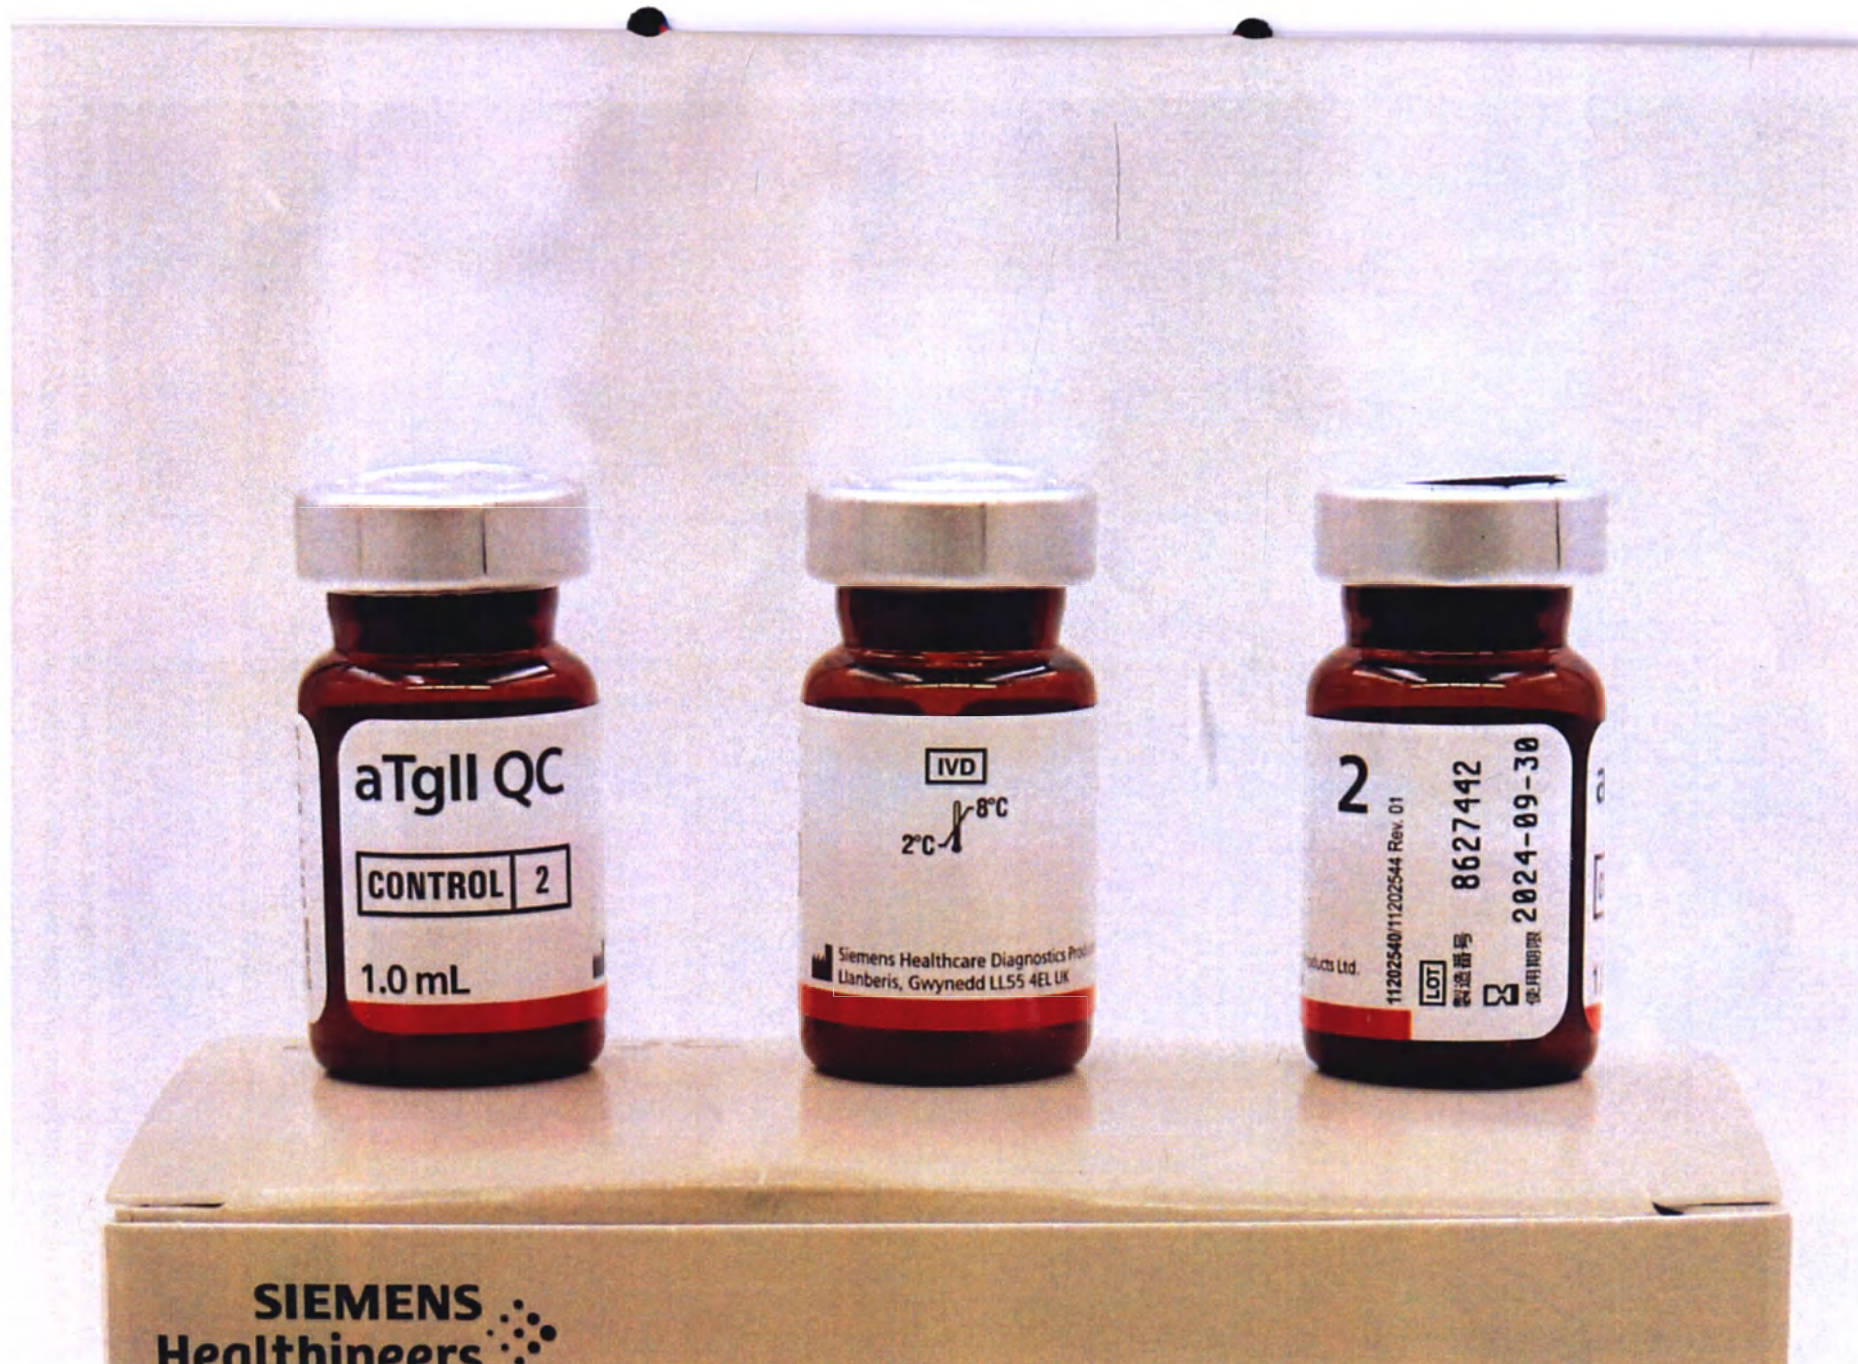


Рисунок 10. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину (ADVIA Centaur® aTgII Quality Control (ADVIA Centaur® aTgII QC)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur: Контроль качества 2-го уровня aTgII QC CONTROL 2, 1,0 мл

aTgII
REF

11202552

8
REF: 11202552

2021-11-21

ADVIA CENTAUR

CONTROL	IU/mL		IU/mL	
LOT 批号	Target	Range	Target	Range
8632511	48.4	+/- 13.0	48.4	+/- 13.0
8632512	405	+/- 109	405	+/- 109

ADVIA CENTAUR CP

CONTROL	IU/mL		IU/mL	
LOT 批号	Target	Range	Target	Range
8632511	48.4	+/- 15.1	48.4	+/- 15.1
8632512	405	+/- 126	405	+/- 126

00478758 Rev. F

Рисунок 11. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину (ADVIA Centaur® aTgII Quality Control (ADVIA Centaur® aTgII QC)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur: Карта присвоенных значений для контроля качества и этикетки со штрихкодами



Рисунок 12. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину (ADVIA Centaur® aTgII Quality Control (ADVIA Centaur® aTgII QC)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur: Карта присвоенных значений для контроля качества и этикетки со штрихкодами

11202552 Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину (ADVIA Centaur® aTgII Quality Control (ADVIA Centaur® aTgII QC)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2021/16148 от 29.12.2021

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Всего прошито и пронумеровано
14 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

