

Фотографические изображения
На медицинское изделие для диагностики in vitro:

Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA ВИЧ-Аг/Ат»

Вариант исполнения 1	стр 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Фотографическое изображение «Калибратора +»	стр 8
Фотографическое изображение «Калибратора —»	стр 9

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки

«MagnaLIA ВИЧ Аг/Ат»



MagnaLIA

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA ВИЧ Аг/Ат»

Состав набора:

Калибратор -	1 фл.
Калибратор + ВИЧ-1	1 фл.

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA ВИЧ Аг/Ат»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


П А С П О Р Т № E002

Набор реагентов для калибровки


«MagnaLIA ВИЧ Аг/Ат»

LOT

E002



2020-06-15




REF

2240101



2021-06-15



IVD



10



ТУ 21.20.23-498-98539446-2019

ПУ № XXXXXXXXXXXXXXXX



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru




ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E002

Набор реагентов для калибровки

«MagnoLIA ВИЧ Аг/Ат»

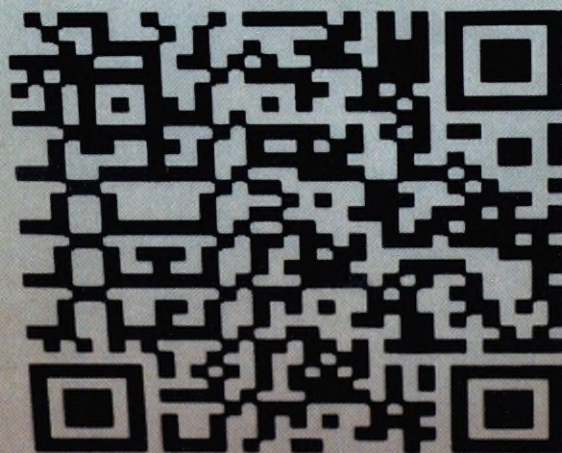

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки

«MagnaLIA ВИЧ Аг/Ат»



MagnaLIA

Состав набора:

Калибратор -	5 фл.
Калибратор + ВИЧ-1	5 фл.

ТУ 21.20.23-498-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA ВИЧ Аг/Ат»

LOT E002

REF 2240105

IVD

2020-06-15

2021-06-15

Σ 50

+2/+8 °C



Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики in vitro
Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA ВИЧ Аг/Ат»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки

«MagnaLIA ВИЧ Аг/Ат»

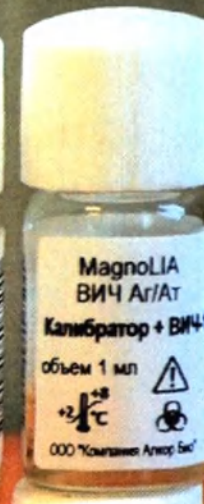

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA ВИЧ Ag/At»







Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 9 (*двѣ*) лист *2*

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



Макеты этикеток на медицинское изделие:

Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA ВИЧ Аг/Ат» производства ООО «Компания Алкор Био»

- Внешняя этикетка , вариант исполнения 1 - лист 2
- Внутренние этикетки, вариант исполнения 1— лист 3
- Внешняя этикетка, вариант исполнения 2 — лист 4
- Внутренние этикетки, вариант исполнения 2 — лист 5

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.



Комплектация 1
Кат № 2240101



Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA ВИЧ Ag/Ат»

Состав набора:

Калибратор -	1 фл.
Калибратор+Вич 1	1 фл.

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

LOT	E002		2020-06-15		2 ⁵ -2 ⁵ °C	
REF	2240101		2021-06-15		1	
IVD			10			

ТУ 21 20 23-498-98539446-2019
Р/У № XXXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA ВИЧ Аг/Ат»

Маркировка первичной
упаковки



Комплектация 1

Кат № 2240101

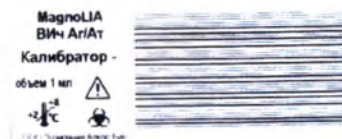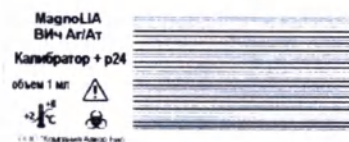

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA ВИЧ Аг/Ат»

Маркировка вторичной
упаковки



Комплектация 2

Кат № 2240105

ООО «Компания Алкор Био»,
192148 Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6787878; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

LOT E002
REF 2240105
+2/+8
C

MagnaLIA ВИЧ Аг/Ат



Состав набора:

Калибратор -	5 фл.
Калибратор + Вич-1	5 фл.

ТУ 21.20.23-498-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA ВИЧ Аг/Ат»

LOT E002

2020-06-15

REF 2240105

2021-06-15

IVD



+2/+8
C



Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.




Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA ВИЧ Аг/Ат»


Маркировка первичной
упаковки

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР-БИО

Комплектация 2
Кат № № 2240105

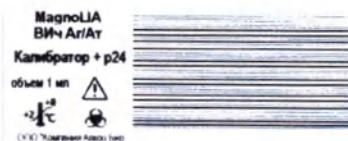

- 5 шт.

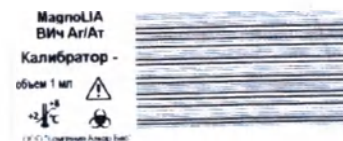

- 5 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 5 (ксеро) лист 28

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Д.Г. Полынцев