

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»
Т.А. Носова


_____ 2021 г.




ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 2759786
КУСАЙЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия:

Набор калибраторов для количественного определения инсулина (Insulin Calibrators / Insulin CAL) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), Китай

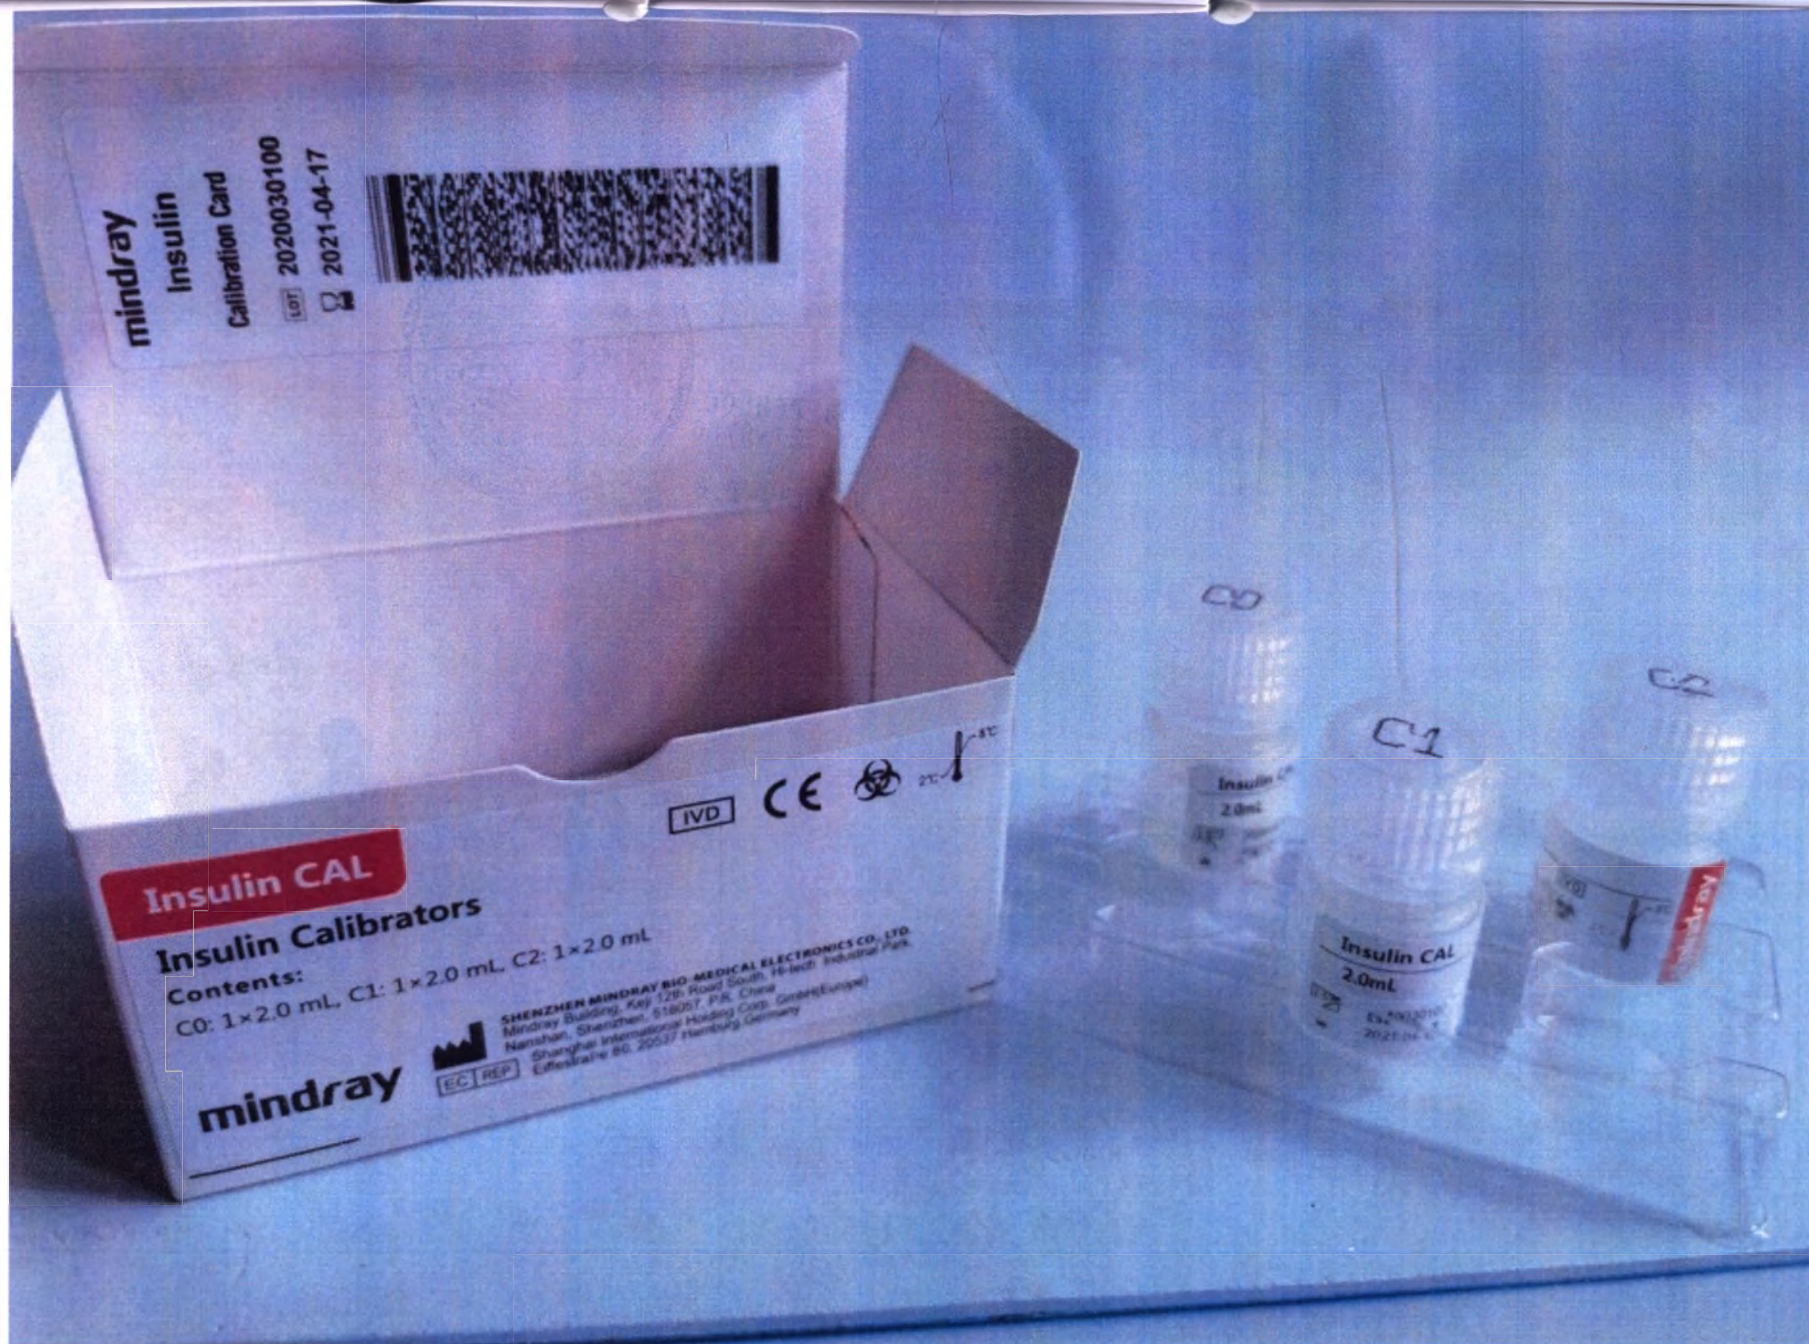

Общий вид медицинского изделия (Набор калибраторов для количественного определения инсулина (Insulin Calibrators / Insulin CAL) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 2 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 2759786

ПАСИЛО Р.В.

