


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:


Проводник Comet II для определения давления в коронарных сосудах: длина проводника 185 см, диаметр проводника 0,014 дюймов (0,36 мм), в комплекте с устройством для вращения




Общий вид МИ «Проводник Comet II для определения давления в коронарных сосудах: длина проводника 185 см, диаметр проводника 0,014 дюймов (0,36 мм), в комплекте с устройством для вращения»

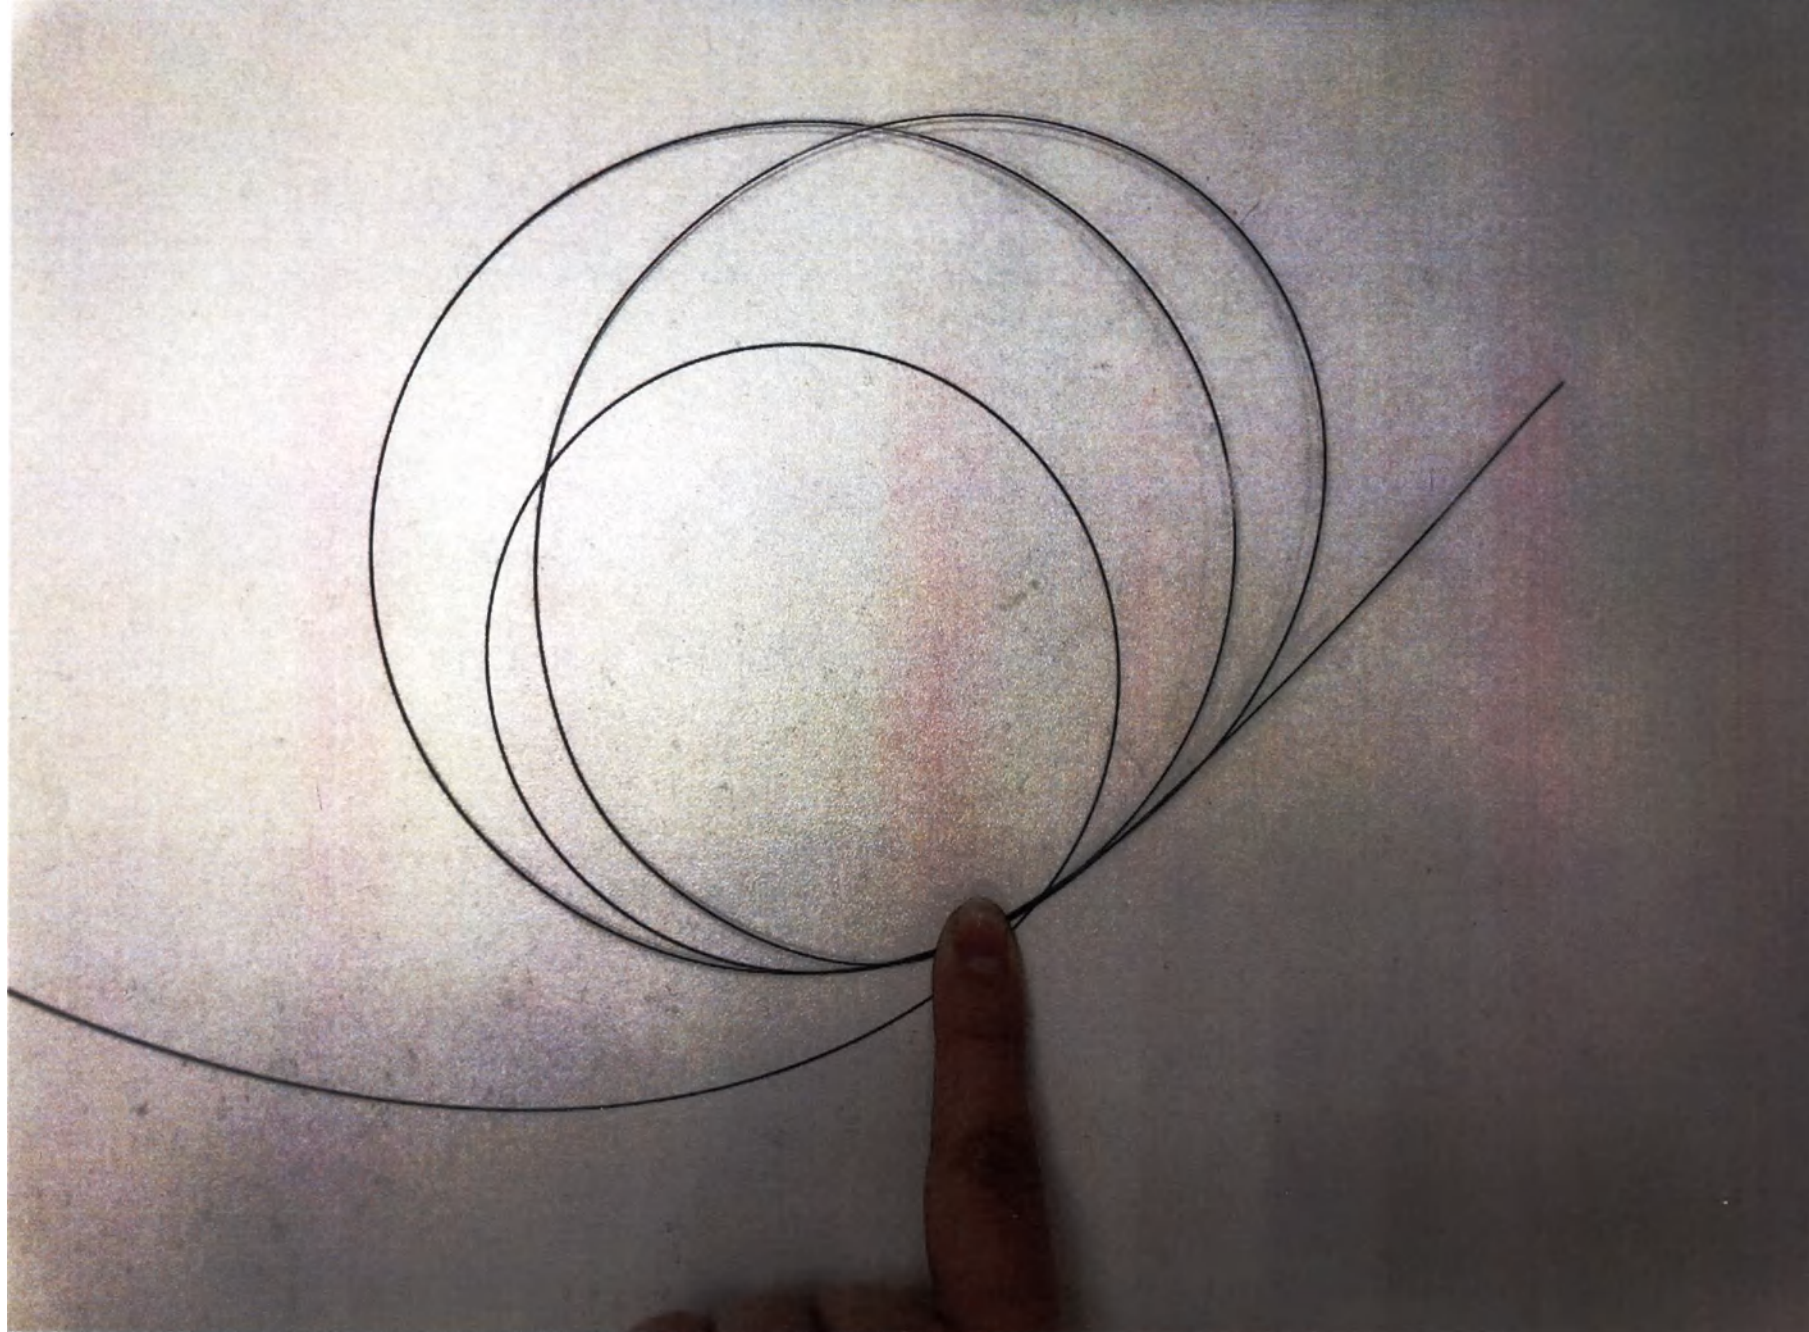

Проводник для определения давления (состоит из дистальной трубки с прорезями, проксимальной трубки и дистального кончика)

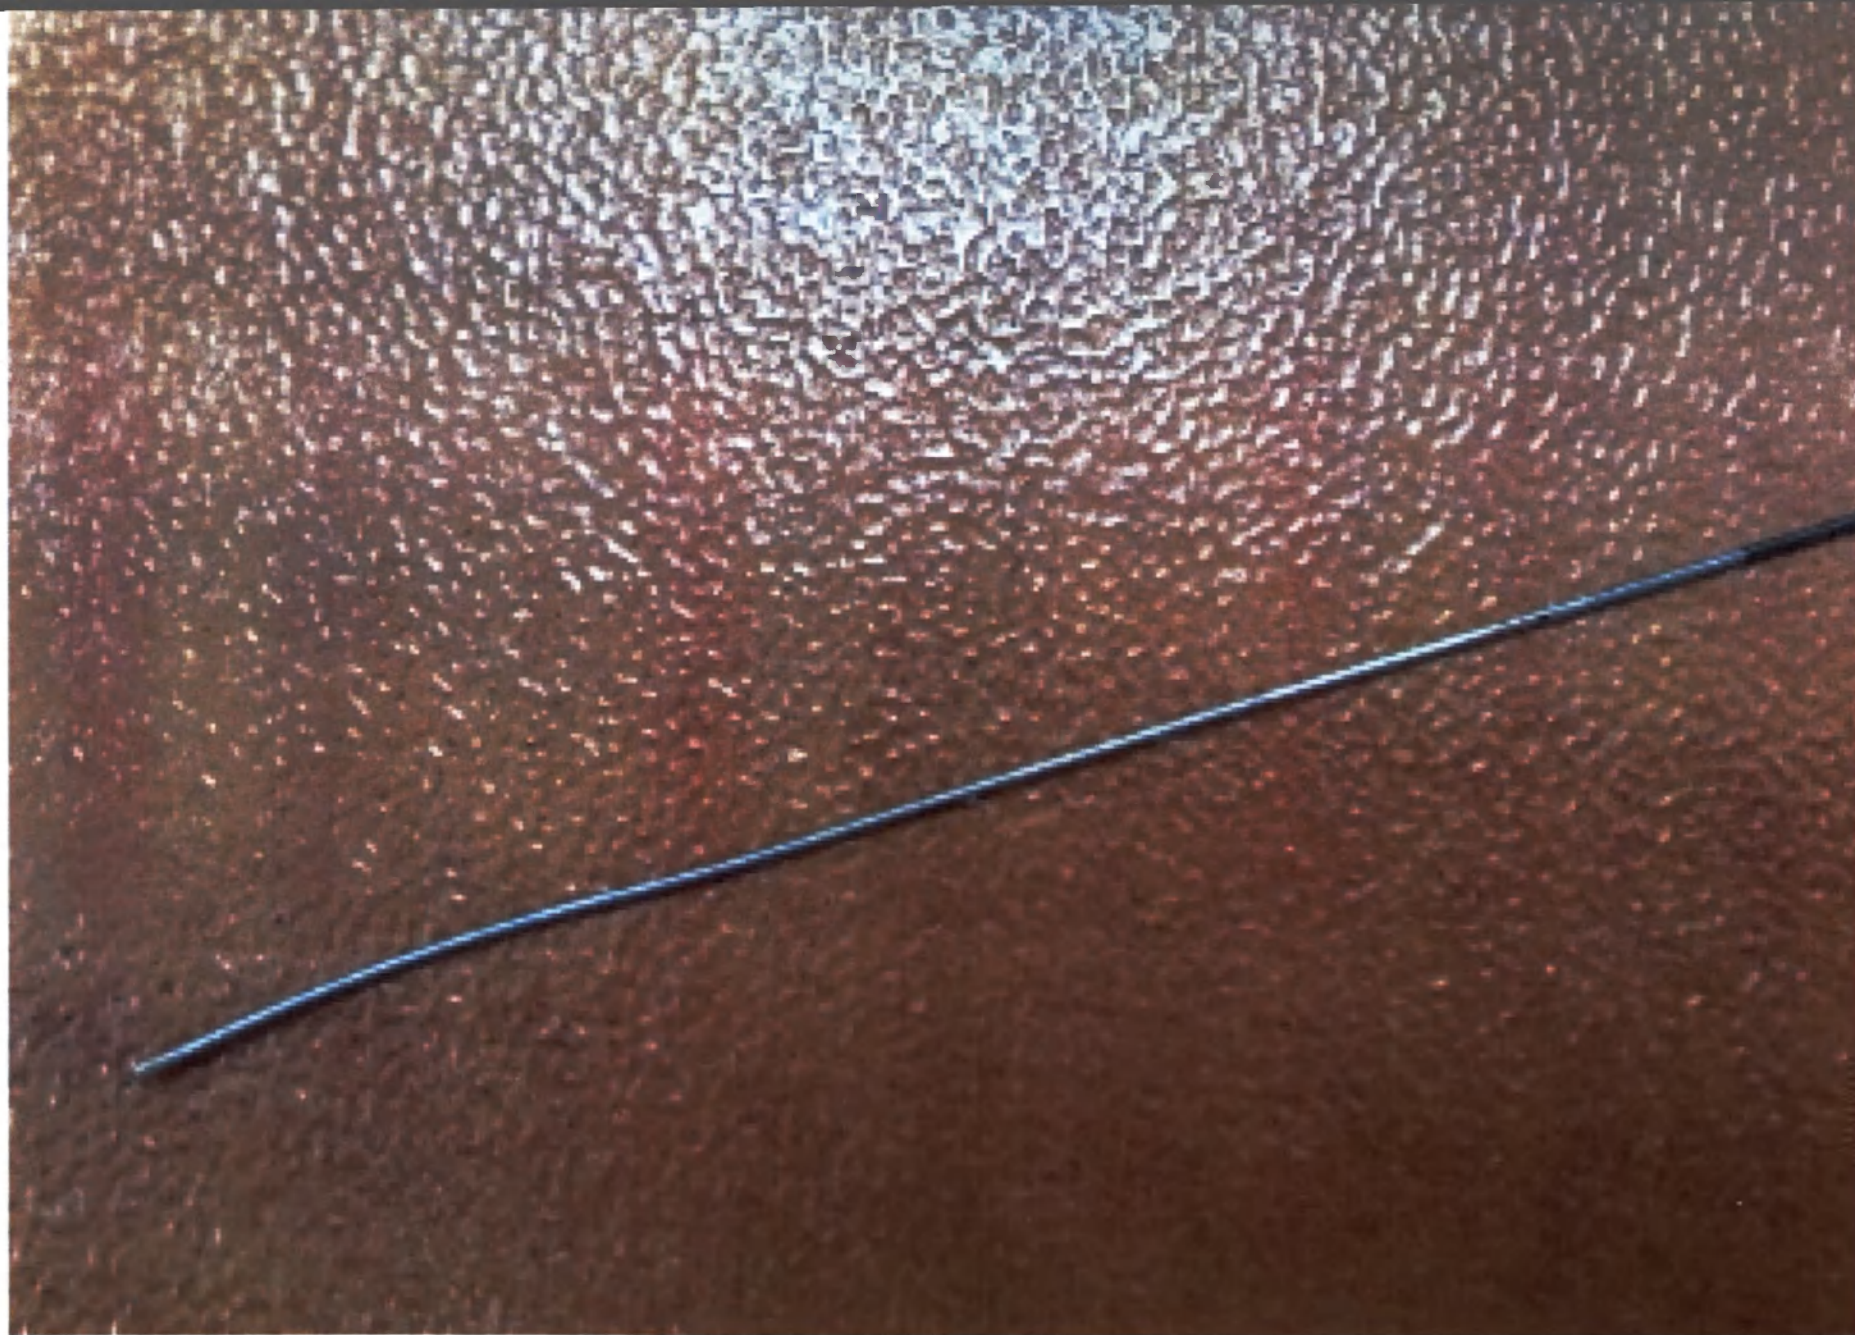

Дистальный кончик

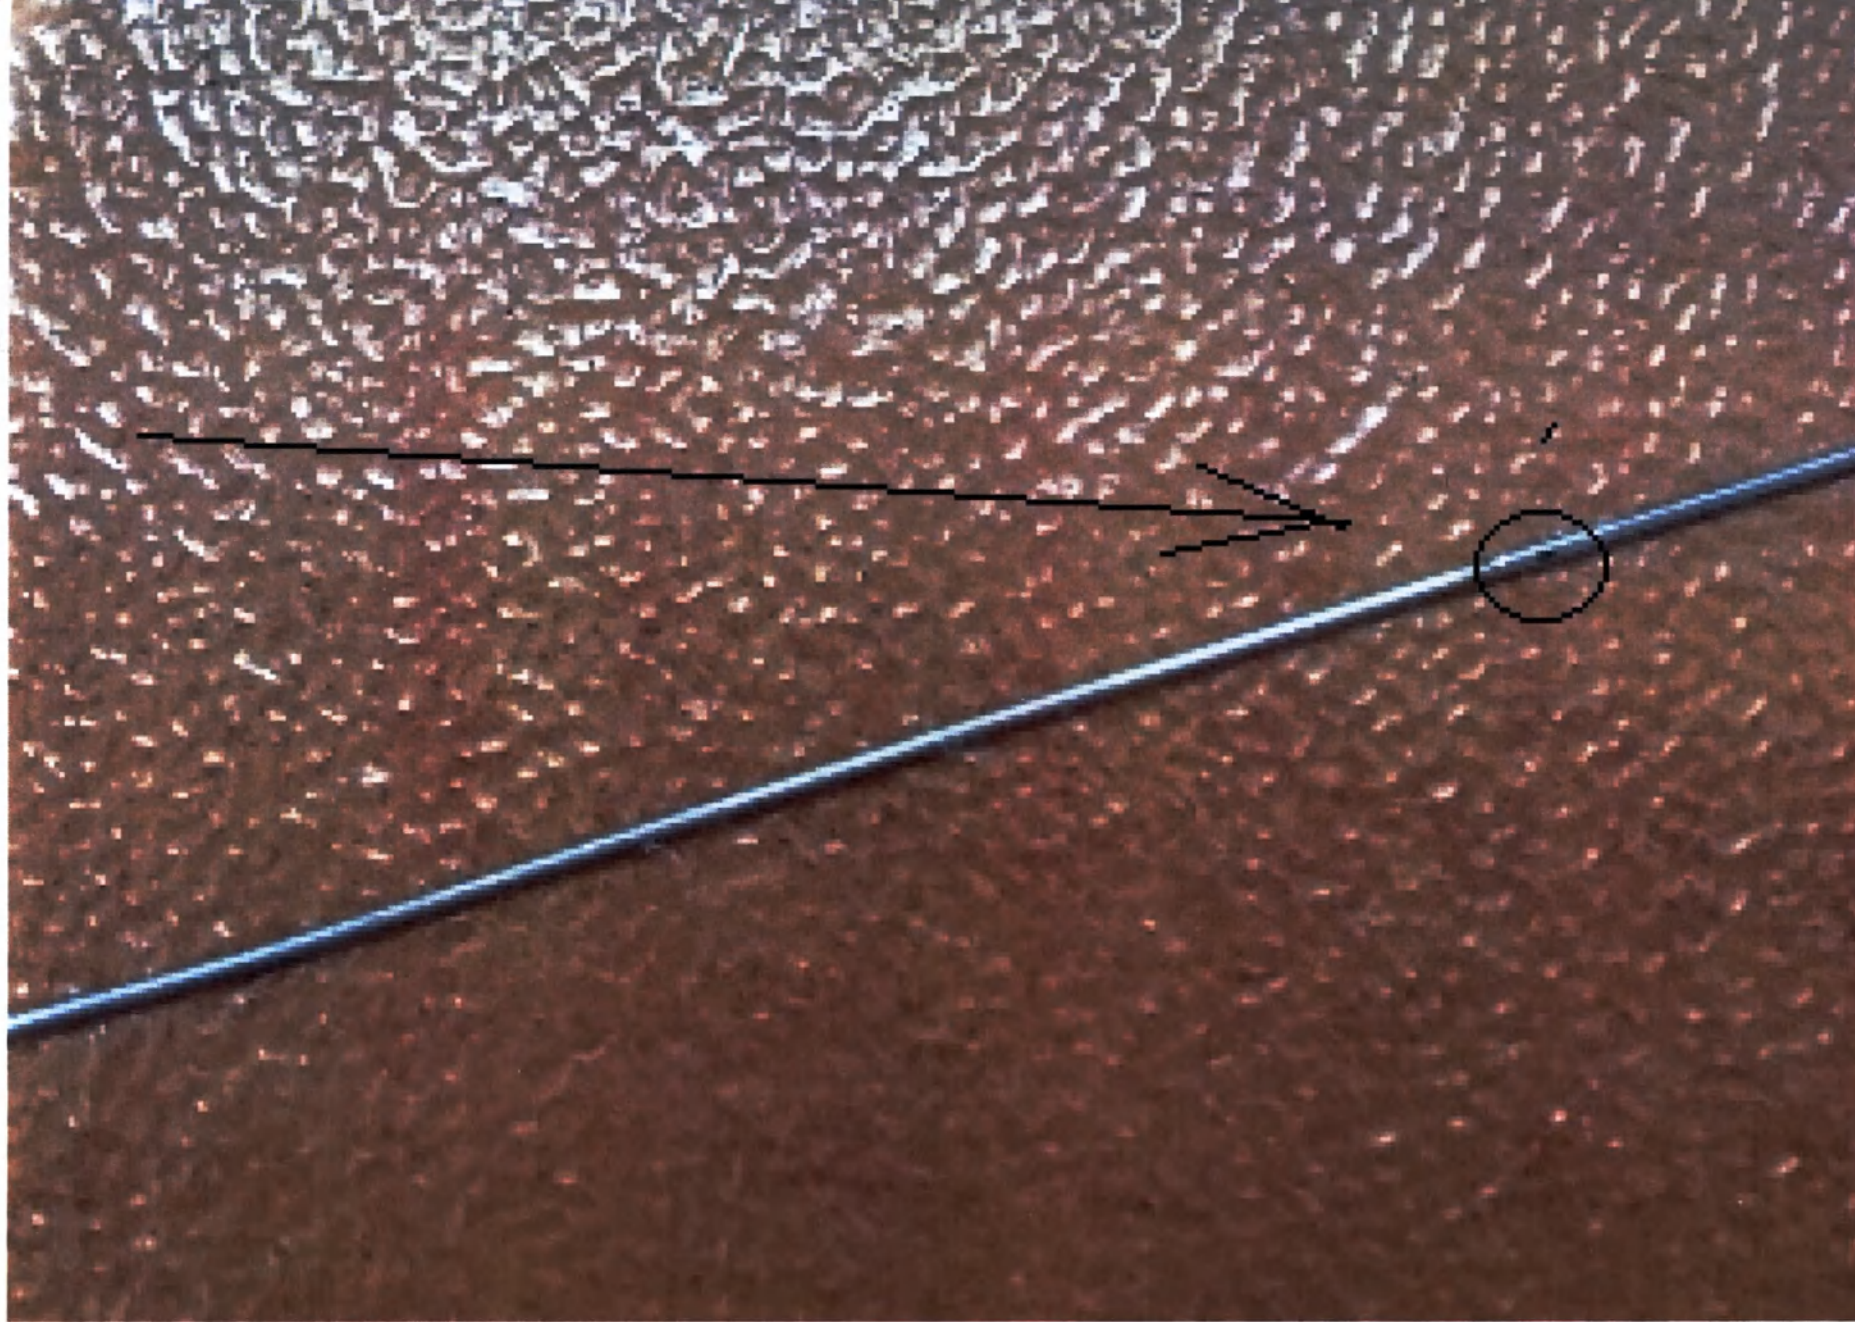


Оптический датчик давления (находится на проводнике для определения давления)




Брахиальная и феморальная отметки (находятся на проводнике для определения давления)



Оптический соединительный кабель в сборе (состоит из кабеля, рукоятки и кожуха), принадлежащий МИ «Проводник Comet II для определения давления в коронарных сосудах»

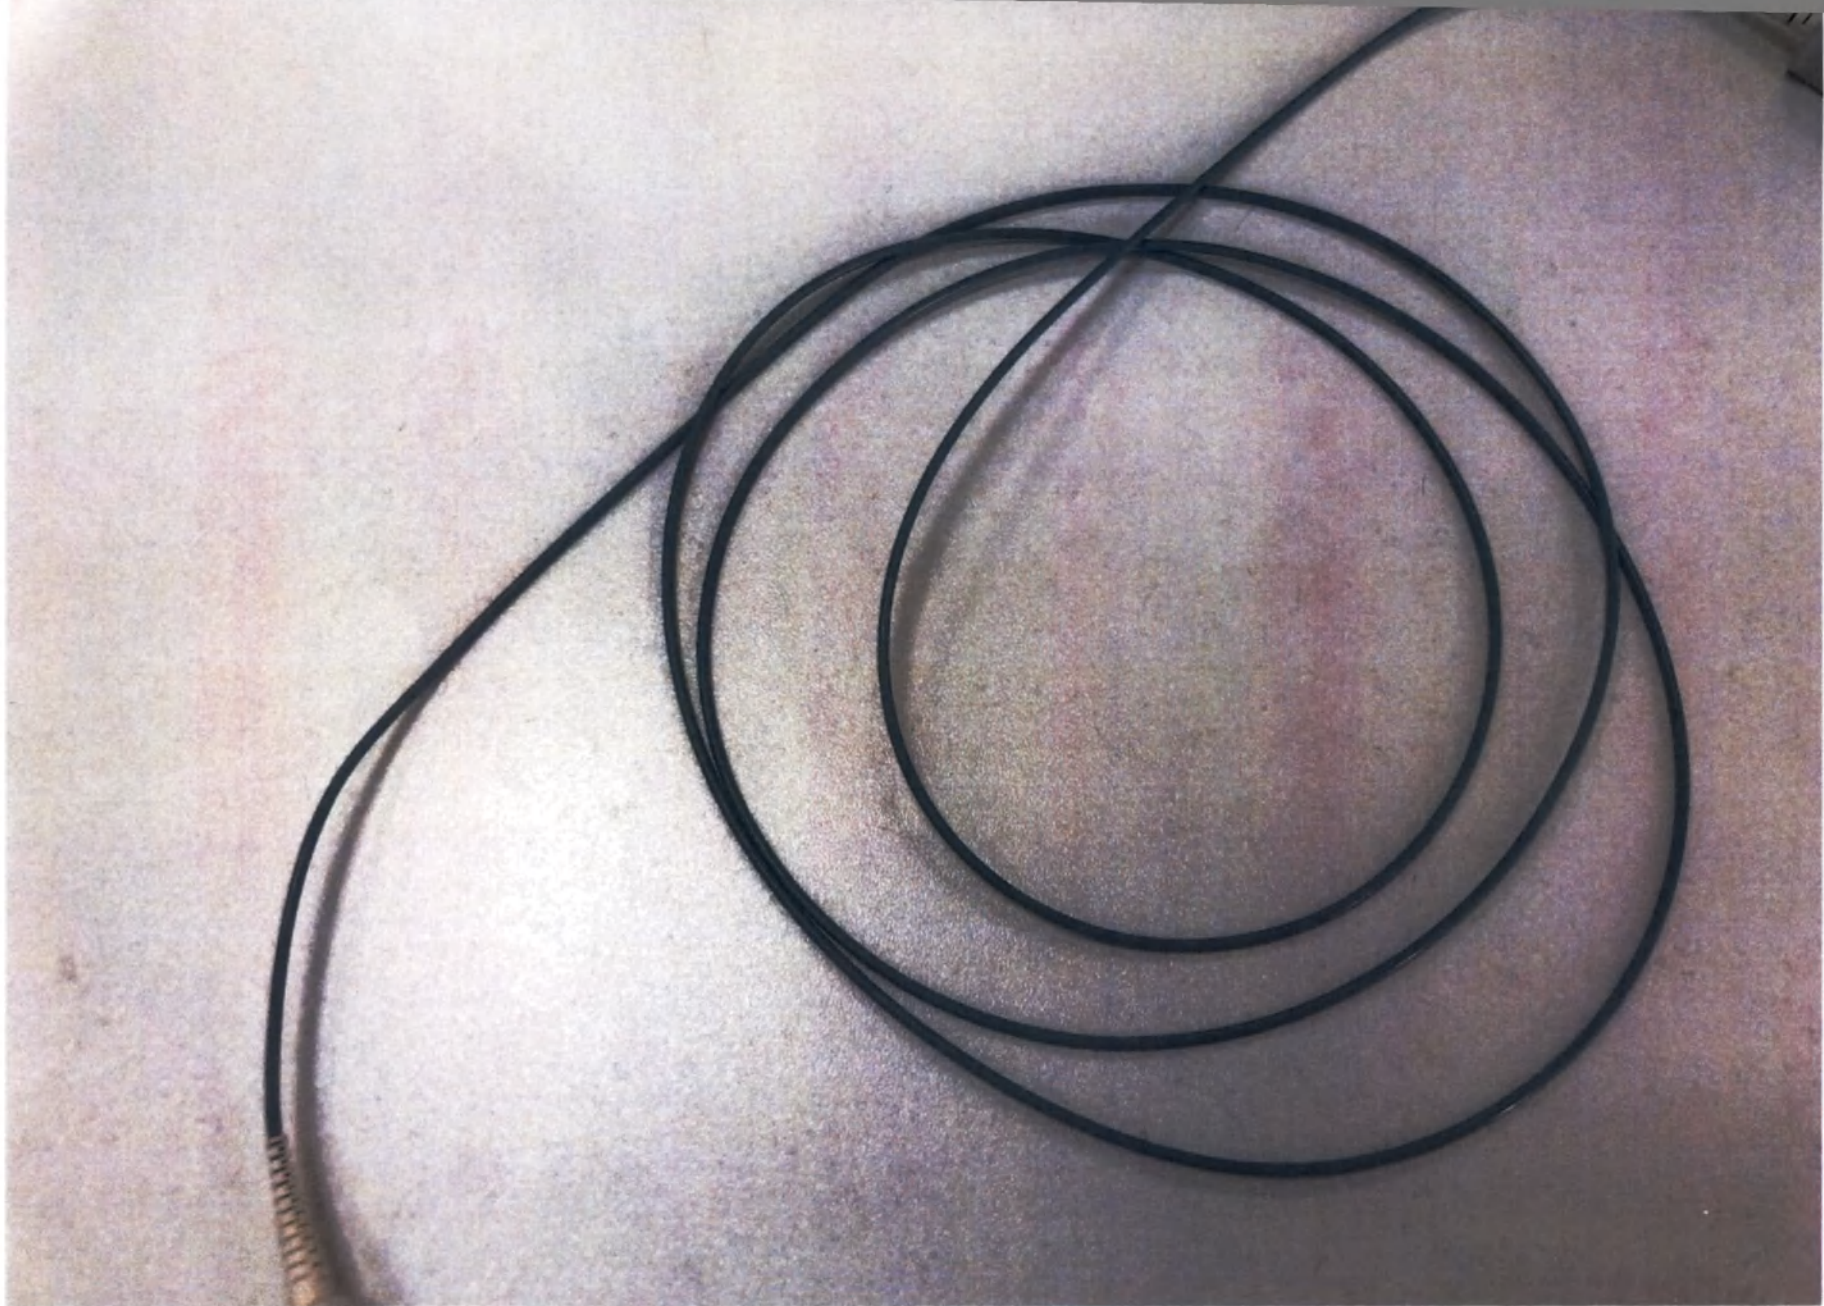


Кабель

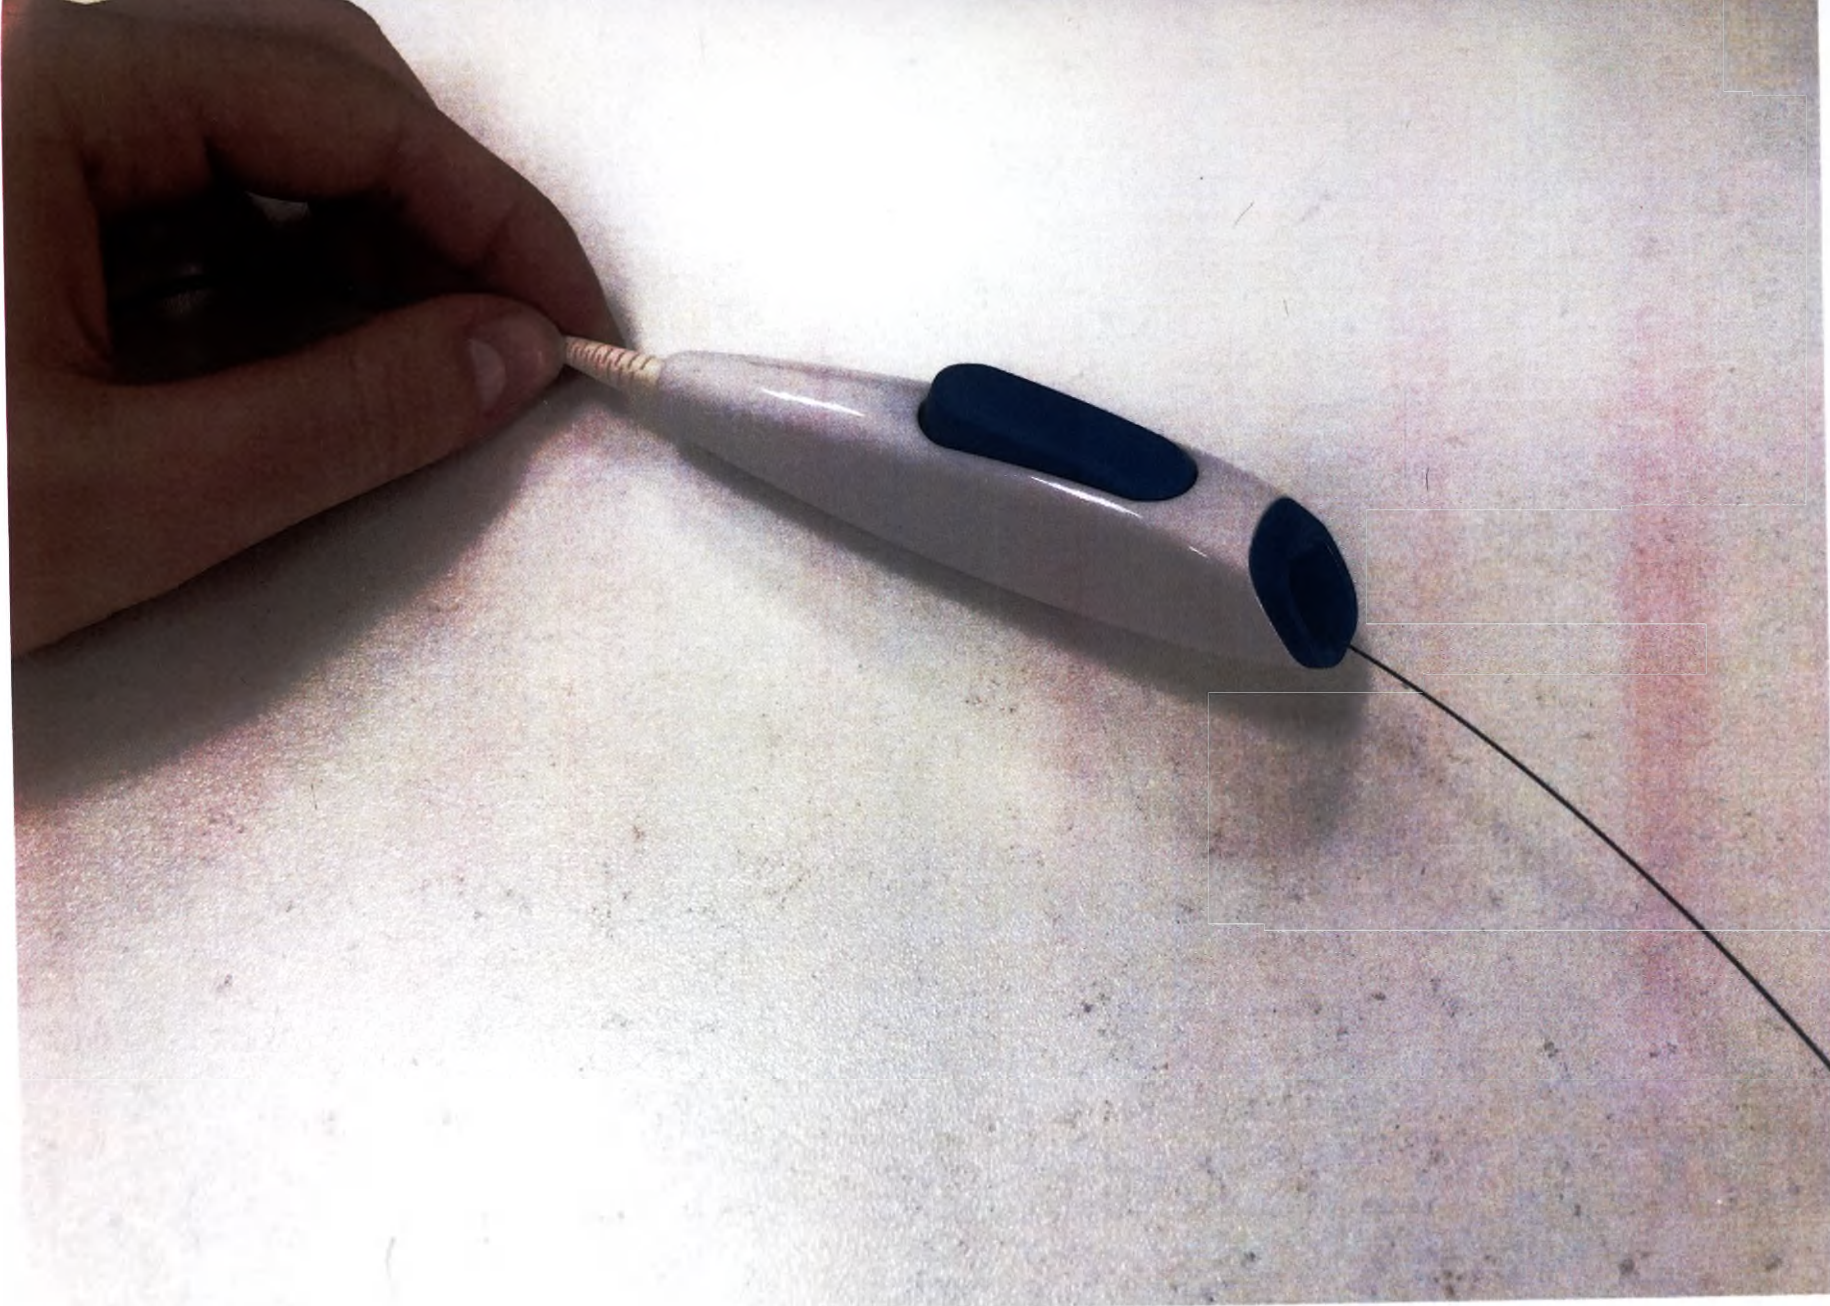

Рукоятка



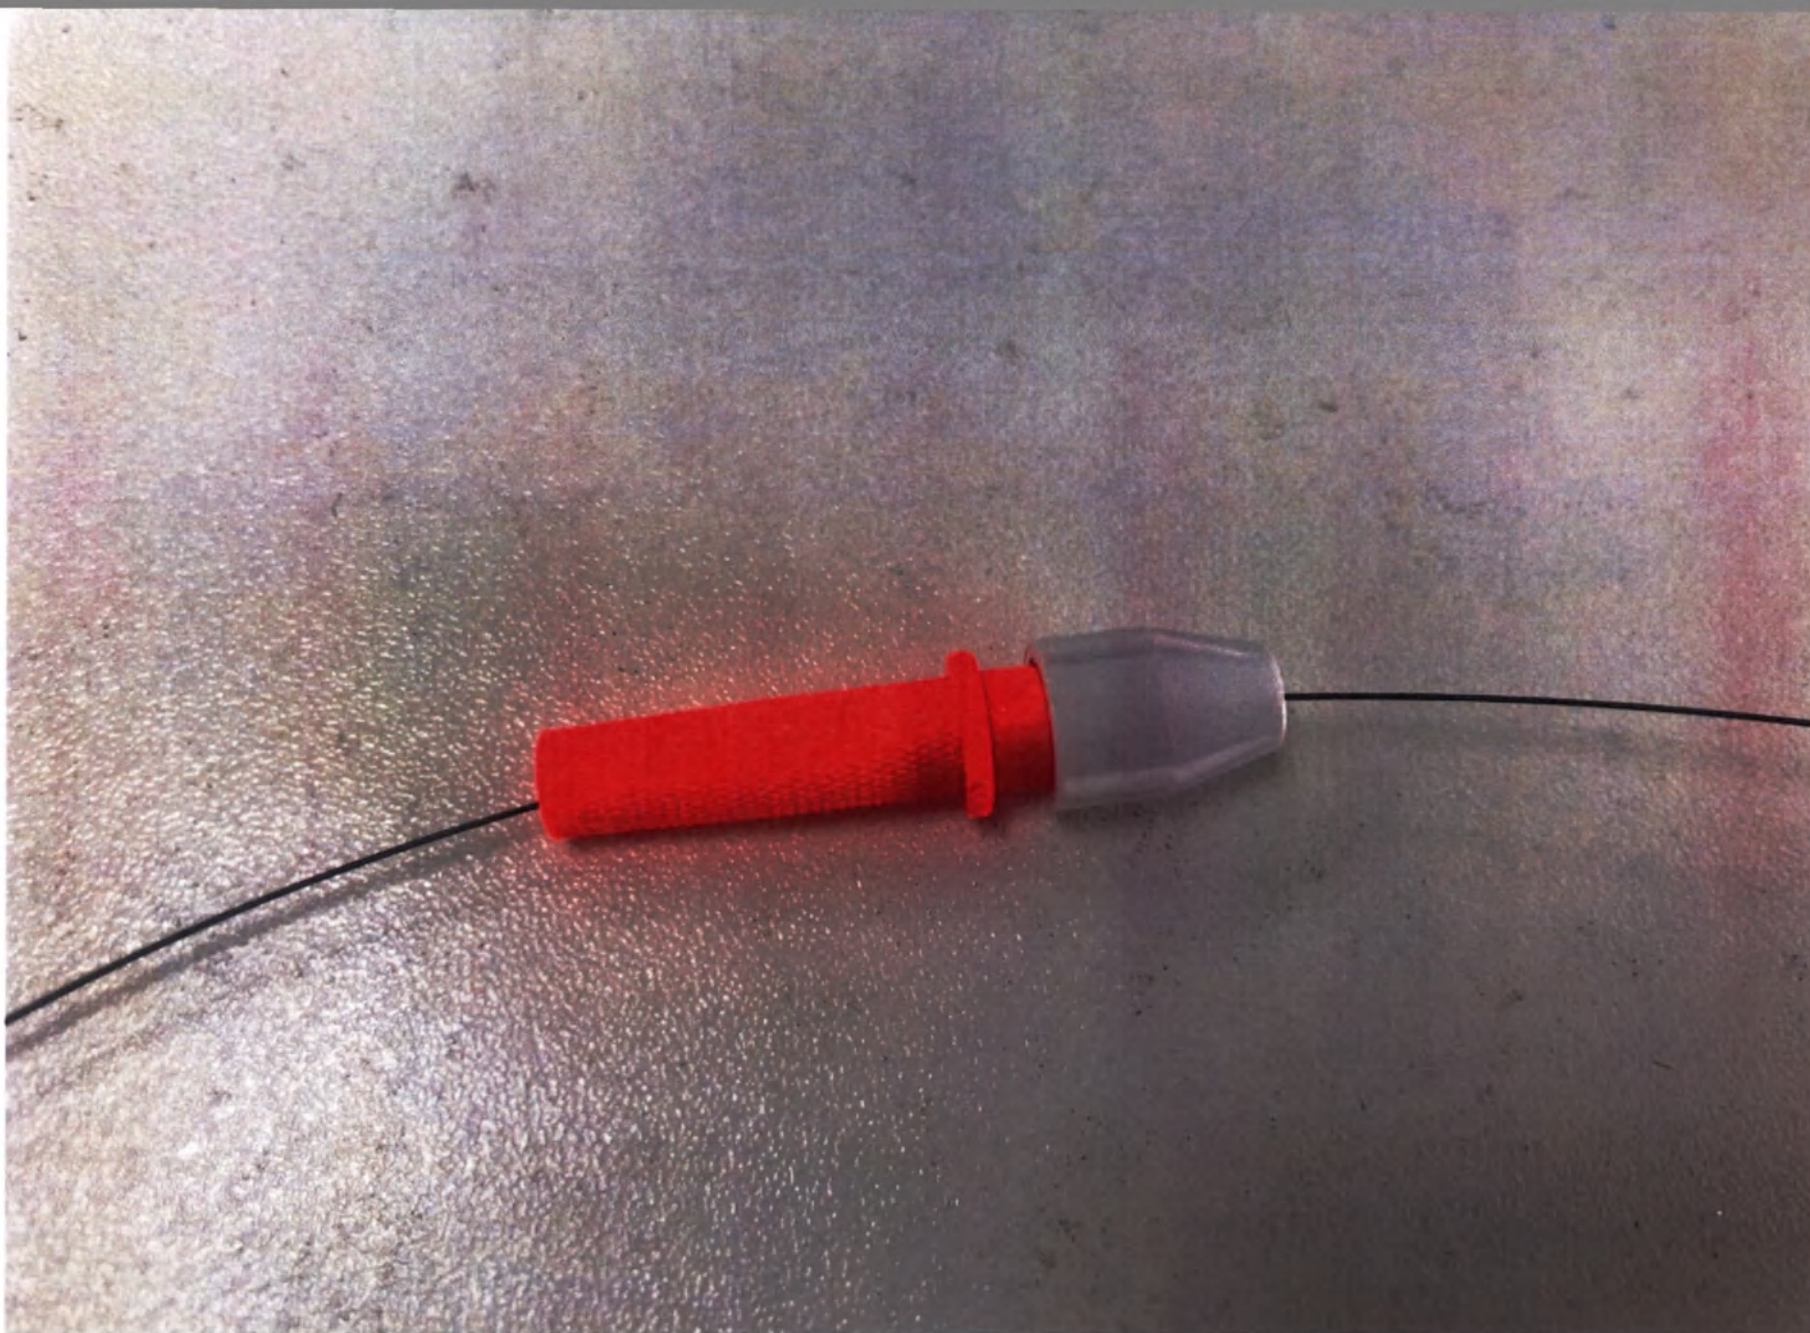

Устройство для вращения, принадлежащее МИ «Проводнику Comet II для определения давления в коронарных сосудах»



Защитная трубка



Зажим защитной трубки с двумя отделениями



Зажимы защитной трубки с тремя отделениями



Зажим-держатель рукоятки



Заглушка




Соединители защитной трубки




Лоток с закреплёнными в нём компонентами МИ «Проводник Comet II для определения давления в коронарных сосудах», закрытый крышкой лотка



Лоток (слева) и крышка лотка (справа)

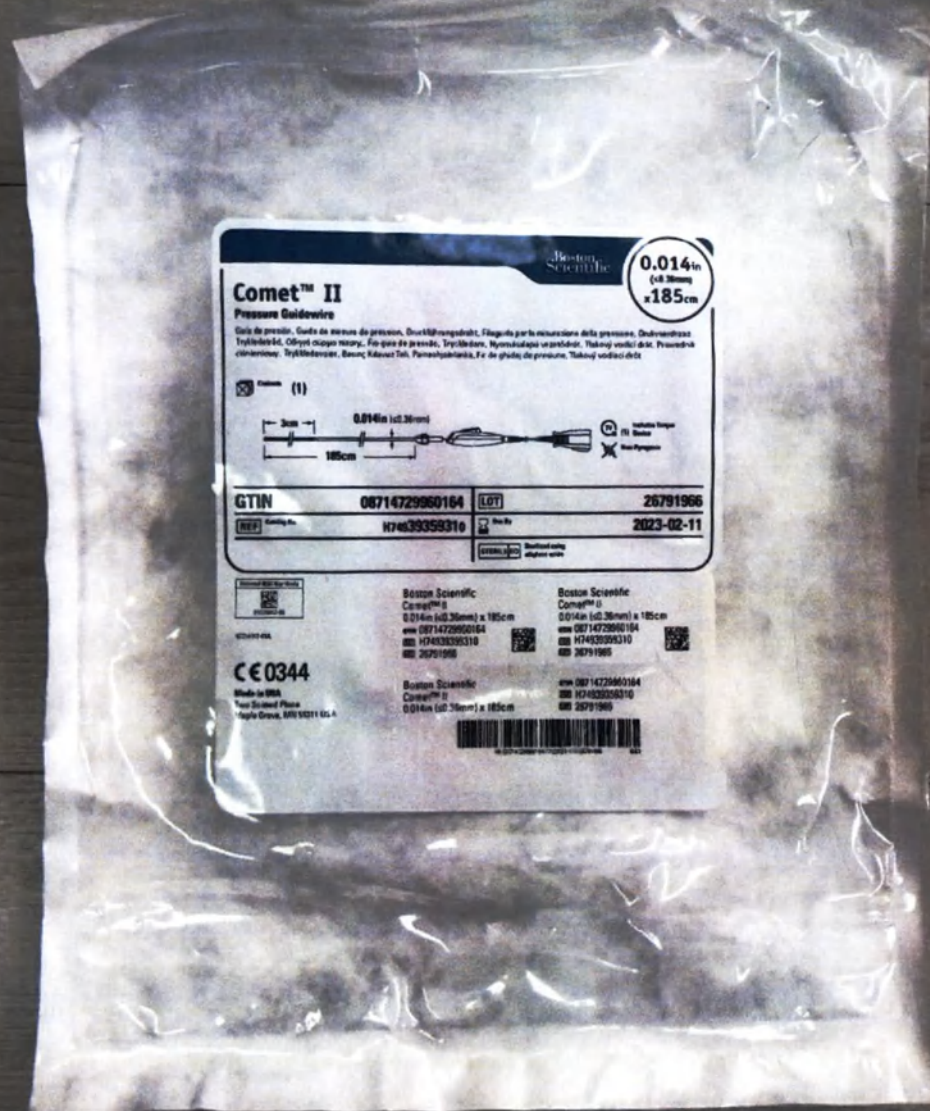

Запечатываемый пакет, вид спереди.

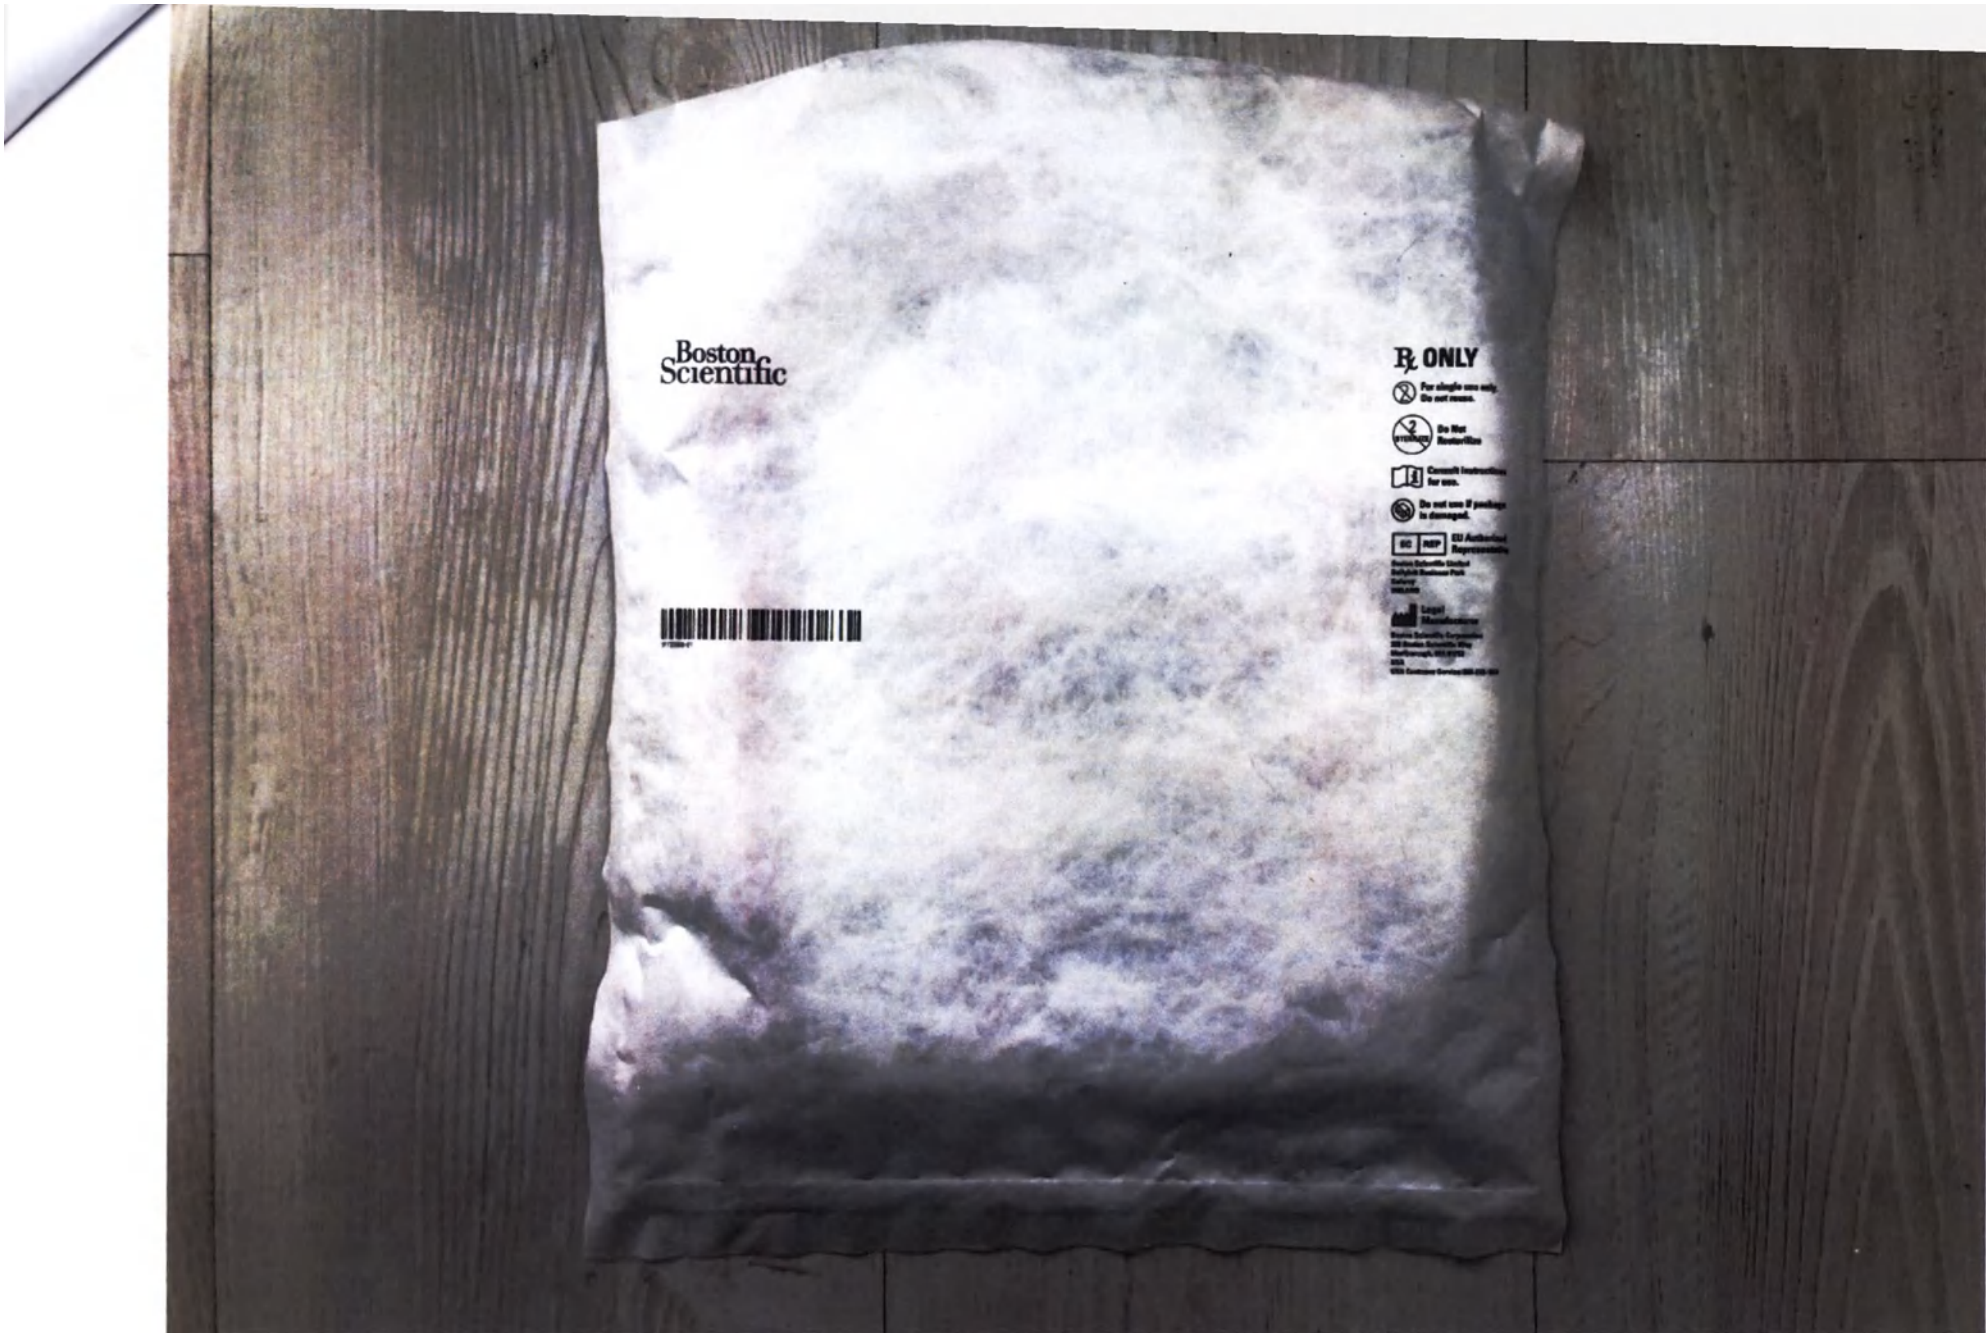

Запечатываемый пакет; вид сзади.



Коробка Проводника Comet II для определения давления в коронарных сосудах: вид спереди.



Коробка Проводника Comet II для определения давления в коронарных сосудах: вид снизу.

Comet™ II

Pressure Guidewire

Guia de presión, Guide de mesure de pression, Druckführungsdraht, Filoguida per la misurazione della pressione, Drukvoerdraad, Trykledetråd, Ođnyvó súþýja málarný, Fio-guia de pressão, Trykklédare, Nyomásalápoló vezetődórt, Tlakový vodící drát, Prowadnik ciśnieniowy, Trykklédavaier, Basınc Kılavuz Telii, Paineohjainlanka, Fir de ghidaj de presiune, Tlakový vodící drát

0.014in
(s0.36mm)
x185cm

Contents (1)



GTIN	08714729960164	LOT	26791966	REF	Catalog No.	H74939359310
Use By	2023-02-11	STERILE	EO	EO	EO	EO

CE 0344

Made in USA
Two Scimed Place
Maple Grove, MN 55311 USA

Boston Scientific
Comet™ II
0.014in (s0.36mm) x 185cm
etm 08714729960164
H74939359310
26791966

Boston Scientific
Comet™ II
0.014in (s0.36mm) x 185cm
etm 08714729960164
H74939359310
26791966

Boston Scientific
Comet™ II
0.014in (s0.36mm) x 185cm

etm 08714729960164
H74939359310
26791966



8524074 01A



0108714729960164 17230211102879 988

881

Проводник Comet II для определения давления в коронарных сосудах: длина проводника 185 см, диаметр проводника 0,014 дюймов (0,36 мм), в комплекте с устройством для вращения

Регистрационное удостоверение № 07

Производитель: Бостон Сайентифик Корпорейшн, 300 Бостон Сайентифик Уэй, Мальборо, Массачусетс 01752, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «РК», 119334, г. Москва, проезд Лонской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49, +7(495) 633-70-63
Негтоксично



Этикетка и маркировка на русском языке на коробке проводника Comet II для определения давления в коронарных сосудах; LOT 26791966



Pressure Guidewire

Gula de presi6n, Gula de m6sur6 de presi6n, Druckf6hlergebr6uch, F6ng6 de presi6n, Gula de presi6n, Druckventil, Tryckled6rd, Of6ng6sl6pp kl6ng, F6ng6 de presi6n, Tryckled6rd, Nymanstapli ventild6rd, T6k6ngi v6g6li d6rd, Pres6ng6sl6pp kl6ng, Tryckled6rd, B6ng6 kl6v6r T6ll, P6im6npan6nta, F6r de g6ld6 de presi6n, Gula de presi6n

Exercises (1)



GTIN	08714729060164	LQT	25791963	REP	Country No	774000000000000000
-------------	----------------	------------	----------	------------	------------	--------------------

2023-02-11

C € 0344

Made in USA
Two Screened Pairs
Made in USA

Boston Scientific
Comet™ II
0.014in (0.26mm) x 185cm
www.28174372980164
800-474-9339/353210
575-2879-1963

Boston Scientific
Comet™ II
0.014in (x) 2.6mm x 185cm

800-368-4772
800-368-4772
800-368-4772

Проводник Comet II для определения давления в коронарных сосудах: длина проводника 185 см, диаметр проводника 0,014 дюймов (0,36 мм), в комплекте с устройством для вращения

Регистрационный удостоверение № 61

Приведены: Boston Scientific Corporation, 300
Boston Scientific Way, Marlboro, Massachusetts 01752,
USA.

Уполномоченный представлять на территории РФ: ООО «РК»,
140034, г. Москва, проезд Ломоносов 3-0, д. 15, этаж 3, почтовый ящик
№ 10, т. (495) 613-70-63

Коробка Проводника Comet II для определения давления в коронарных сосудах: вид сзади; LOT 26791963; с маркировкой на русском языке

ASAHI INTECC

Comet™ II


Pressure Guidewire

Directions for Use	2
Instrucciones de uso	7
Mode d'emploi	12
Gebrauchsanweisung	17
Istruzioni per l'uso	22
Gebruiksaanwijzing	27
Instruções de Utilização	32


Инструкция по применению Проводника Comet II для определения давления в коронарных сосудах: вид спереди.




Boston Scientific Limited
Ballybrink Business Park
Galway
IRELAND





Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1435
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 636 686



Para obtener información de
contacto de Boston Scientific
Argentina SA, por favor, acceda al
sitio www.bostonscientific.com/arg



Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 800-272-1801



CE 0344

© 2019 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.

2019-09



50536046-01

Инструкция по применению Проводника Comet II для определения давления в коронарных сосудах: вид сзади.

Генеральный директор
Шевчук Е.В.

ПРОШУ
ПРОНУМЕРОВАТЬ
29 ЛИСТОВ

