

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Электрод для системы стимуляции блуждающего нерва
VNS Therapy с принадлежностями**

Генеральный директор
ООО «Сорин Групп Рус»
_____ Сорокин Г.В.

М.П.



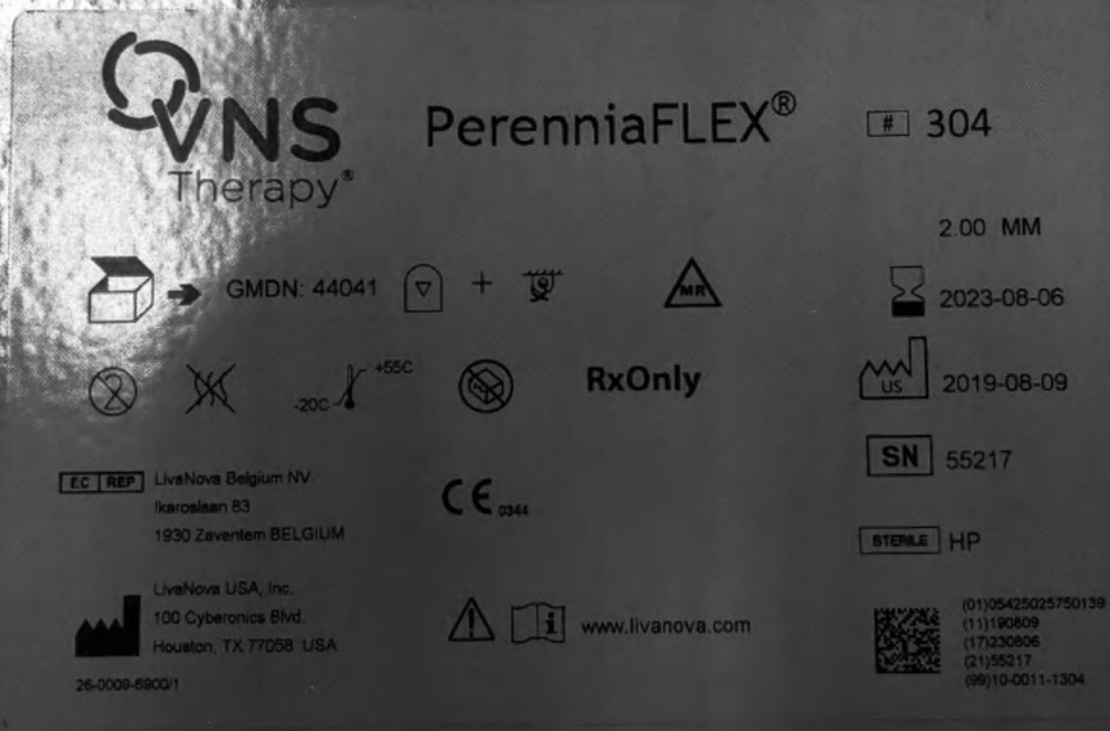


Рис. 1. Электрод для системы стимуляции блуждающего нерва VNS Therapy

Вторичная (потребительская) упаковка
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рис. 2. Электрод для системы стимуляции блуждающего нерва VNS Therapy

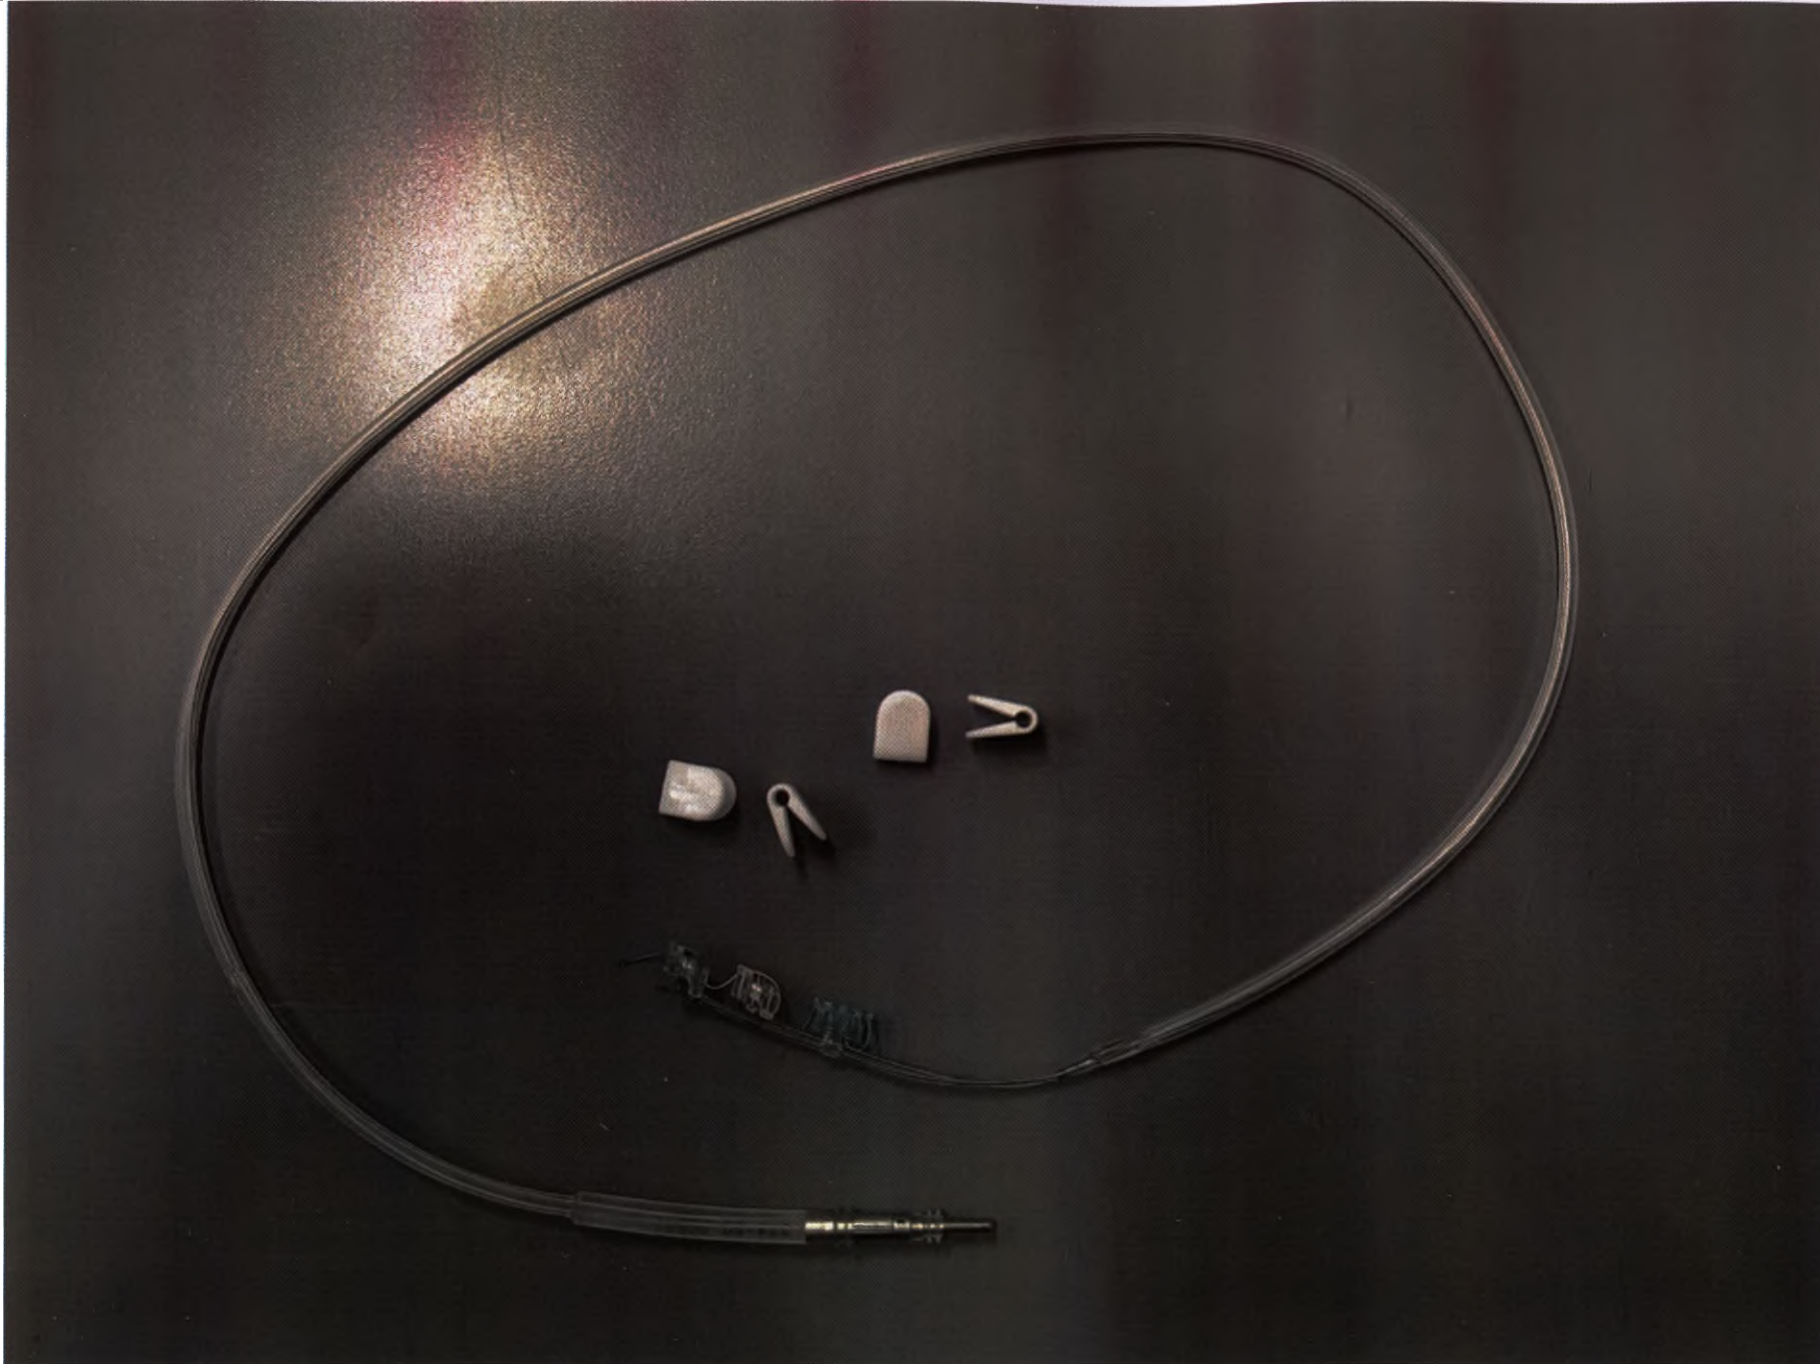


Рис. 3. Электрод для системы стимуляции блуждающего нерва VNS Therapy


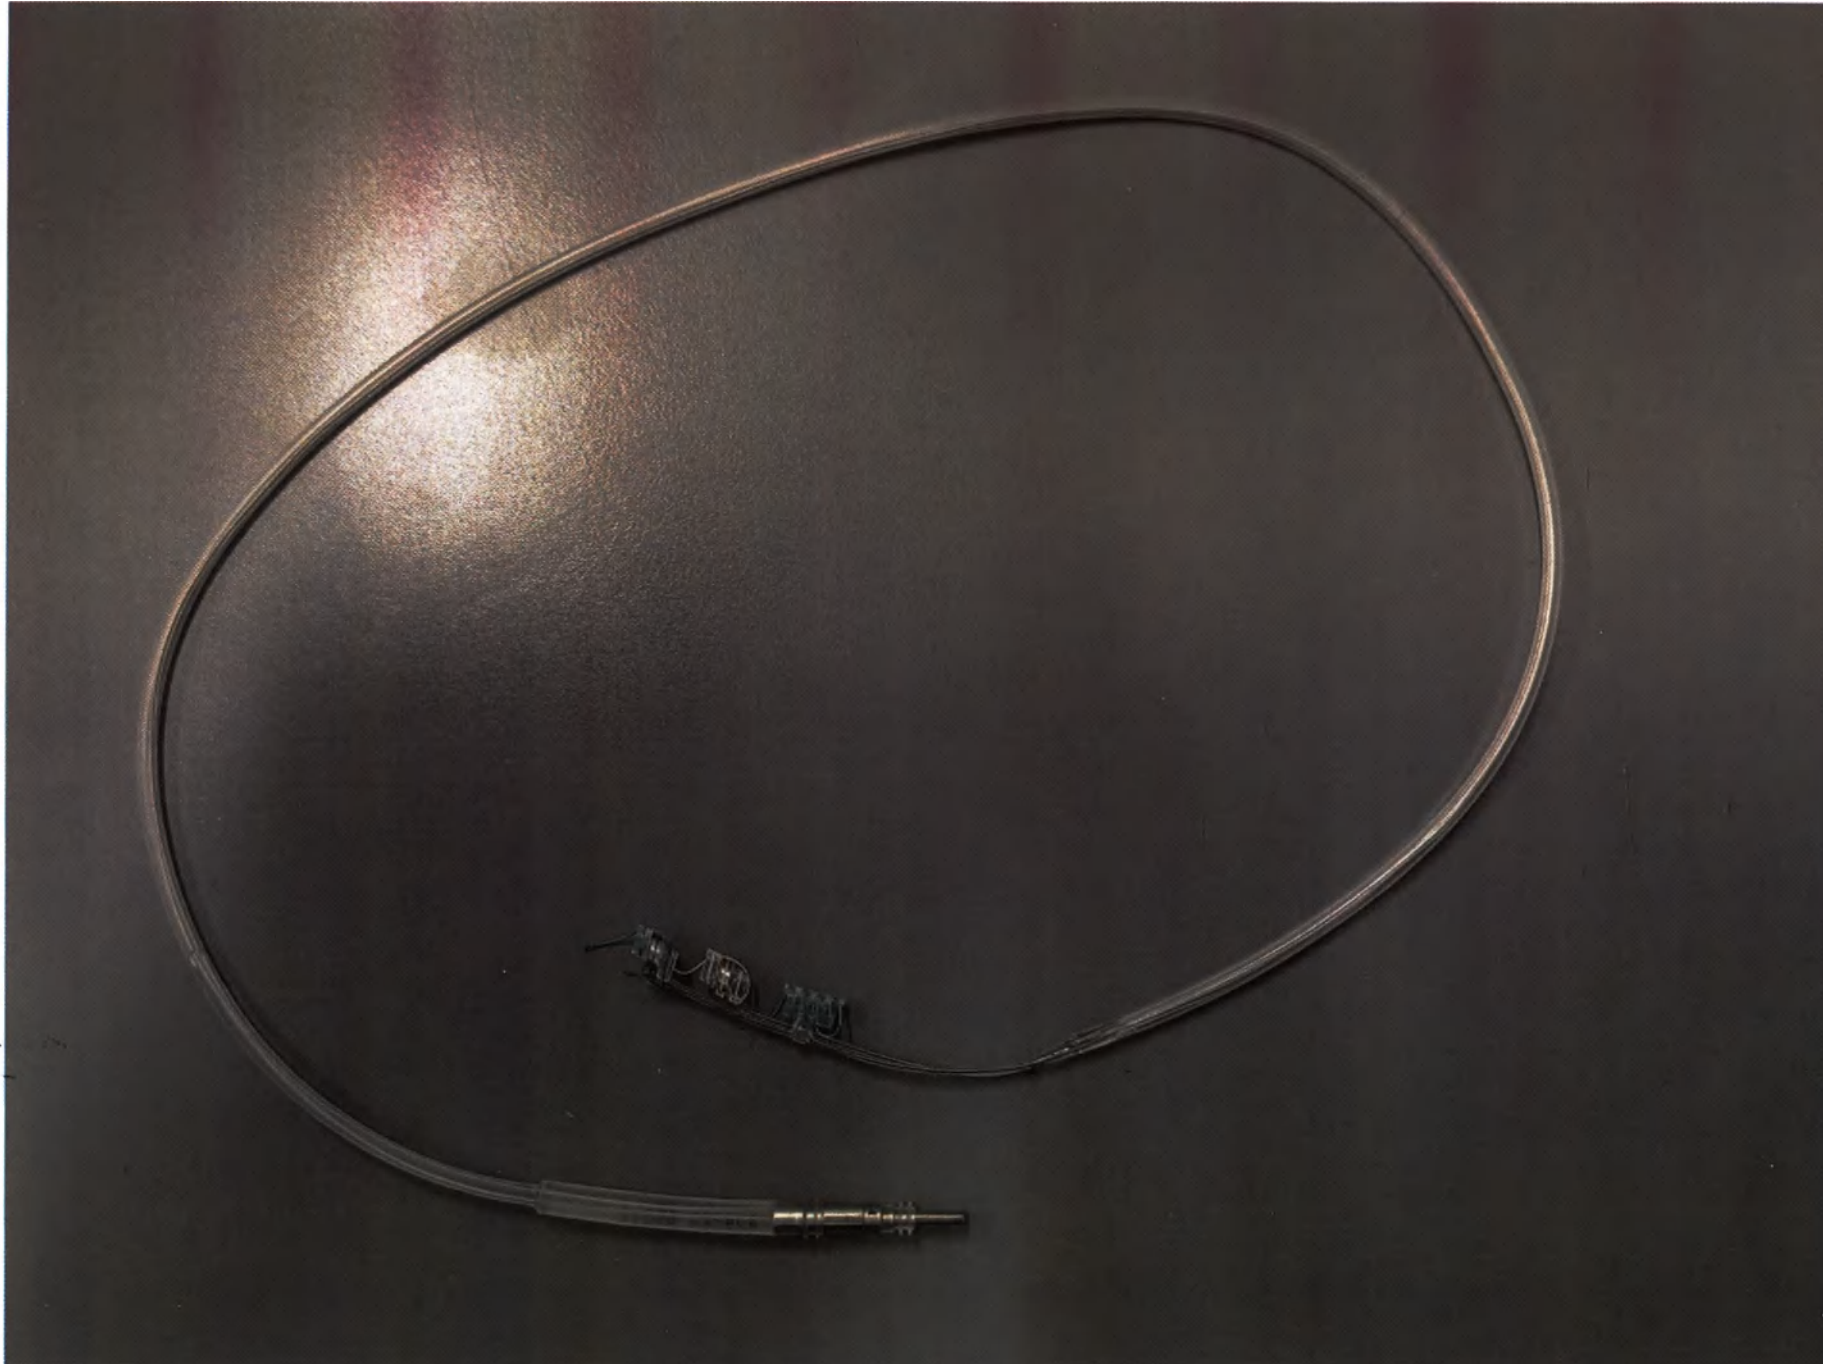


Рис. 4. Электрод для системы стимуляции блуждающего нерва VNS Therapy

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru внутренний диаметр: 2 мм – 1 шт.



Рис. 5. Электрод для системы стимуляции блуждающего нерва VNS Therapy



Руководство врача по системе VNS Therapy

Данное руководство включает в себя инструкцию по применению:

Генератор импульсов имплантируемый для системы стимуляции блуждающего нерва VNS Therapy с принадлежностями

Электрод для системы стимуляции блуждающего нерва VNS Therapy с принадлежностями

Инструкция применяется к следующим моделям генератора импульсов:

Генератор Pulse – Модель 102

Генератор Pulse Duo – Модель 102R

Генератор Demipulse – Модель 103

Генератор Demipulse Duo – Модель 104

Генератор AspireHC – Модель 105

Генератор импульсов Aspire SR - модель 106

Генератор SenTiva – Model 1000

Инструкция применяется к следующим моделям электрода:

Электрод – Модель 302

Электрод PerenniaFLEX – Модель 304

Электрод PerenniaDURA – Модель 303

Для медицинских работников

Май 2019 г.

Версия для применения за пределами США

Только по предписанию врача



www.livavova.com

Руководство врача по системе VNS Therapy
76-0000-5100/2 (за пределами США)

76-0000-5100/2 (за пределами США)

Рис. 6. Электрод для системы стимуляции блуждающего нерва VNS Therapy

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU (ИД вид), конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствии с документом в регистрационном досье – 1 шт.



Рис. 7. Принадлежности:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 2 в составе: туннелизатор, инструкция по применению, доступная по ссылке или в бумажном виде
Вторичная (потребительская) упаковка



Рис. 8. Принадлежности:

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 2 в составе: туннелизатор, инструкция по применению, доступная по ссылке или в бумажном виде
Первичная упаковка



Рис. 9. Принадлежности:



Туннелизатор VNS Therapy
модель 402



Инструкция по применению

Для медицинских работников

Июнь 2017 г.

Только по предписанию врача

Версия не предназначена для США

2005 г.



Примечание: Настоящее руководство по применению содержит информацию о туннелизаторе модели 402 производства компании «ЛиваНова» (LivaNova). Врачам необходимо изучить руководство врача по генератору импульсов производства компании «ЛиваНова» для получения важной информации по назначению и безопасности.

Рис. 10. Принадлежности:
Туннелизатор VNS Therapy, модель 402:

1 ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 1 вид), конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствии с документом в регистрационном досье – 1 шт.

LivaNova
Health innovation that matters

HANDLE WITH CARE: CONTAINS MEDICAL DEVICES
TRATTARE CON CURA: CONTIENE MATERIALE SANITARIO



Рис. 11. Транспортная упаковка

Всего прошито и
скреплено печатью
12 (двенадцать) листов

