

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

« 28 » 07 2021 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 2759786


КУСАЙЛО Р.В.




Фотографические изображения изделия:

**Набор калибраторов для количественного определения нейронспецифической
енолазы (NSE Calibrators / (NSE CAL)) иммунохемилюминесцентным методом
в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro**

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. («Шэньчжэнь Майндрэй Био-
Медикал Электроникс Ко., Лтд.»), Китай

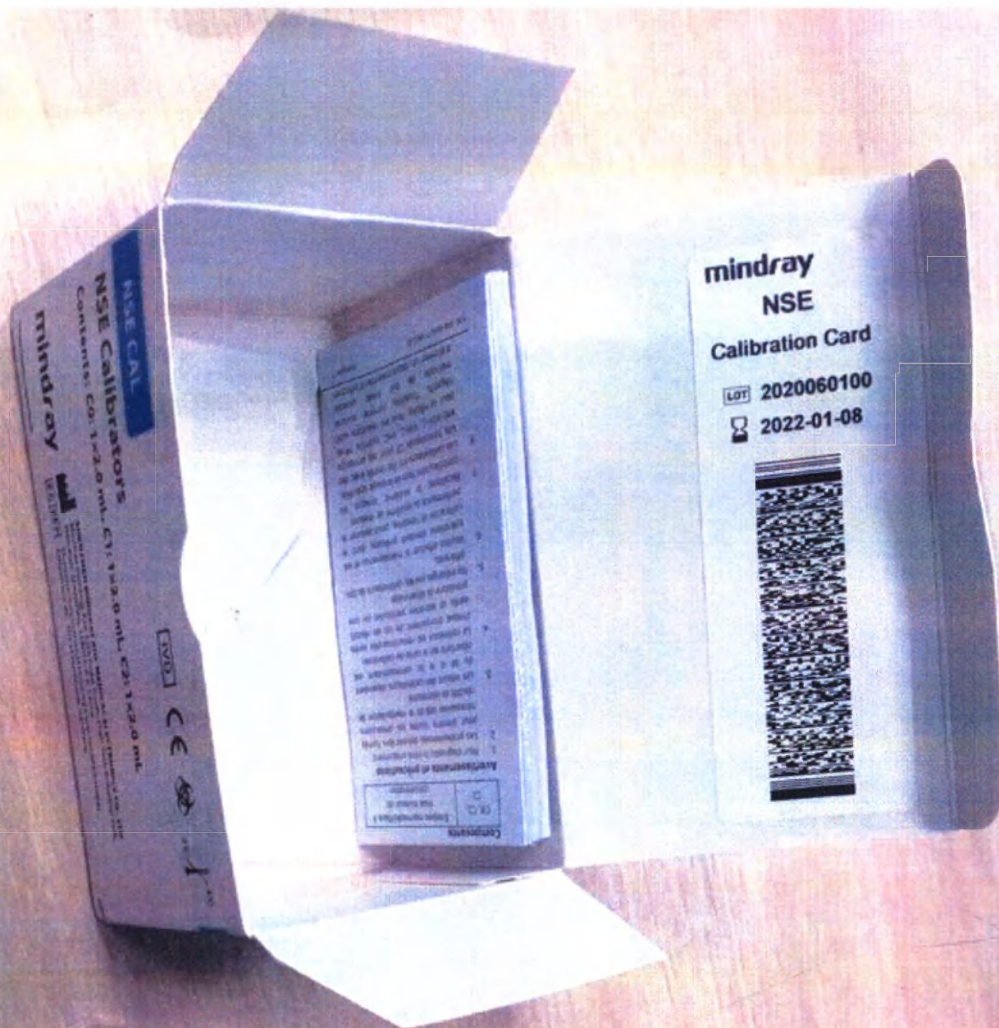

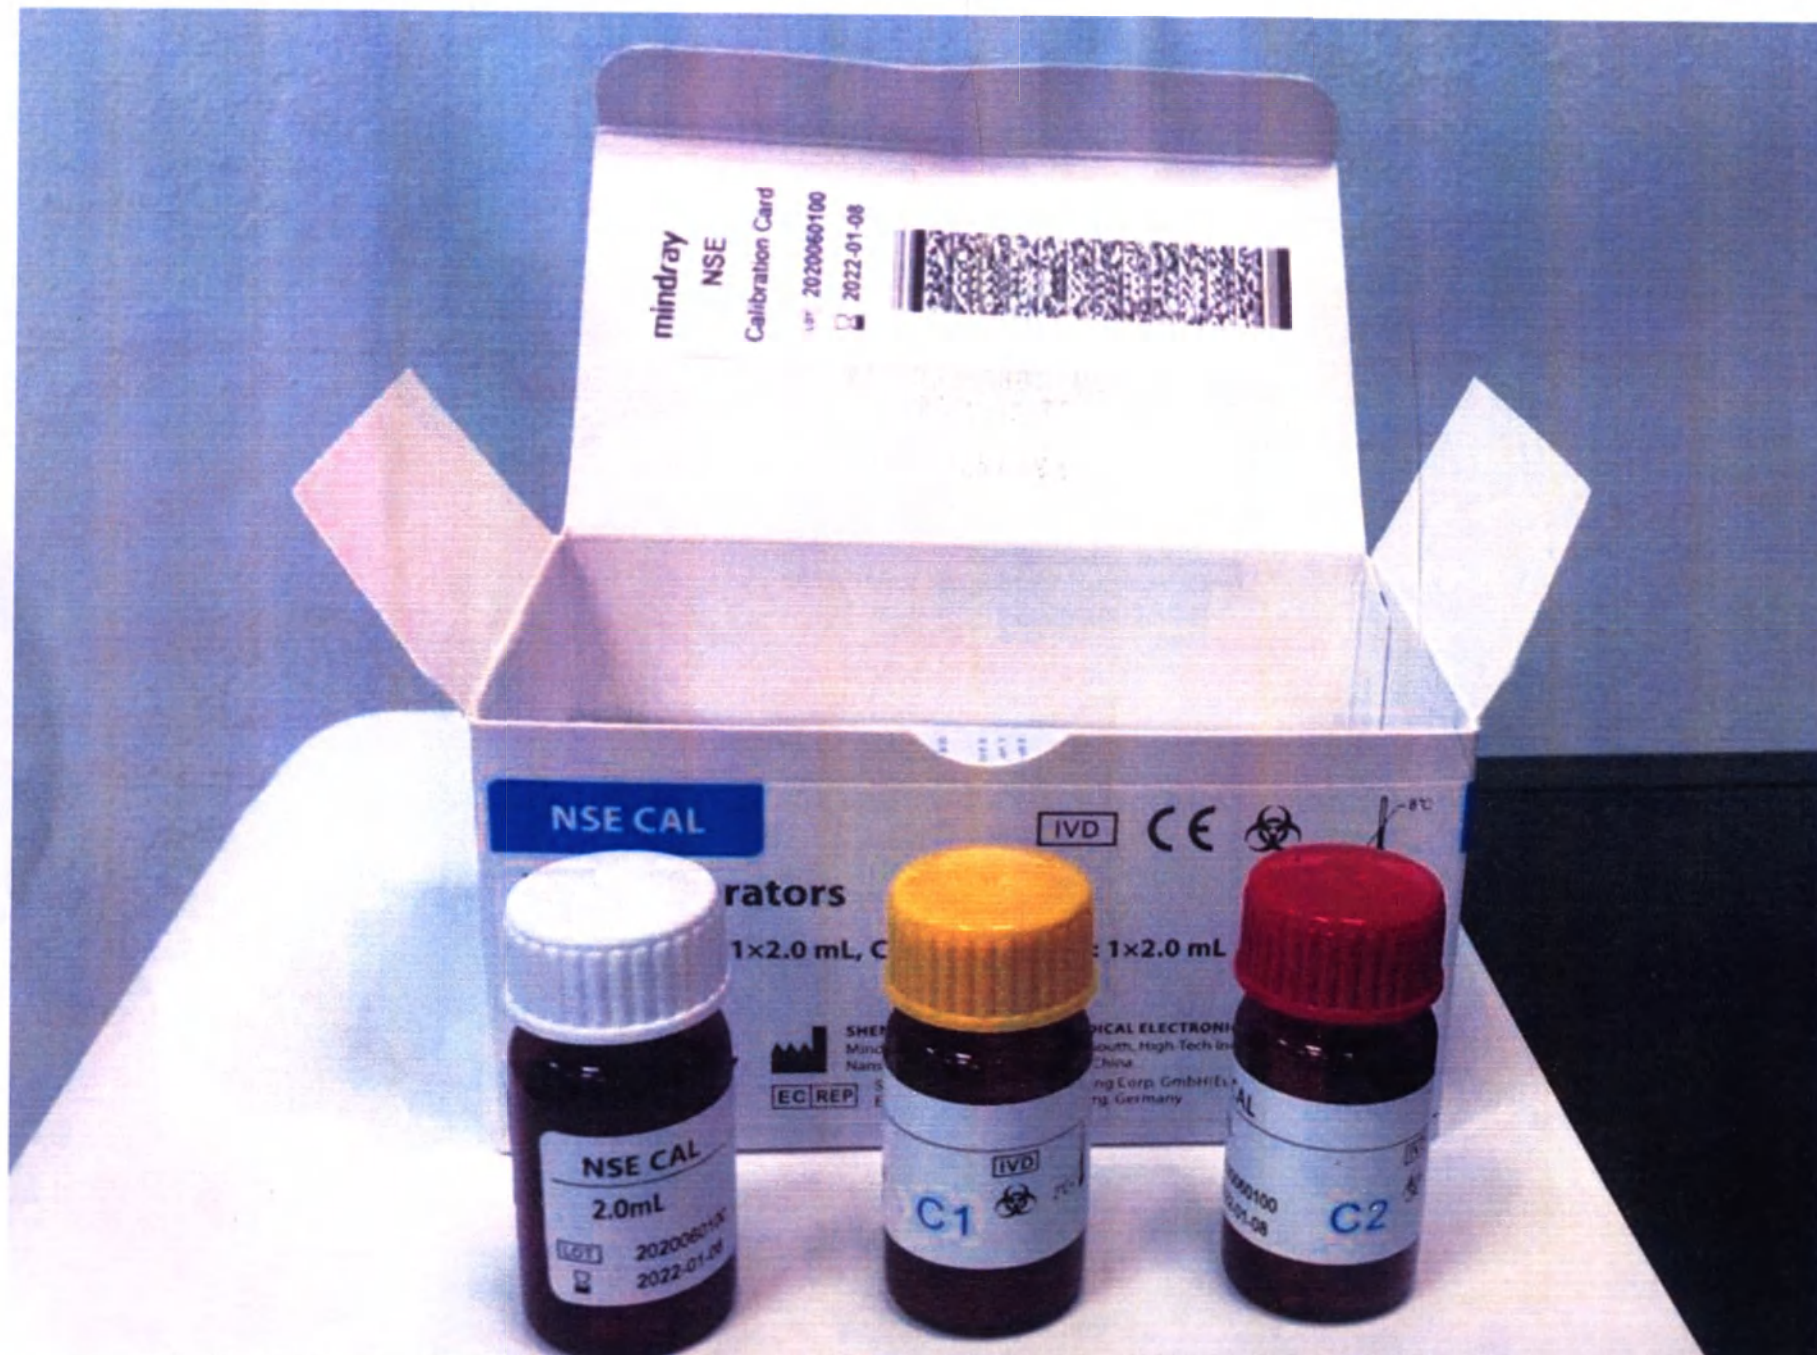

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 3 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 2759786
КУСАЙЛО Р.В.

