



**Фотографические изображения  
общего вида медицинского изделия**


**Набор реагентов in vitro для определения гормона, подавляющего  
развитие Миллеровых протоков (антимиллерово гормона) (Millerian-  
duct regression hormone (MRH/AMH) ELISA)**

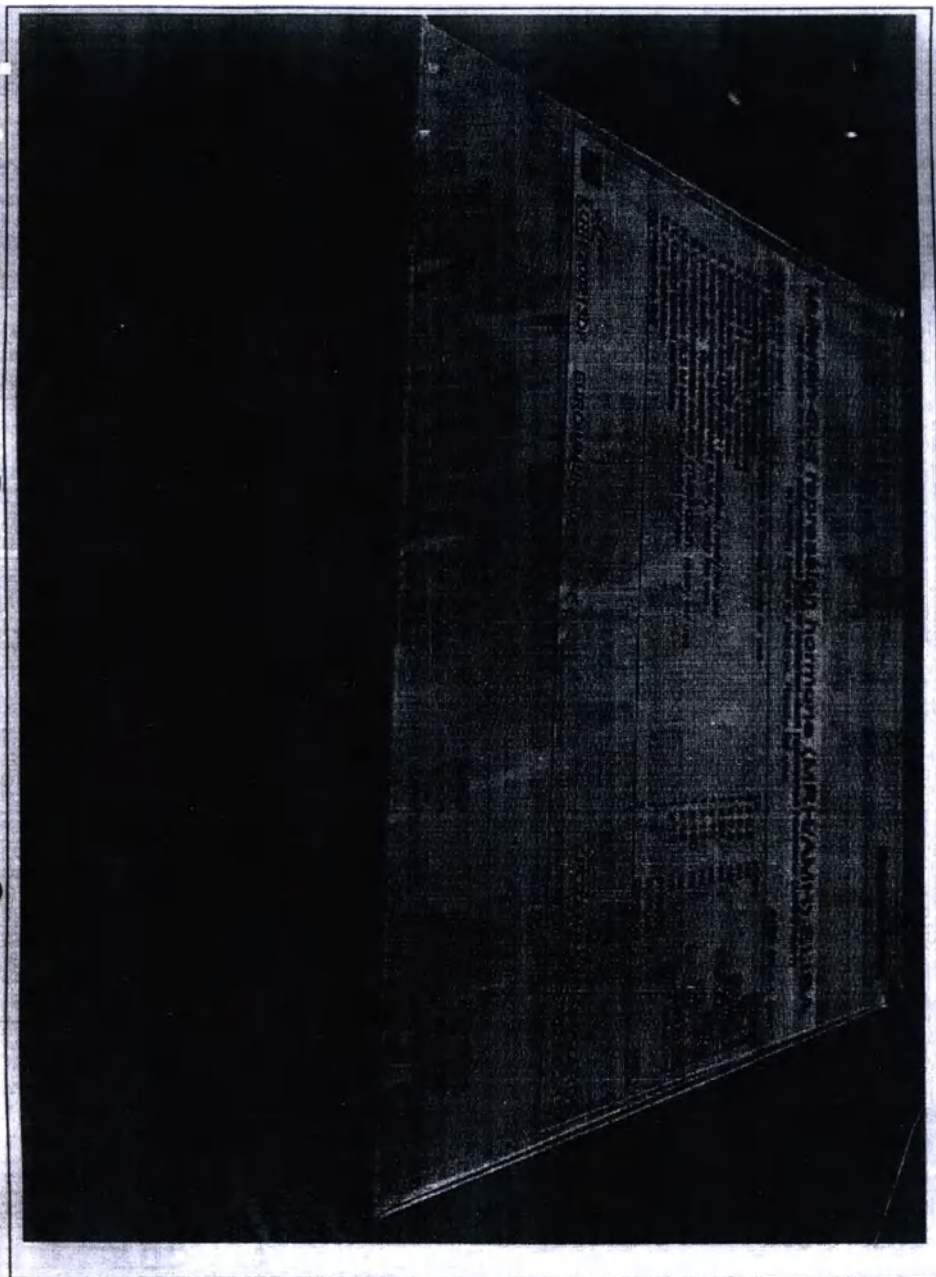


Вторичная упаковка набора

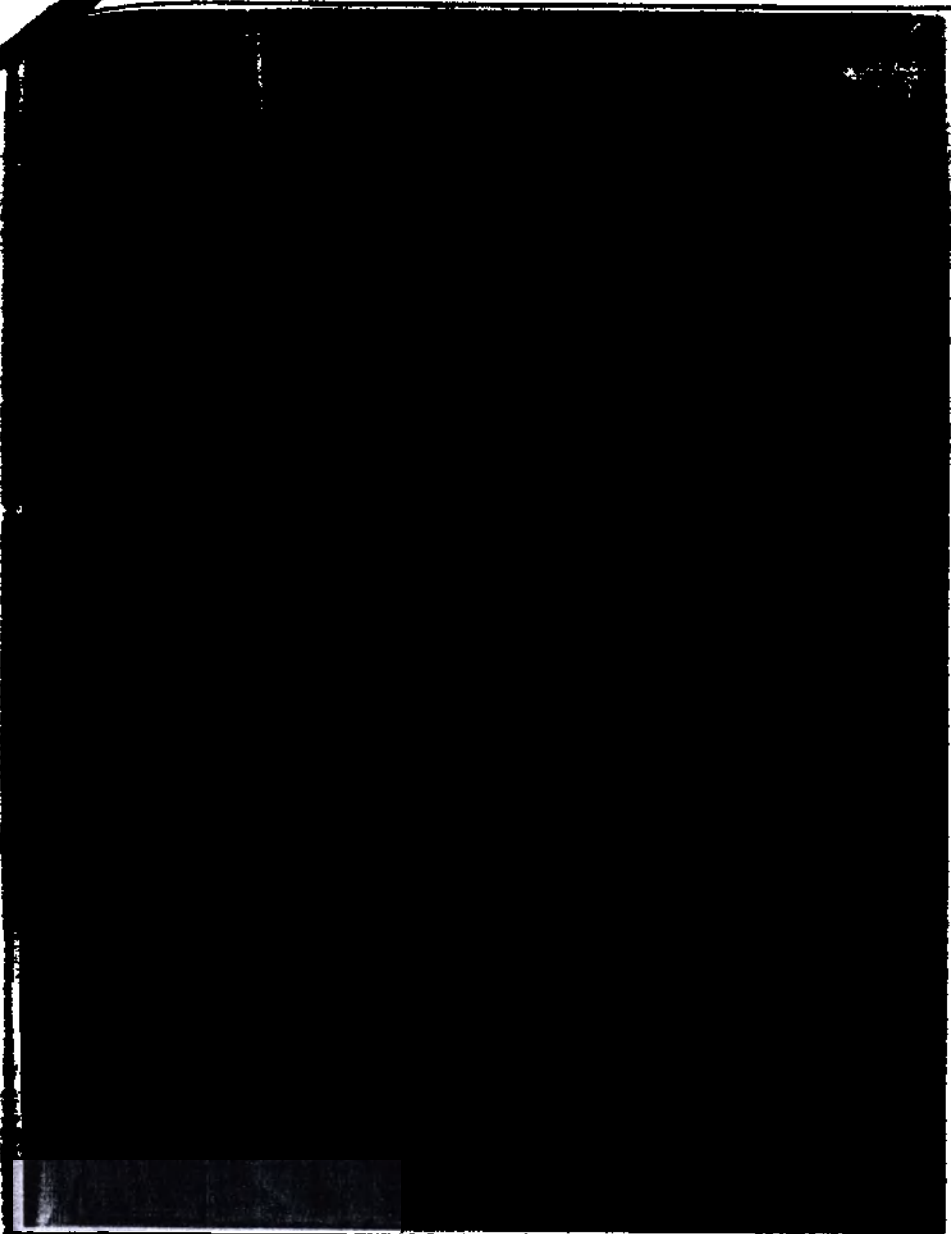


Общий вид набора

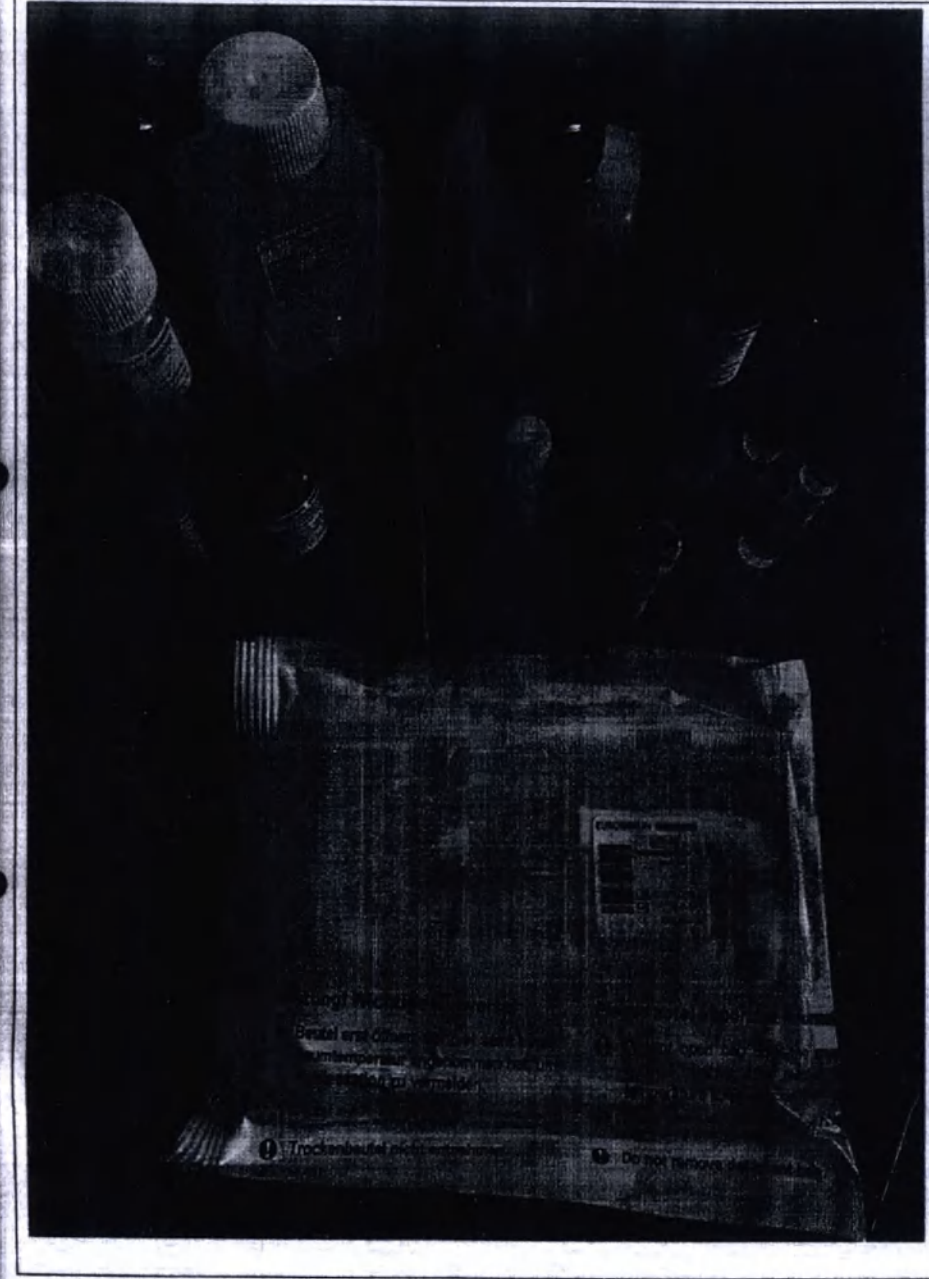


Общий вид набора

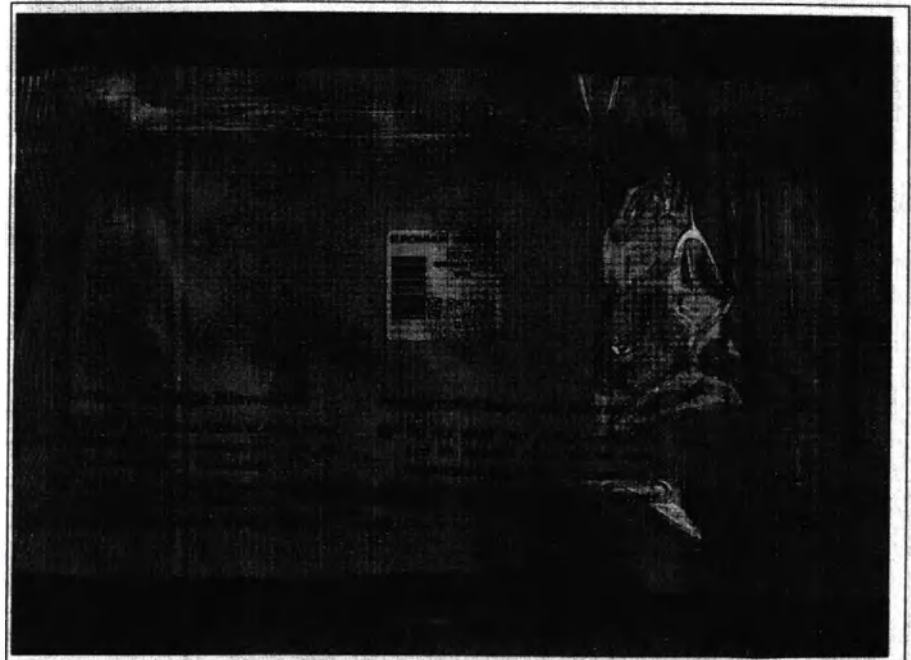

Макропланшет разборный, 12 стрелов по 8 лунок

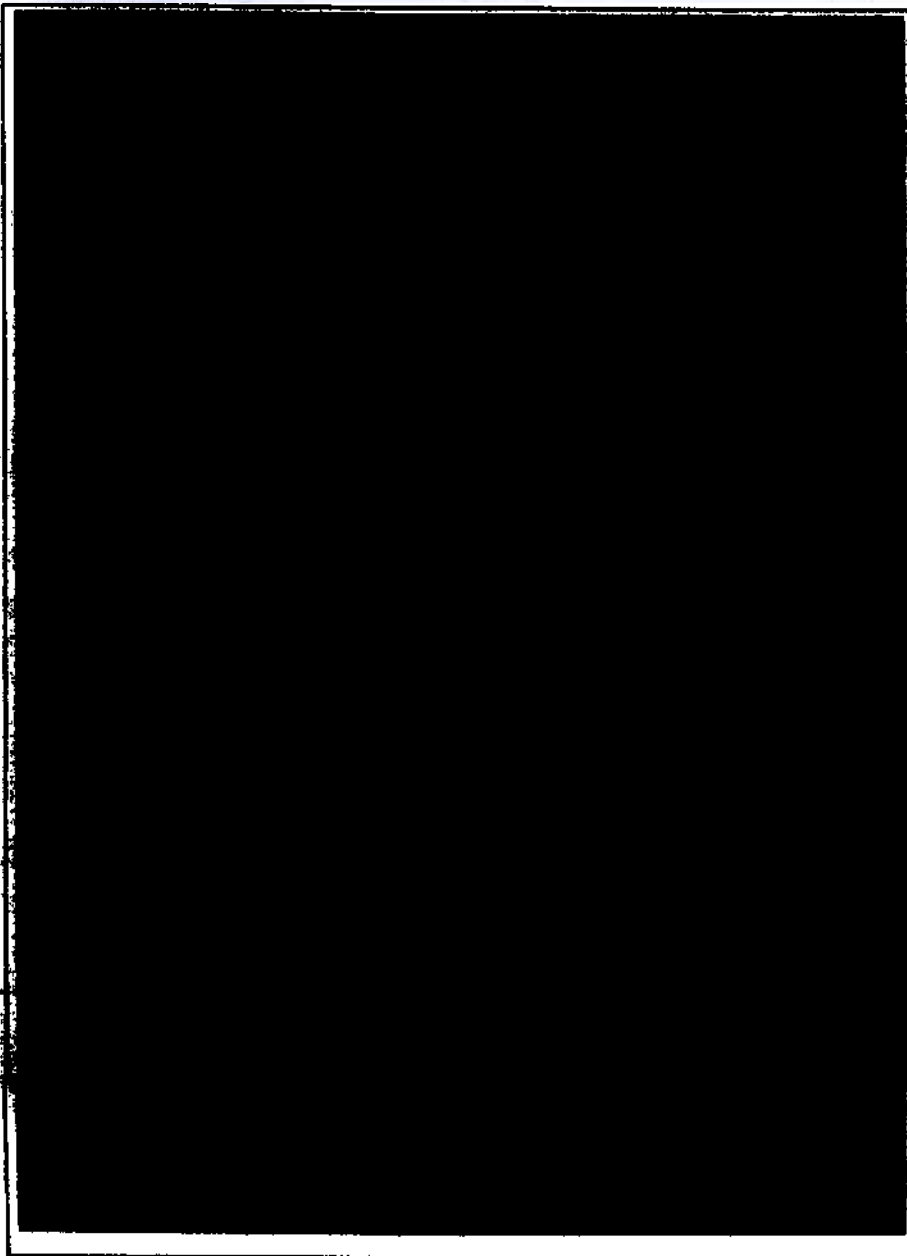


Калибратор 1 лиофилизированный, 0,5 мл, фл

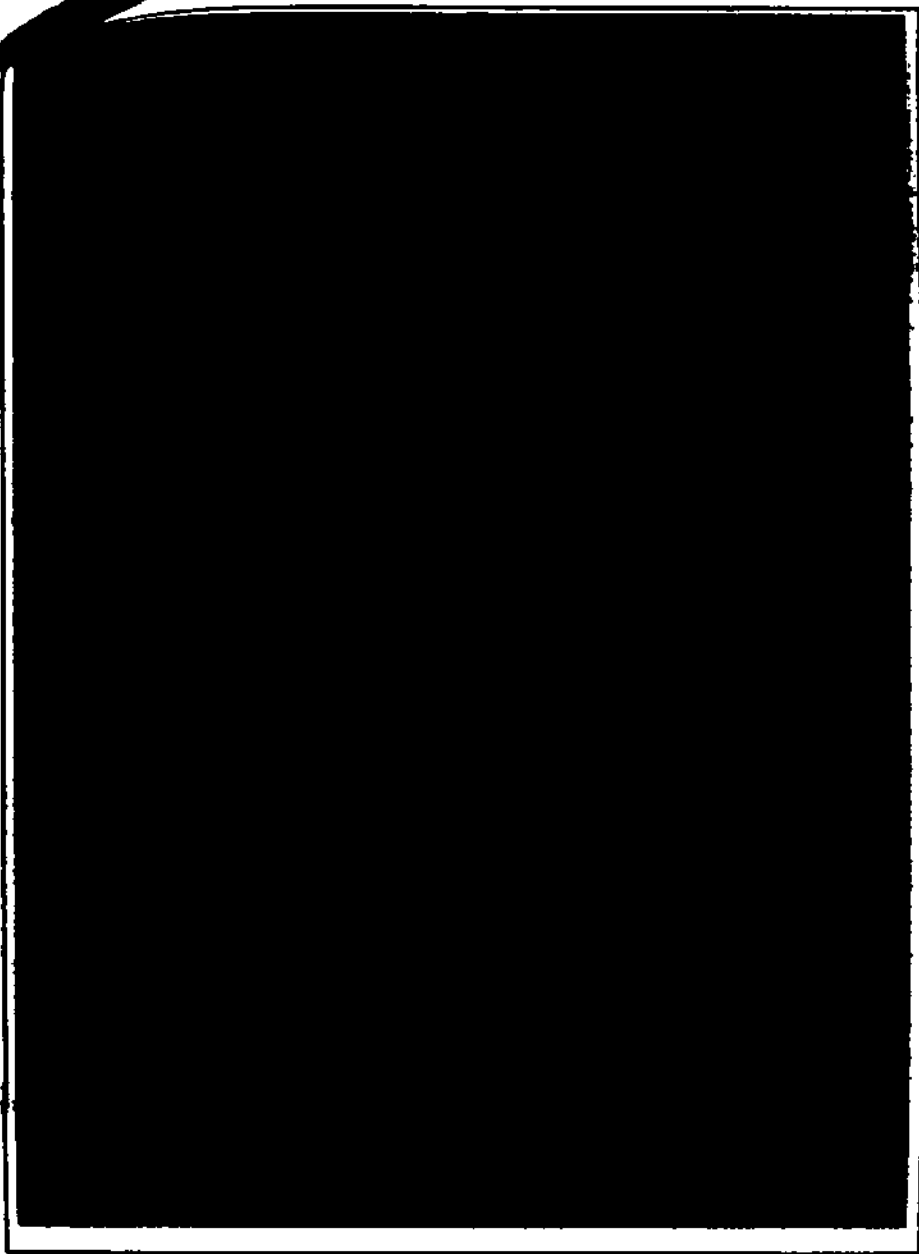


Калибратор 2 неофицированный, 0,5 мл, фи




Калибратор 3 неофицированный, 0,5 мл, фи

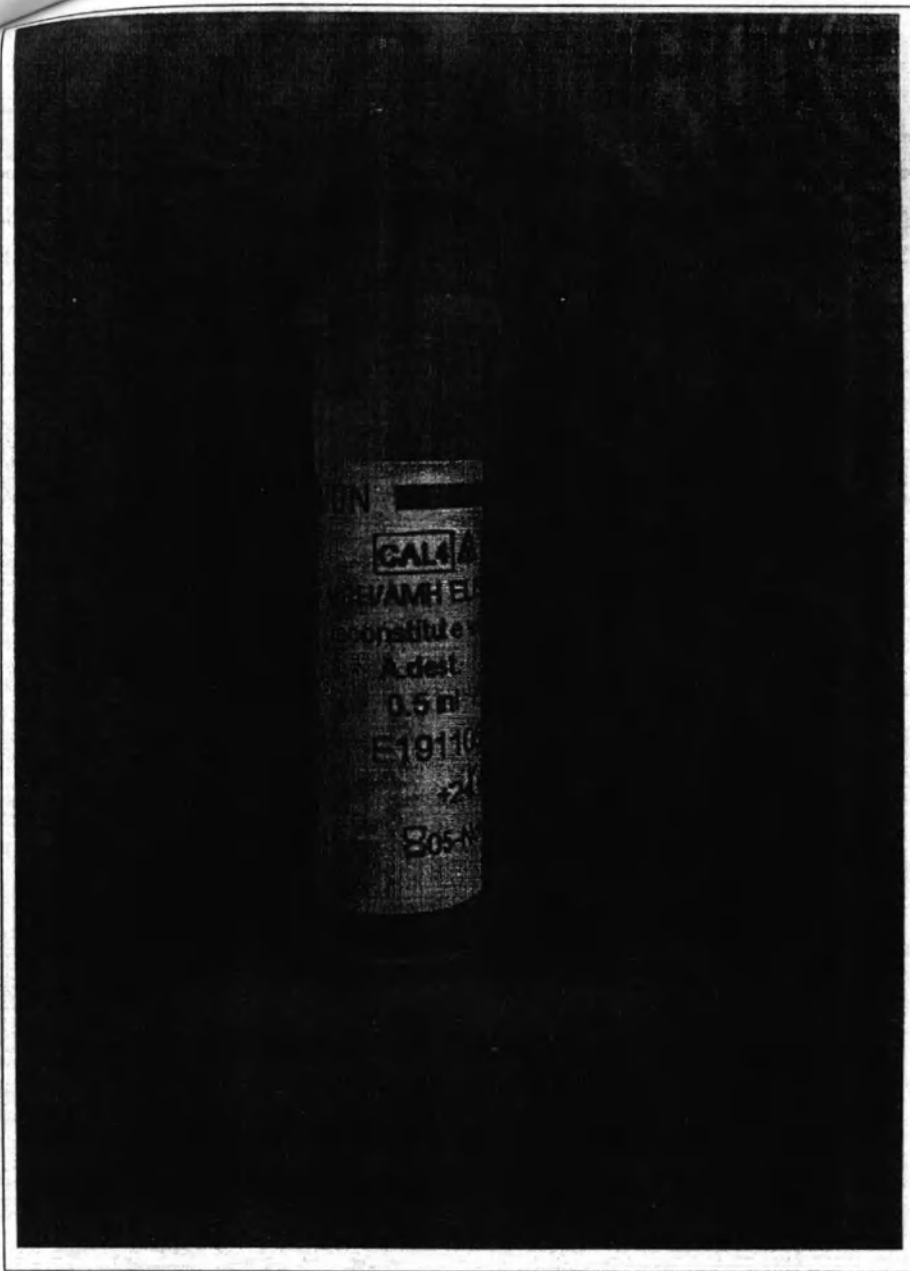


Калибратор 4 неофицированный, 0,5 мл, фл

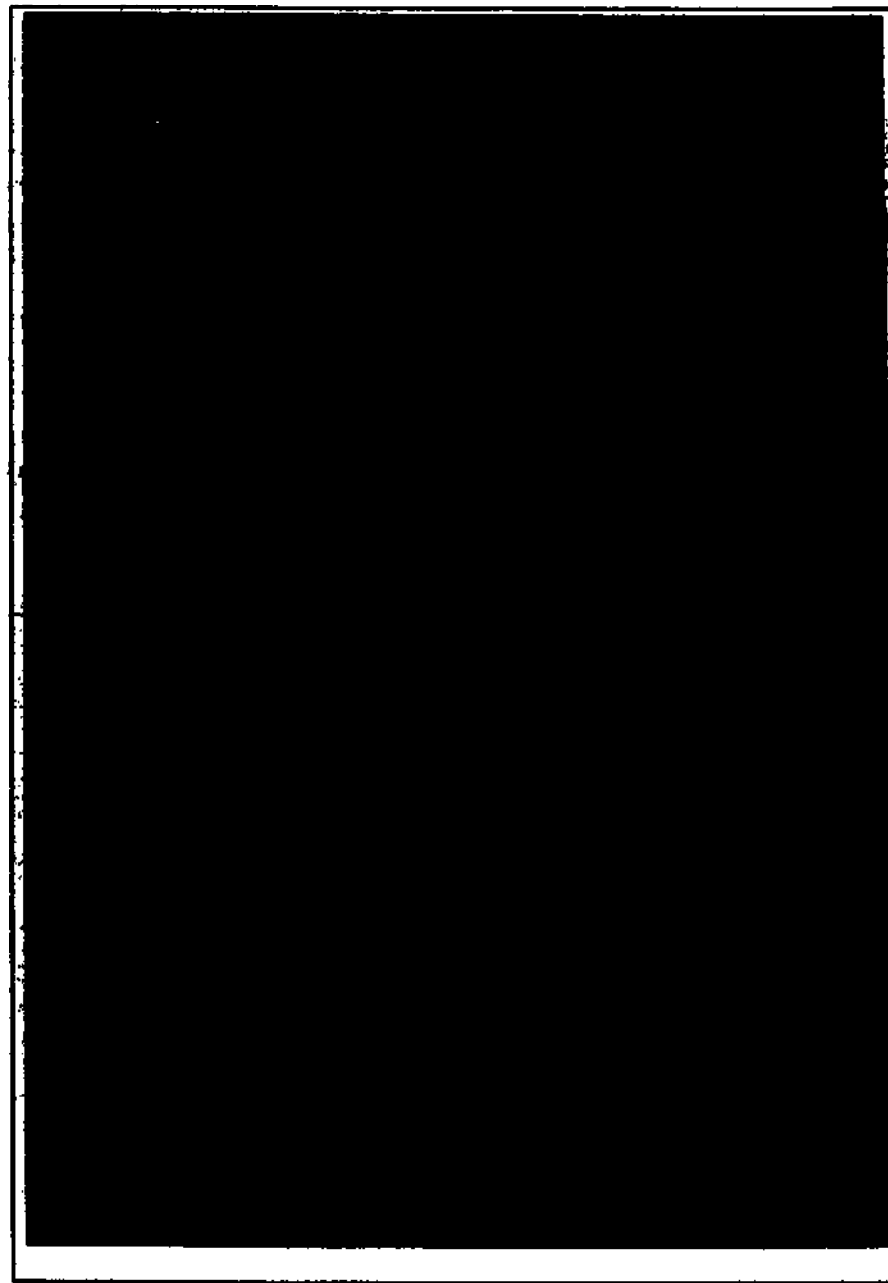


Калибратор 5 неофицированный, 0,5 мл, фл

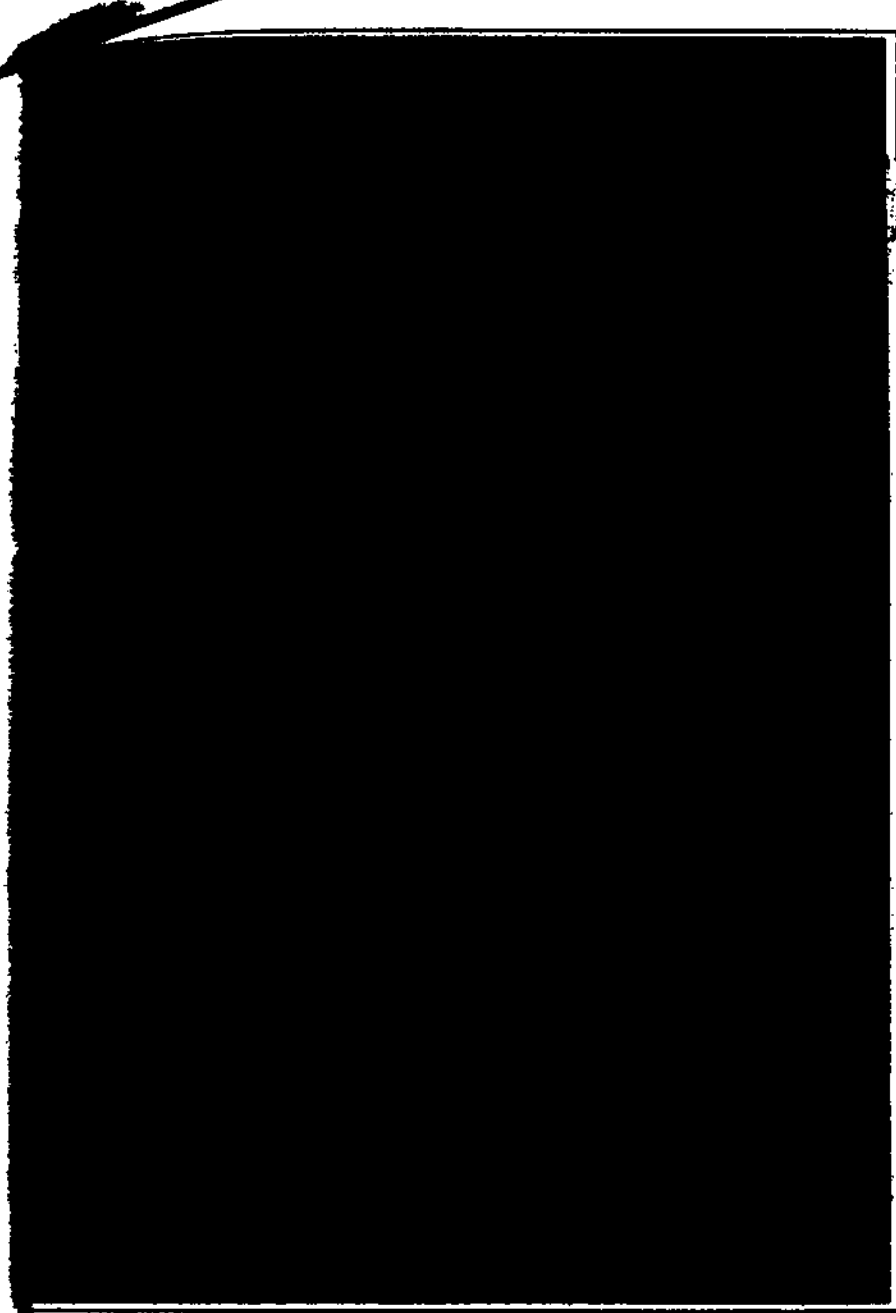


Калибратор 6 неофицированный, 0,5 мк, фл

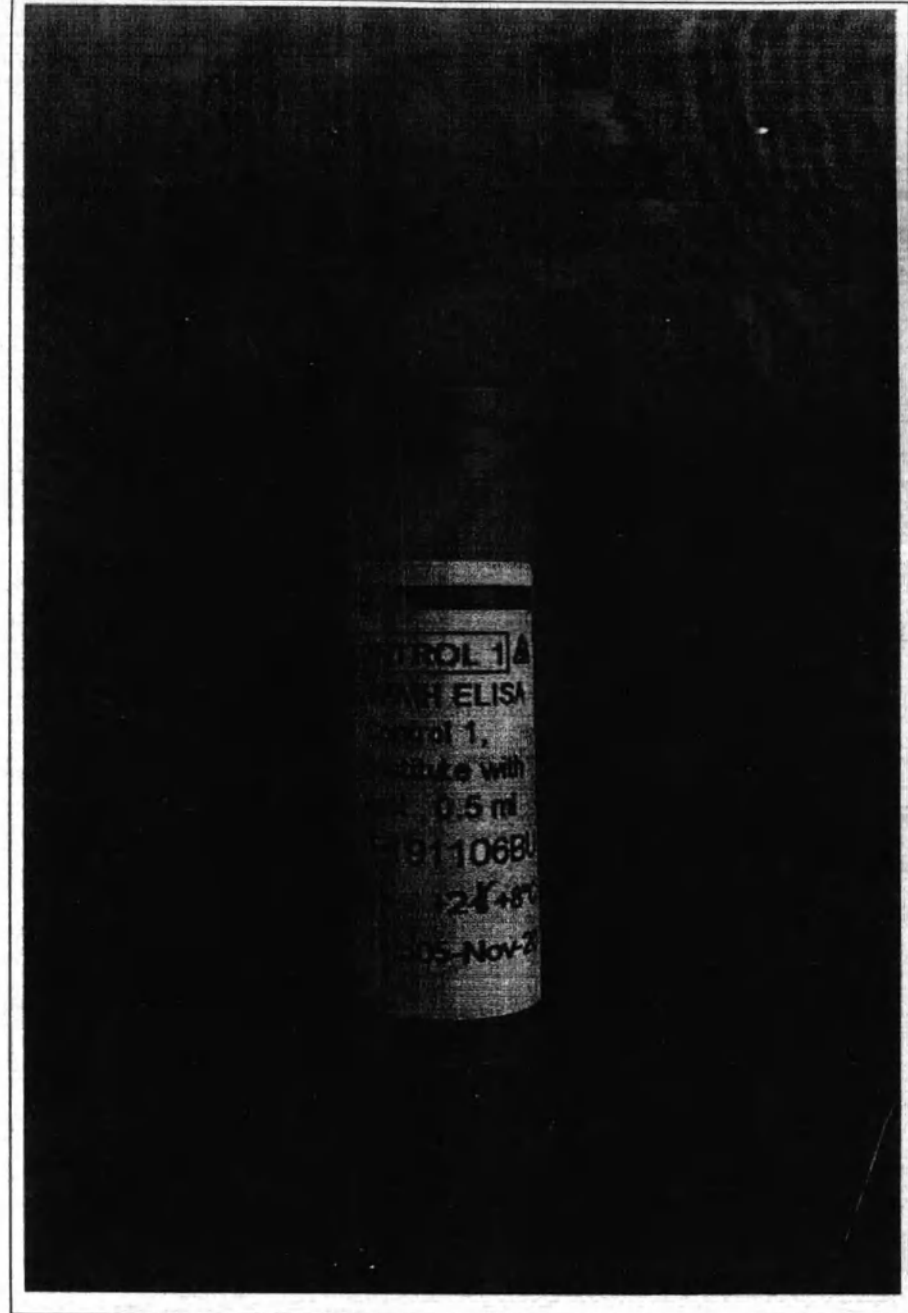

Образец контрольный неофицированный, уровень 1, 0,5 мк, фл

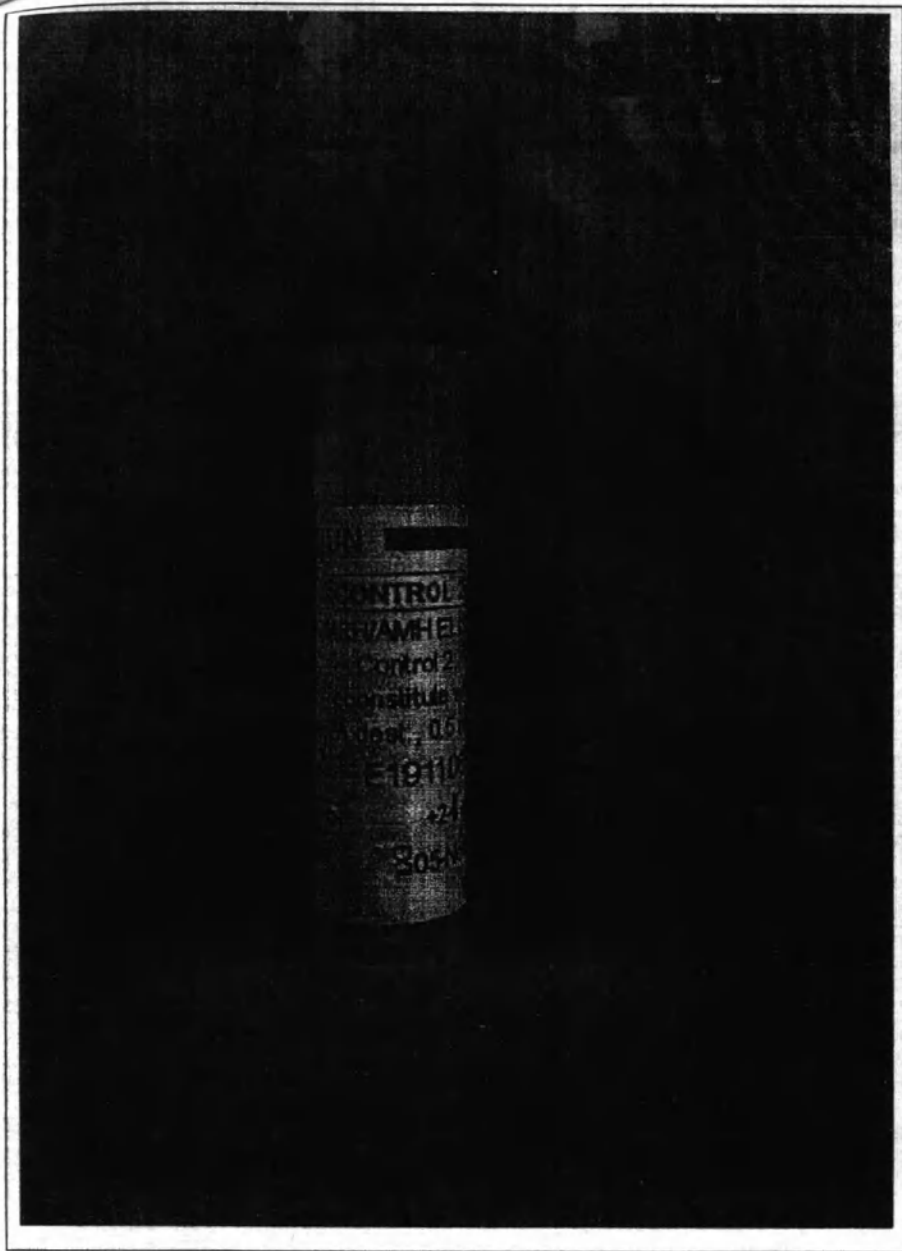

Образец контрольный лиофилизированный, уровень 2, 0,5 мл, фл

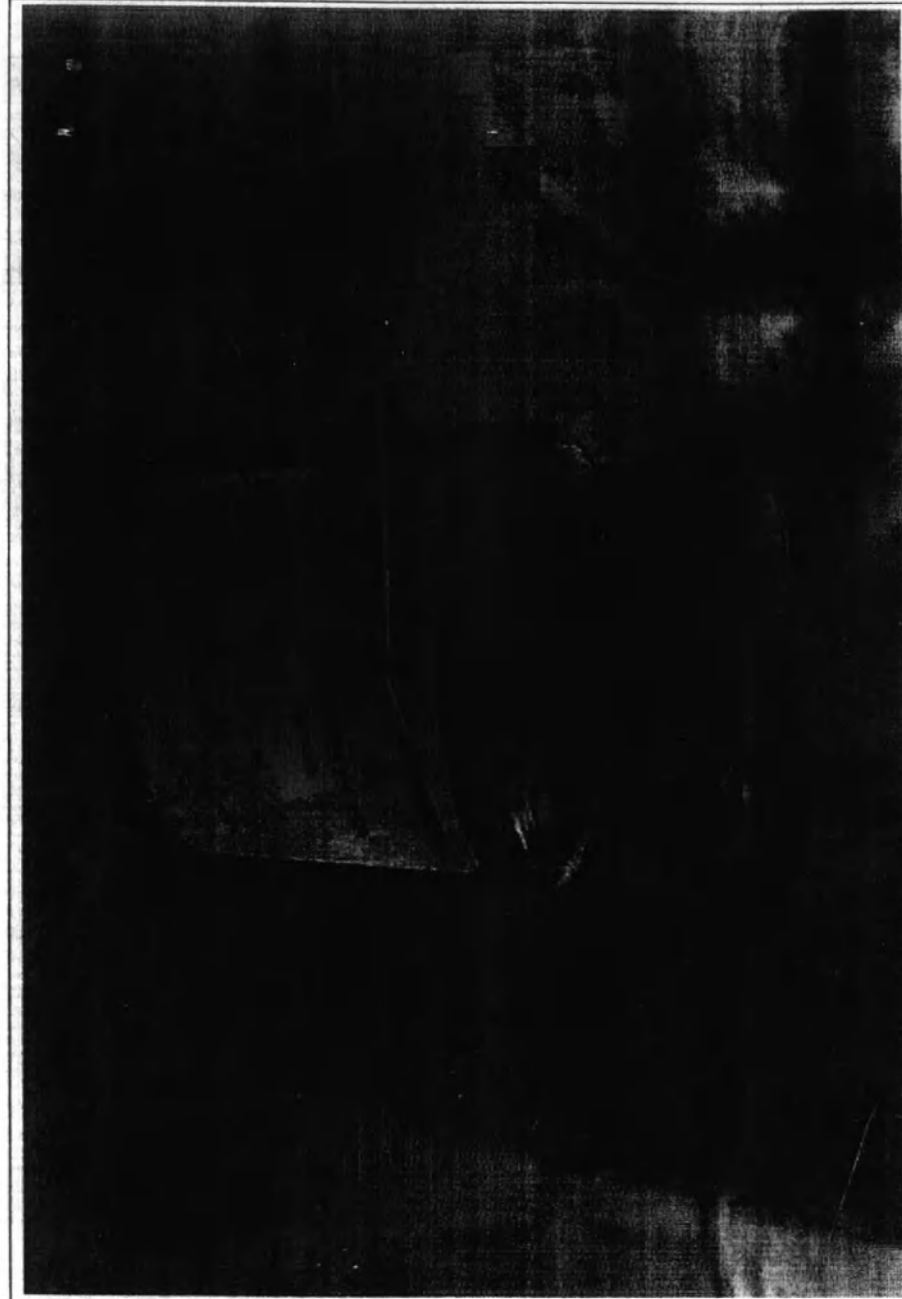


Раствор биотинилированных антител, 12 мл, фл




Раствор буферный для разведения образцов, 30 мл, фл




Коньюгат ферментный, 12 мл, фл

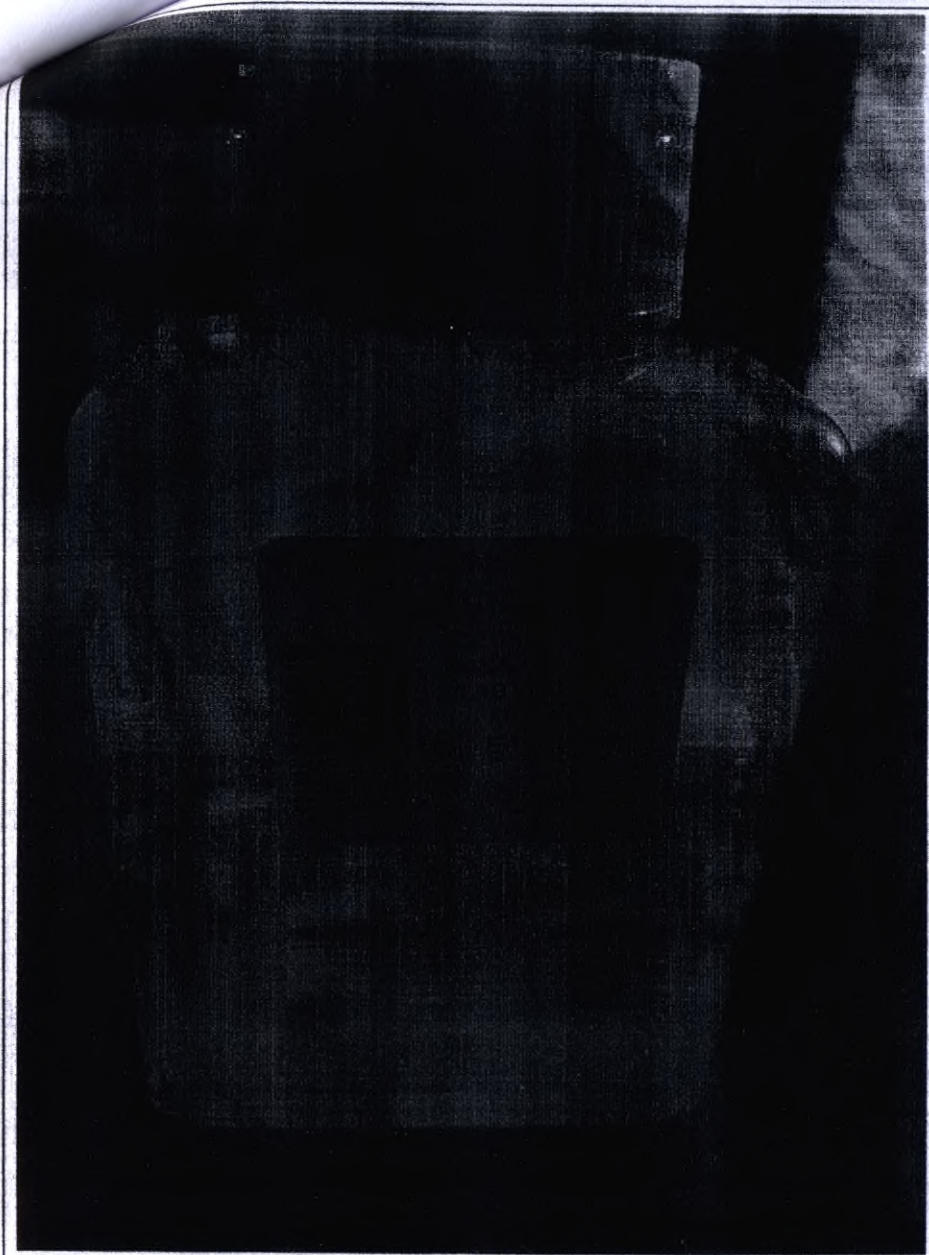


Раствор буферний для промивки, 100 мл, фл

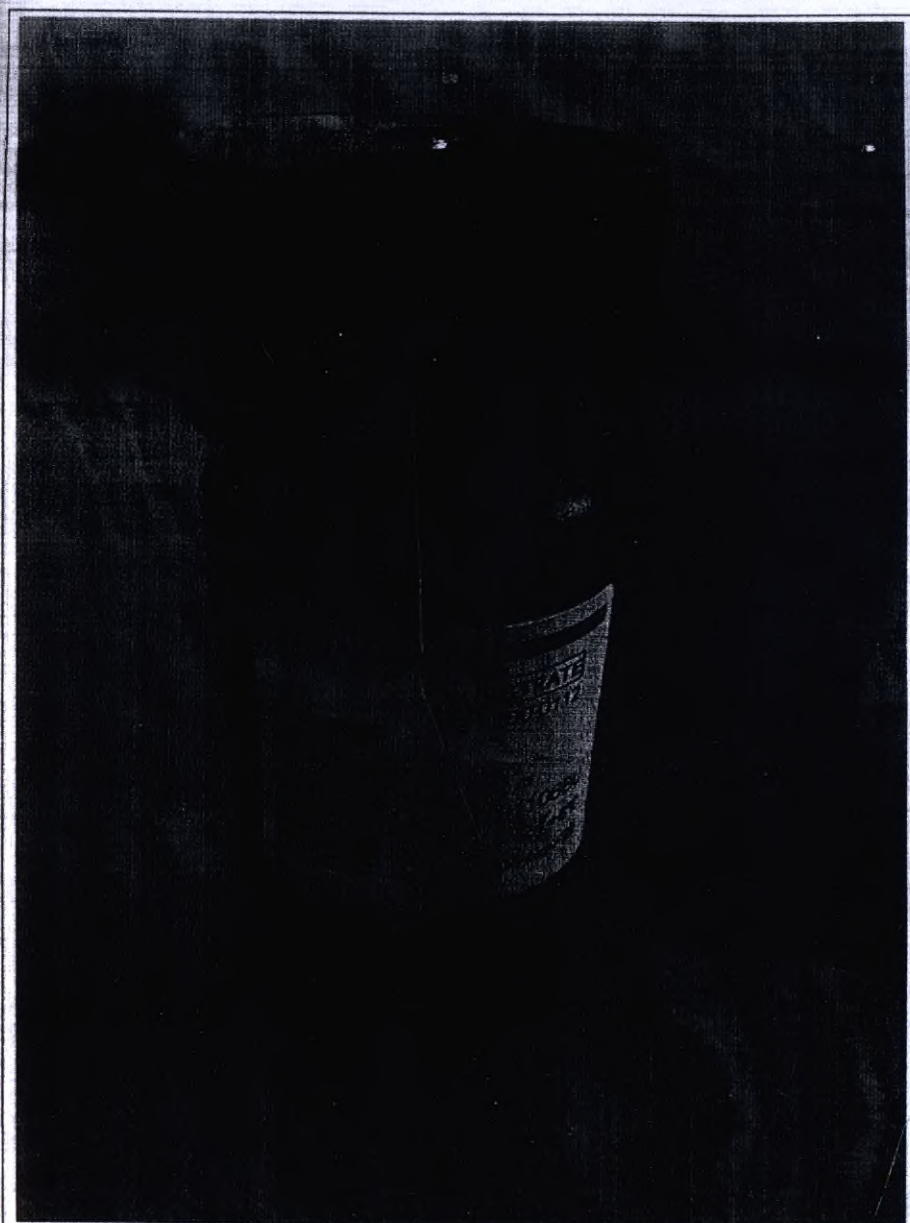

Раствор субстрата, 12 мл, фл

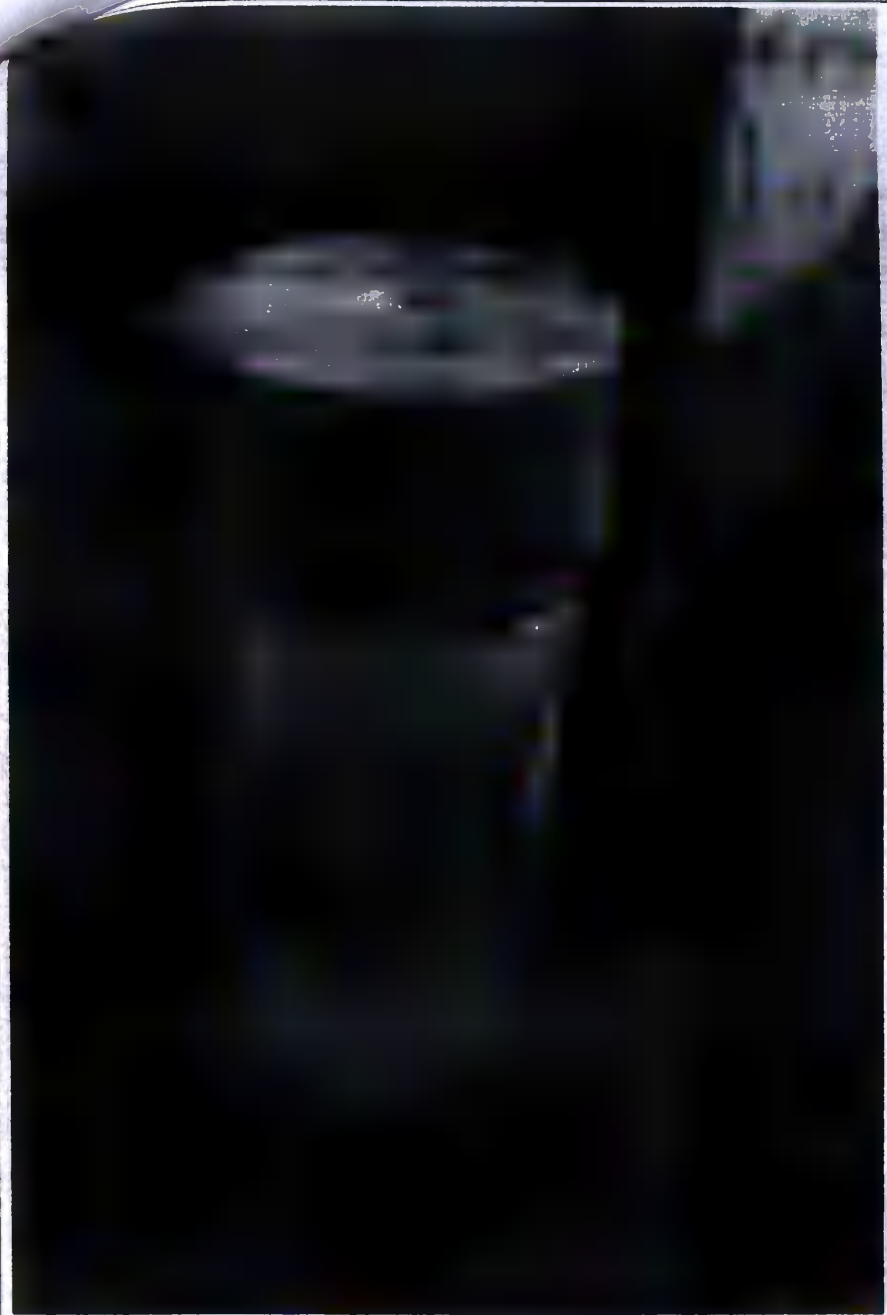

Стоп-реагент, 12 мл, фл

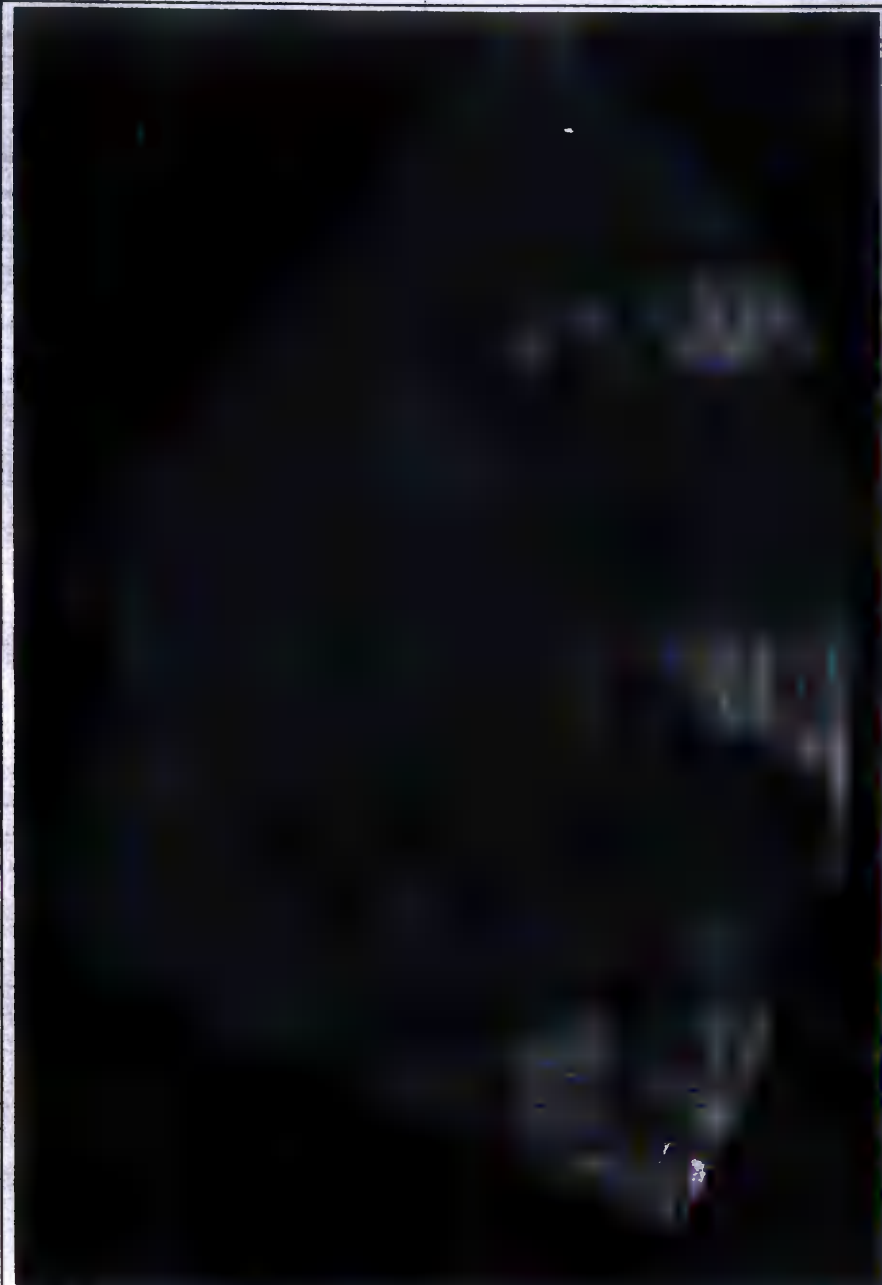

Пленка для микропланшета, 3 шт.

## Проект маркировки на

**Набор реагентов *in vitro* для определения гормона, подавляющего развитие Мюллеровых протоков (антимюллерова гормона) (Mullerian-duct repression hormone (MRH/AMH) ELISA)**

**Набор реагентов *in vitro* для определения гормона, подавляющего развитие Мюллеровых протоков (антимюллерова гормона) (Mullerian-duct repression hormone (MRH/AMH) ELISA)**

Производитель:

EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG

Seekamp 31, 23560 Lübeck, Германия

Температура хранения от +2 °C до +8 °C

Регистрационное Удостоверение №: РЗН \_\_\_\_ от \_\_\_\_ г.

Для лабораторной диагностики *in vitro*

Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия использования: см. вложенную инструкцию на русском языке.

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА",  
129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1

Кат. №: EQ 6161-9601

Lot № \_\_\_\_\_

Годен до: XX.XX.XXXX



Генеральный директор ЗАО "АНАЛИТИКА"

С. А. Балабаев

