

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель отдела регистрации и качества

ООО «Зиммер СНГ»

А.И. Камнева

2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Помпа двухпоточная для артроскопии

1. Помпа двухпоточная



2. Педаль для двухпоточной помпы 2-х клавишная (при необходимости)



3. Педаль для двухпоточной помпы 4-х клавишная (при необходимости)





4. Интерфейс зажимной для двухпоточной помпы (при необходимости)





- 5.Интерфейс ножного управления для блока управления шейвера ZIMMER BIOMET (при необходимости)
- 6.Интерфейс ножного управления для блока управления шейвера SMITH & NEPHEW / DYONICS (при необходимости)
- 7.Интерфейс ножного управления для блока управления шейвера CONMED / LINVATEC (при необходимости)
- 8.Интерфейс ножного управления для блока управления шейвера ARTHREX (при необходимости)



Фотографические изображения разъемов интерфейсов для подсоединения различных блоков управления и шейверов






9. Кабели питания (не более 5 шт.) (при необходимости)





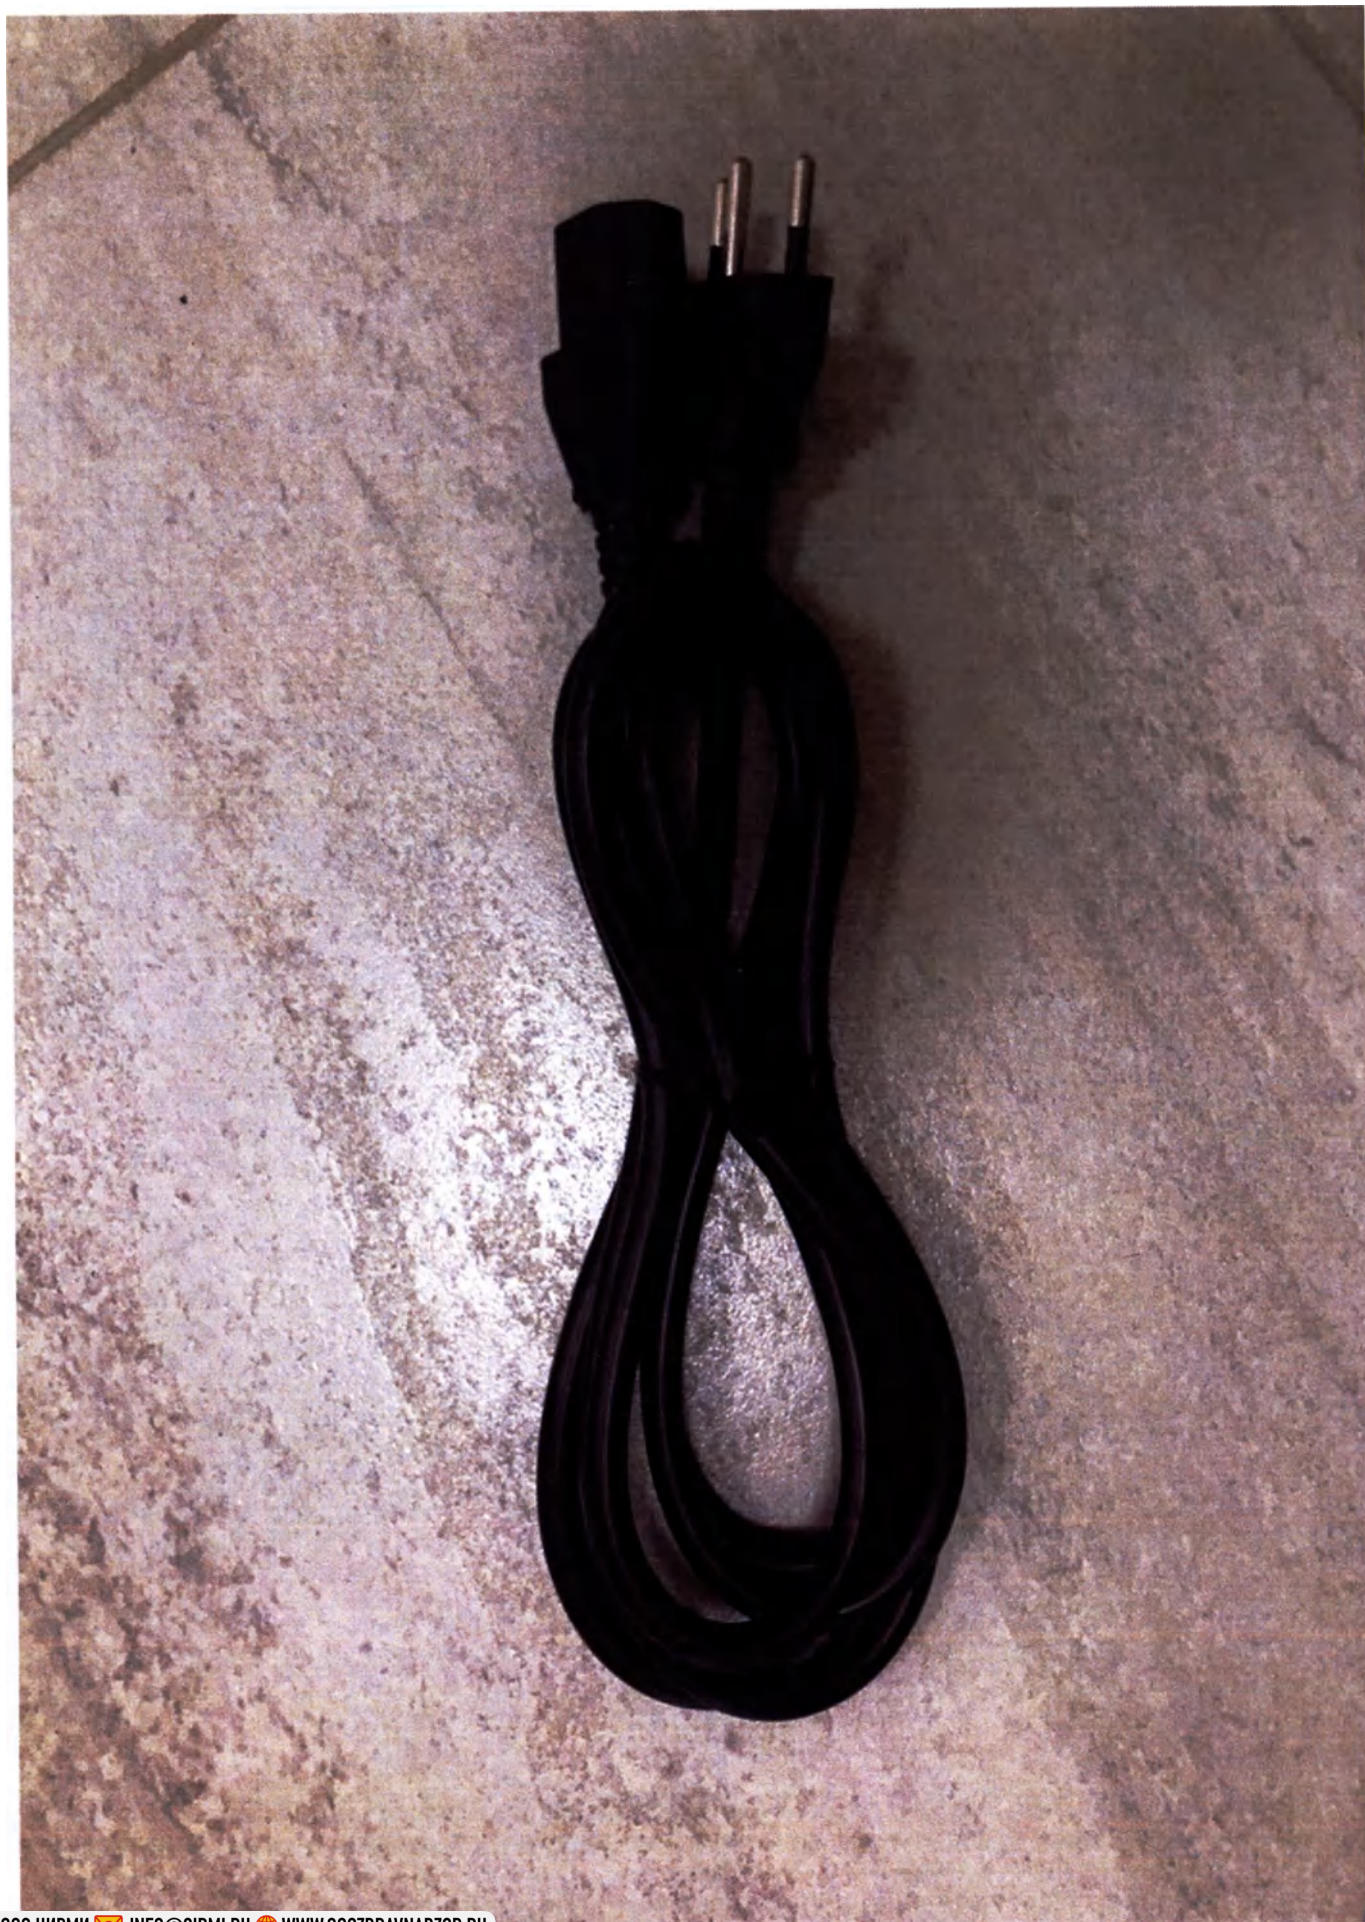

10. Набор дневной для двухпоточной помпы (при необходимости), в составе:
- Трубка для доставки физиологического раствора



11. Набор пациента с регулирующим клапаном для двухпоточной помпы (при необходимости), в составе:


- Трубка отводящая



- Трубка промежуточная с регулирующим клапаном для двухпоточной помпы



12. Трубка промежуточная с регулирующим клапаном для двухпоточной помпы (при необходимости)

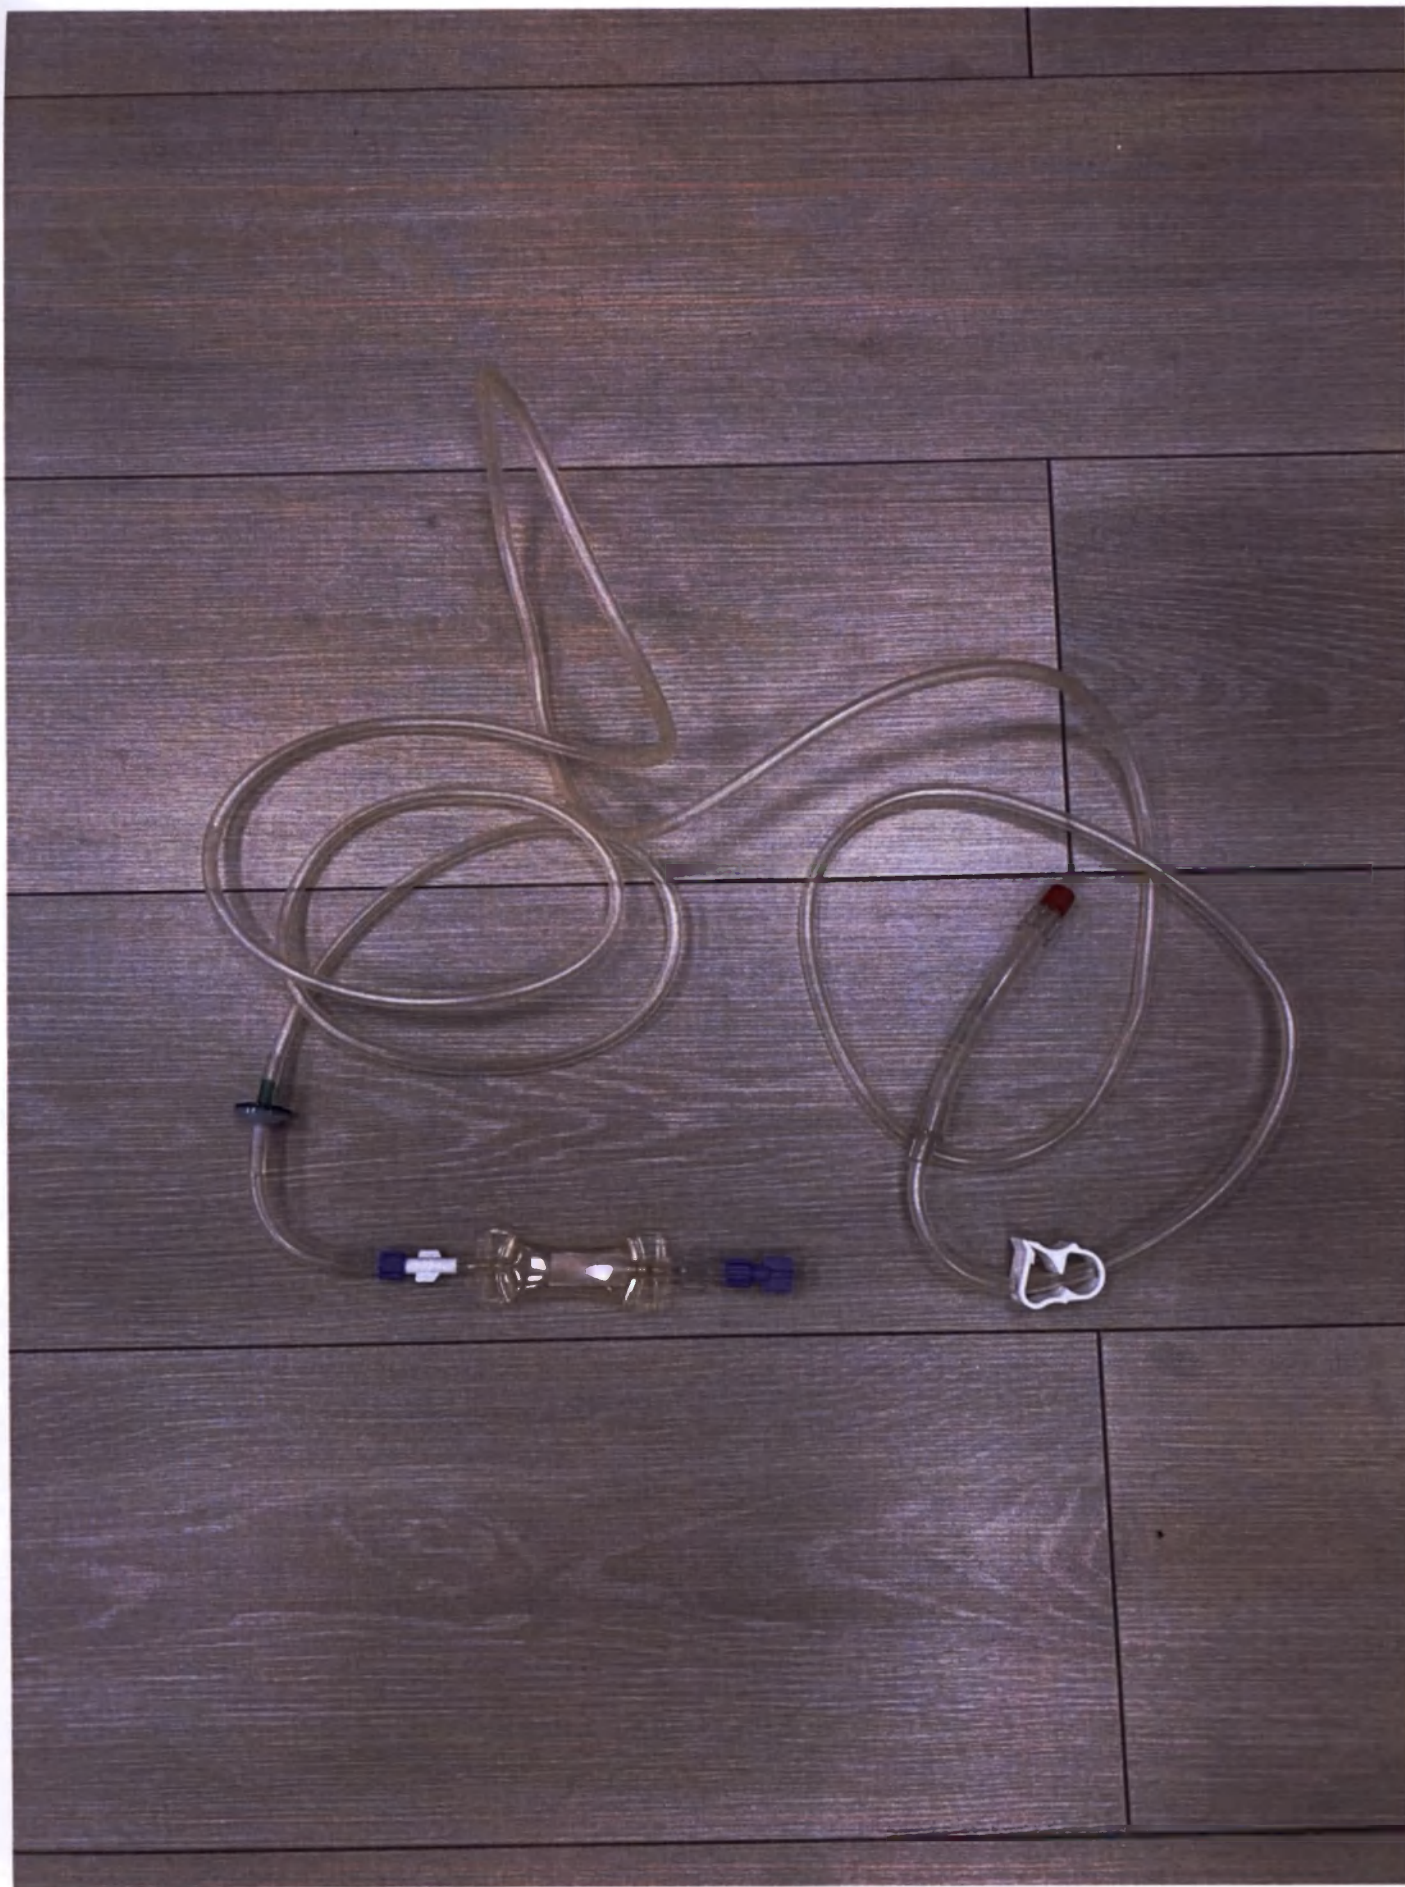



Distributed by



ZIMMER BIOMET

Zimmer GmbH
Sulzerallee 8
8404 Winterthur - SWITZERLAND
T: +41 58 854 80 00
www.zimmerbiomet.com



Hemodia SAS
85 Rue du Chêne Vert
31670 Labège - FRANCE
T: +33(0)5 61 00 71 81
hemodia@hemodia.com

MADE IN

FRANCE

CE 0459



REF

11010072

SN

ZB1807A10110

EN - Dual Flow Pump
FR - Pompe à Double Flux
IT - Pompa a Doppio Flusso
DE - Doppelrollenpumpe
ES - Bomba de Doble Flujo



(01)03661379134108(21)ZB1807A10110

HEM55_A

EN Dual Flow Pump
FR Pompe à Double Flux
IT Pompa a Doppio Flusso
DE Doppelrollenpumpe
ES Bomba de Doble Flujo

REF

11010072

SN

ZB1807A10110



HEMODIA SAS
85 rue du Chêne Vert
31670 Labège - FRANCE
T: +33(0)5 61 00 71 81
hemodia@hemodia.com

CE 0459

Distributed by

ZIMMER BIOMET

Zimmer GmbH
Sulzerallee 8
8404 Winterthur - SWITZERLAND
T: +41 58 854 80 00
www.zimmerbiomet.com



TS4H-280V

HEMODIA

S/N: ZB1807A10110

Date calibration Calibration Date: 07/07/2018
Prochaine date de calibration/Next Calibration: 06/07/2019



100-240V
50/60 Hz - 800mA




T5AH-250V



100-240V ~
50/60 Hz - 500VA

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

20 (двадцать) листа (ов)

Руководитель отдела по регистрации и
качеству

Камнева А.И. Камнева

202 1 г.

