

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

Д.Е. Крупицкий

2020 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Пластырь медицинский фиксирующий»

производства:


ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд., Китай


(WAYSON Medical Co., Ltd., No.81, JunfengRoad., HuangpuDis, GuangZhou, China),

Tel: 86-20-82030500; Fax: 86-20-32282845; email: wayson@wayson.cn

2020



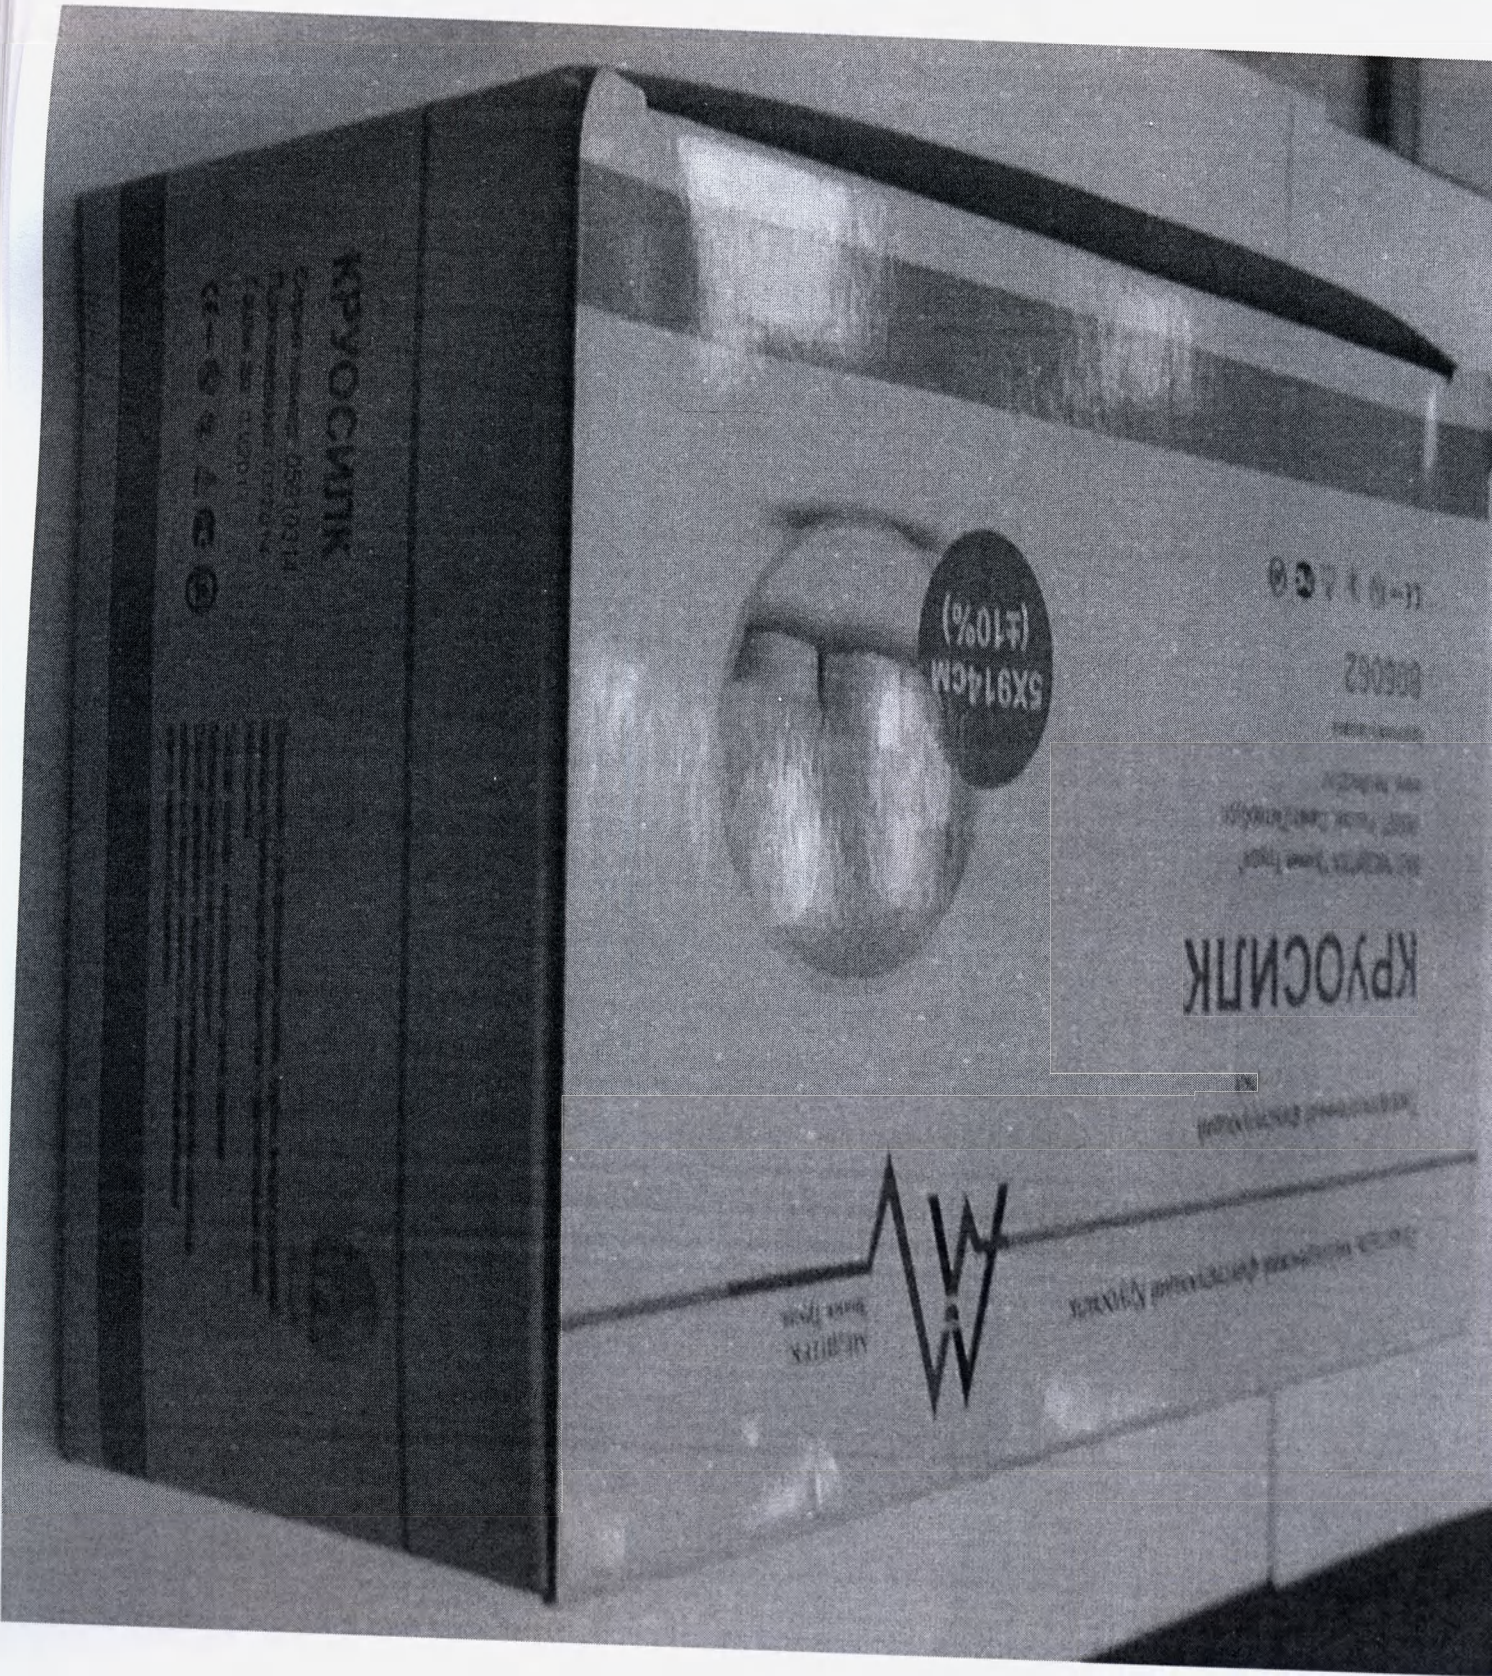

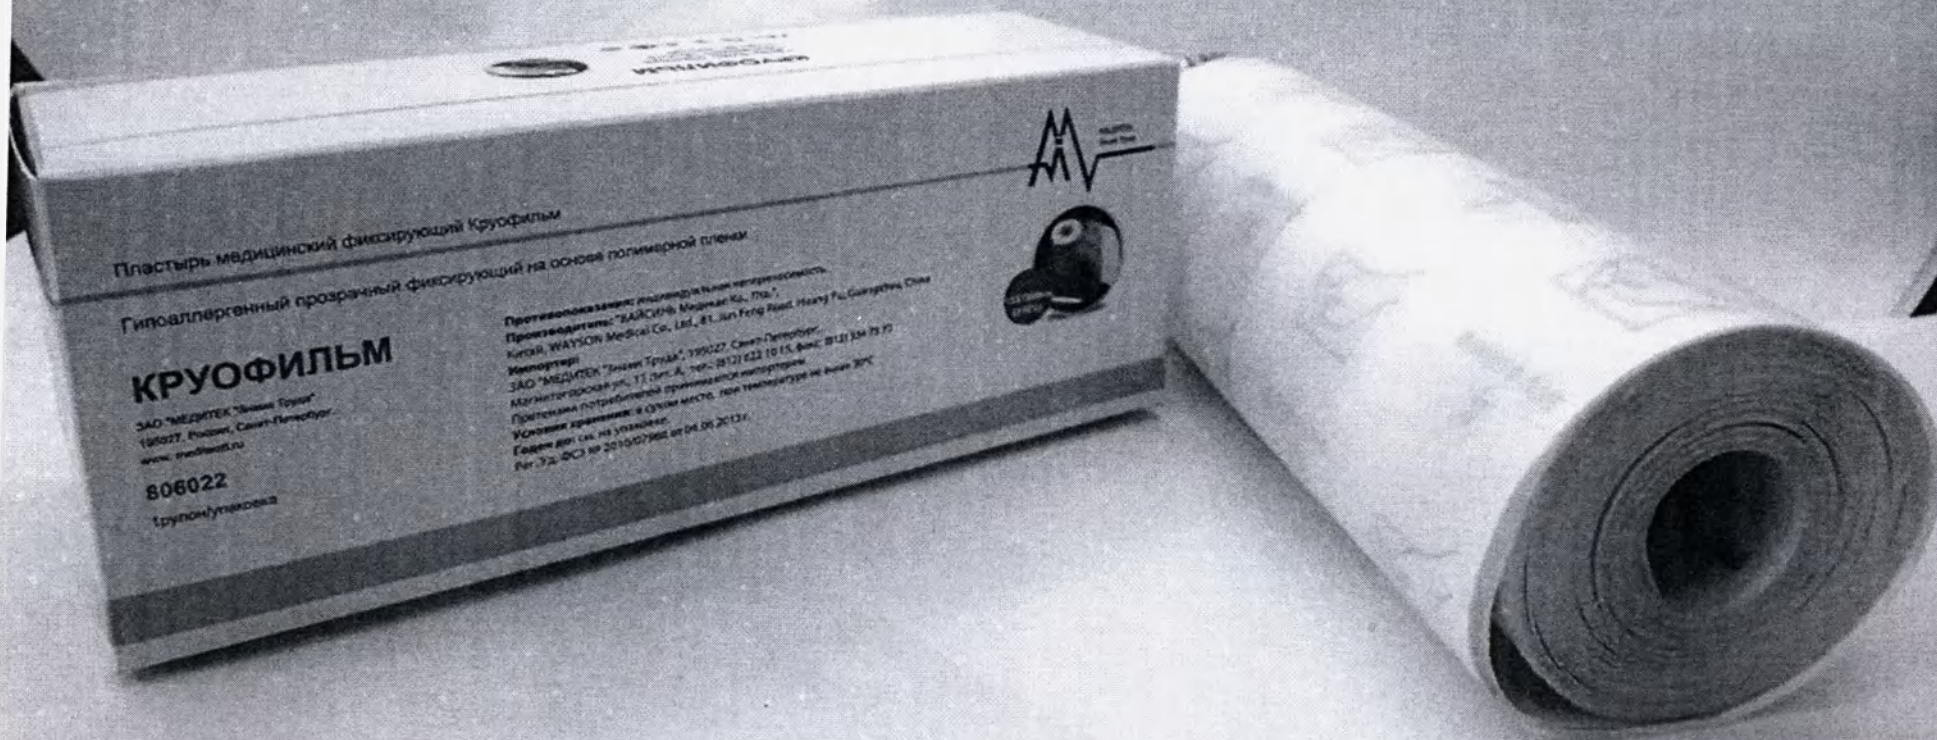

Пластырь медицинский фиксирующий Круофильм

Гипоаллергенный прозрачный фиксирующий на основе полимерной пленки

КРУОФИЛЬМ

ЗАО "МЕДИТЕК "Инвест Групп"
191027, Россия, Санкт-Петербург
www.meditek.ru

806022

трупонумеризация


Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Производитель: "WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road, Hangzhou, China"
Импортер:
ЗАО "МЕДИТЕК "Инвест Групп", 191027, Санкт-Петербург
Магистральская ул., 11 лит. А, тел. 8(812) 622 10 15, факс: 8(812) 334 79 79
Претензии потребителей принимаются импортером.
Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C
Срок годности: 36 мес. на упаковке.
Рег. Уд. ФСЗ № 2010/027966 от 04.06.2013г.





7



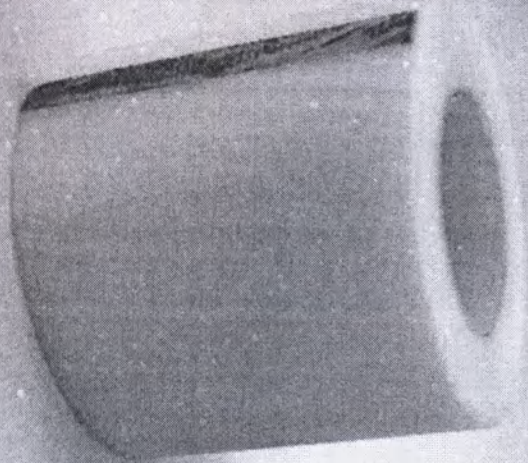



КРЮПЛАСТ

Производитель: ООО «Медитек»
г. Москва, ул. Савская, д. 10
806052 (Брянская область)



Пластирь медицинский фиксирующий Крюпласт
поддерживает фиксацию на основе перфорированного
подложного слоя


5x91 см
(±10%)





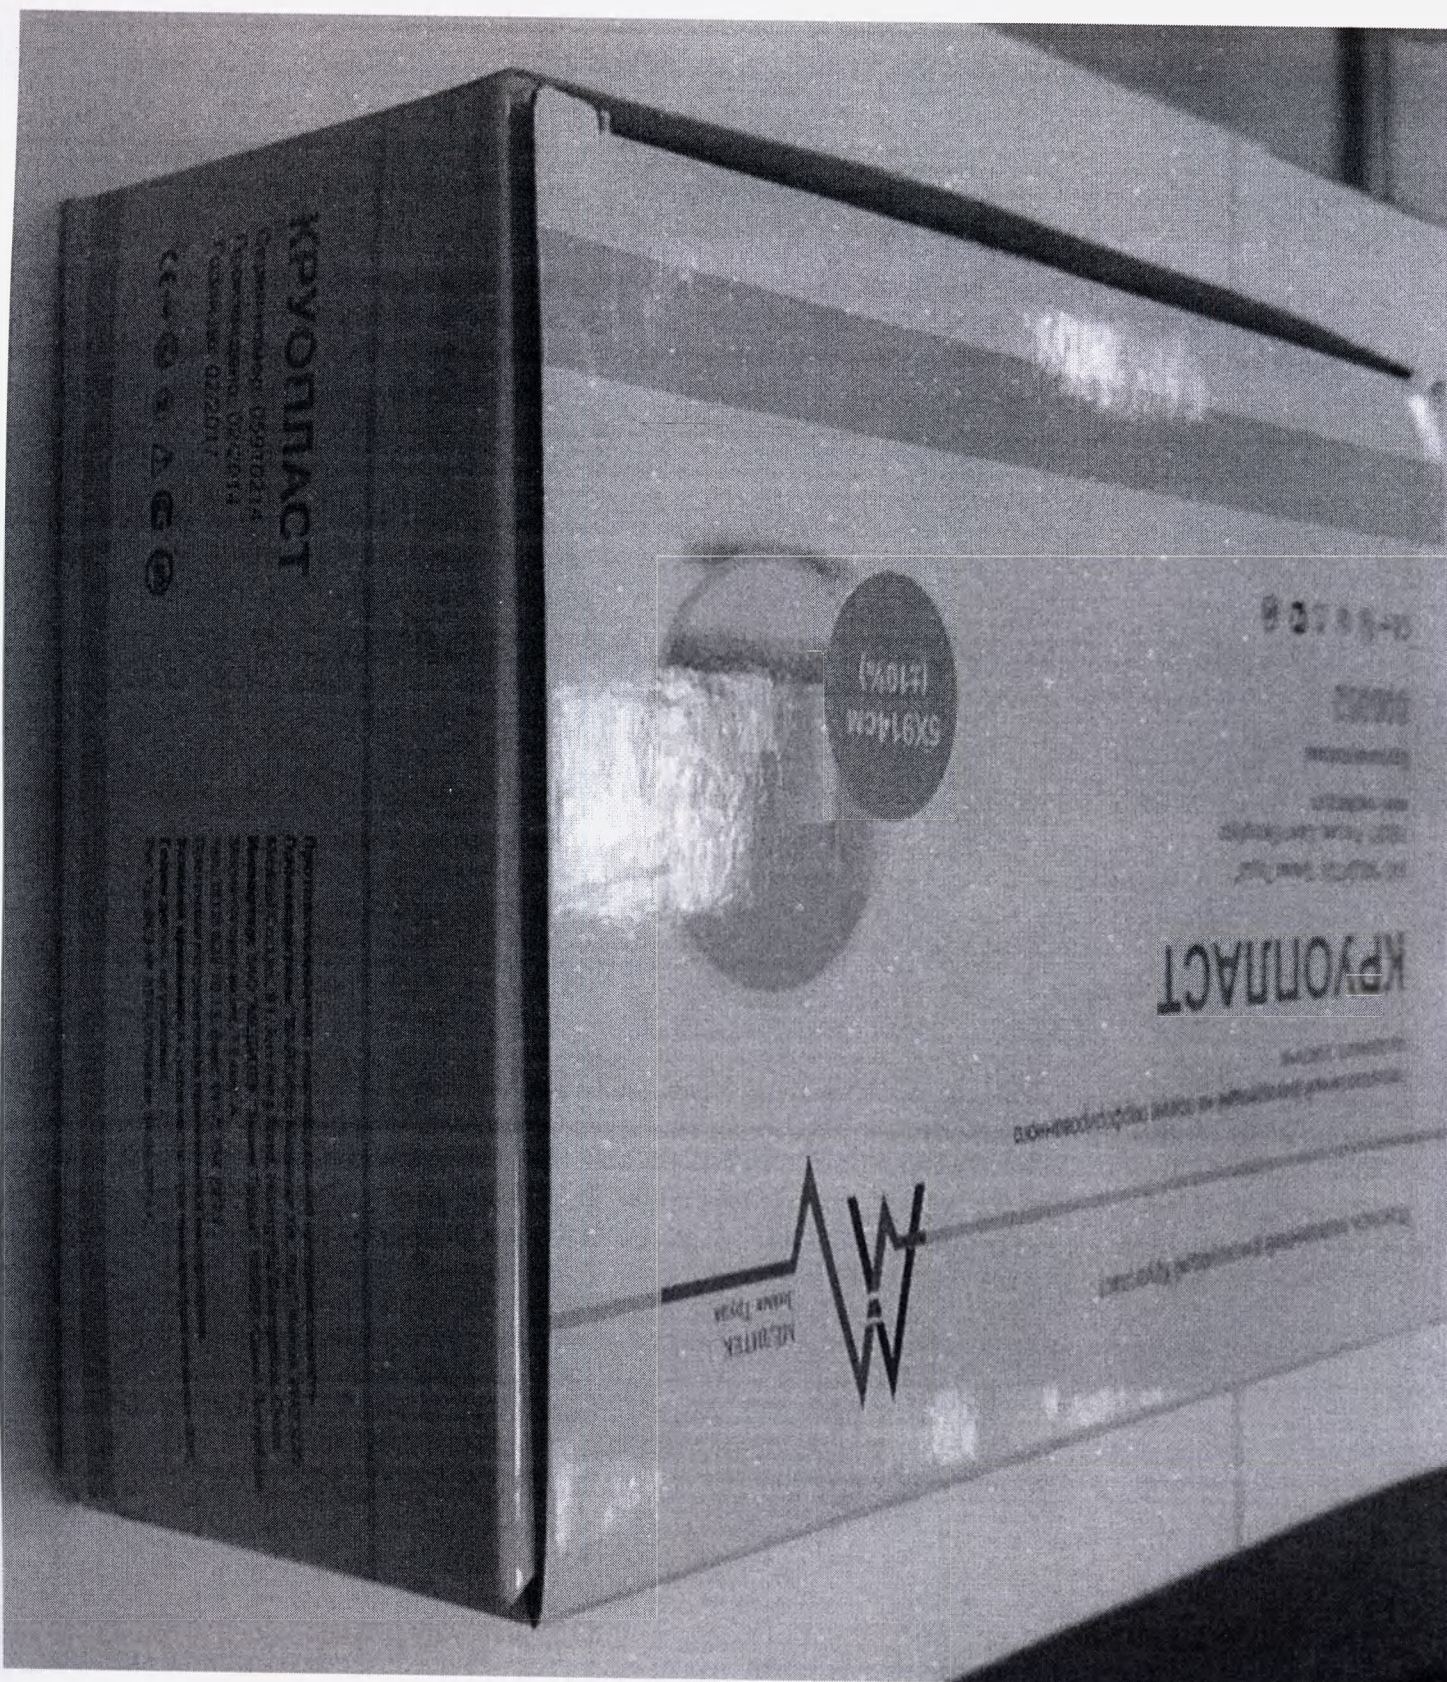

01

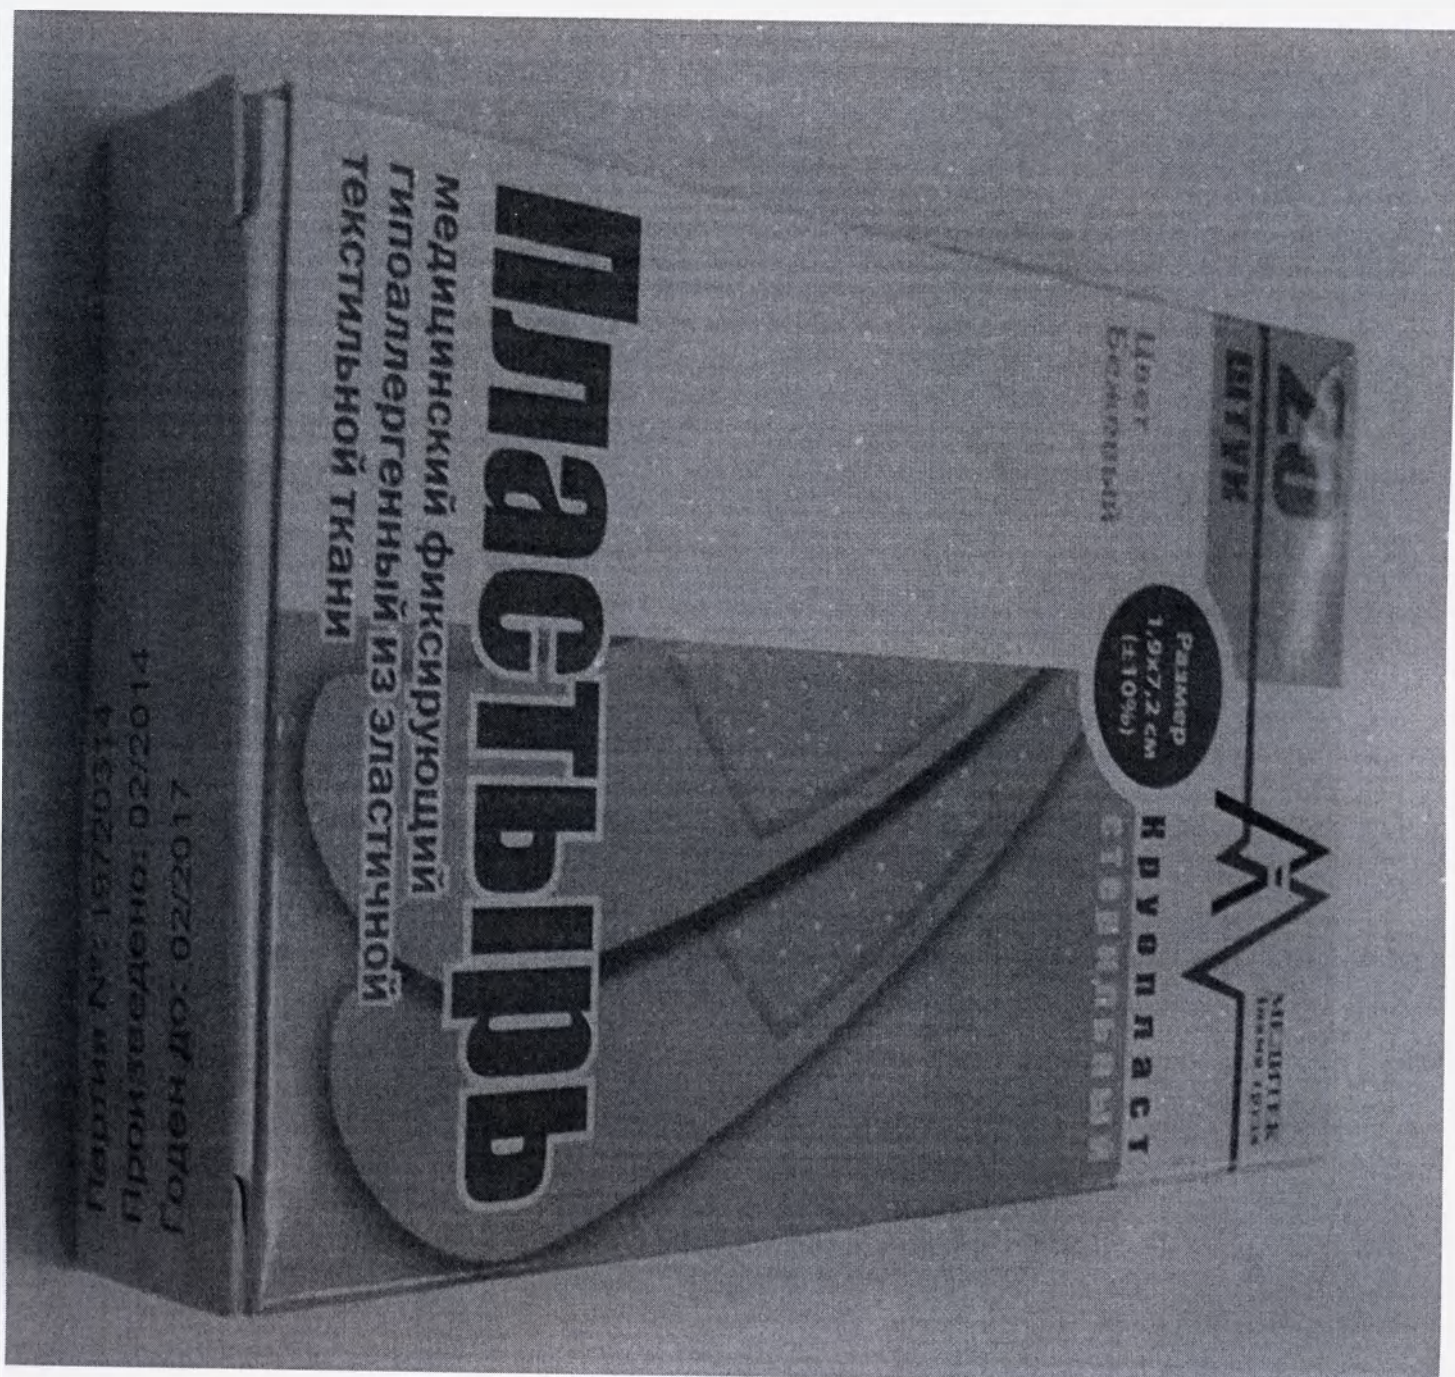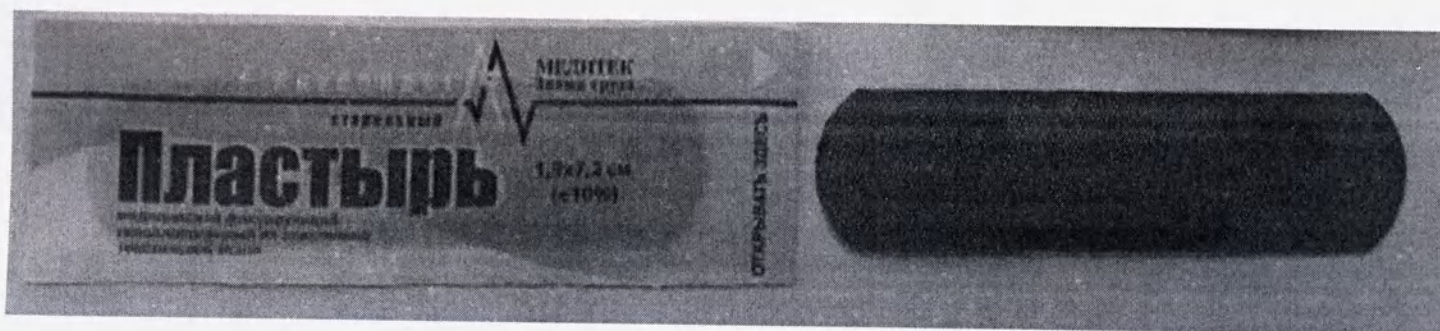

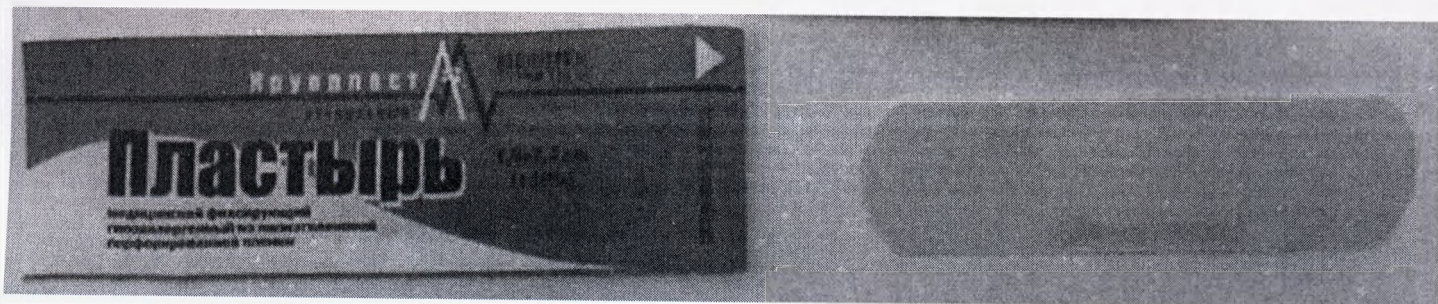

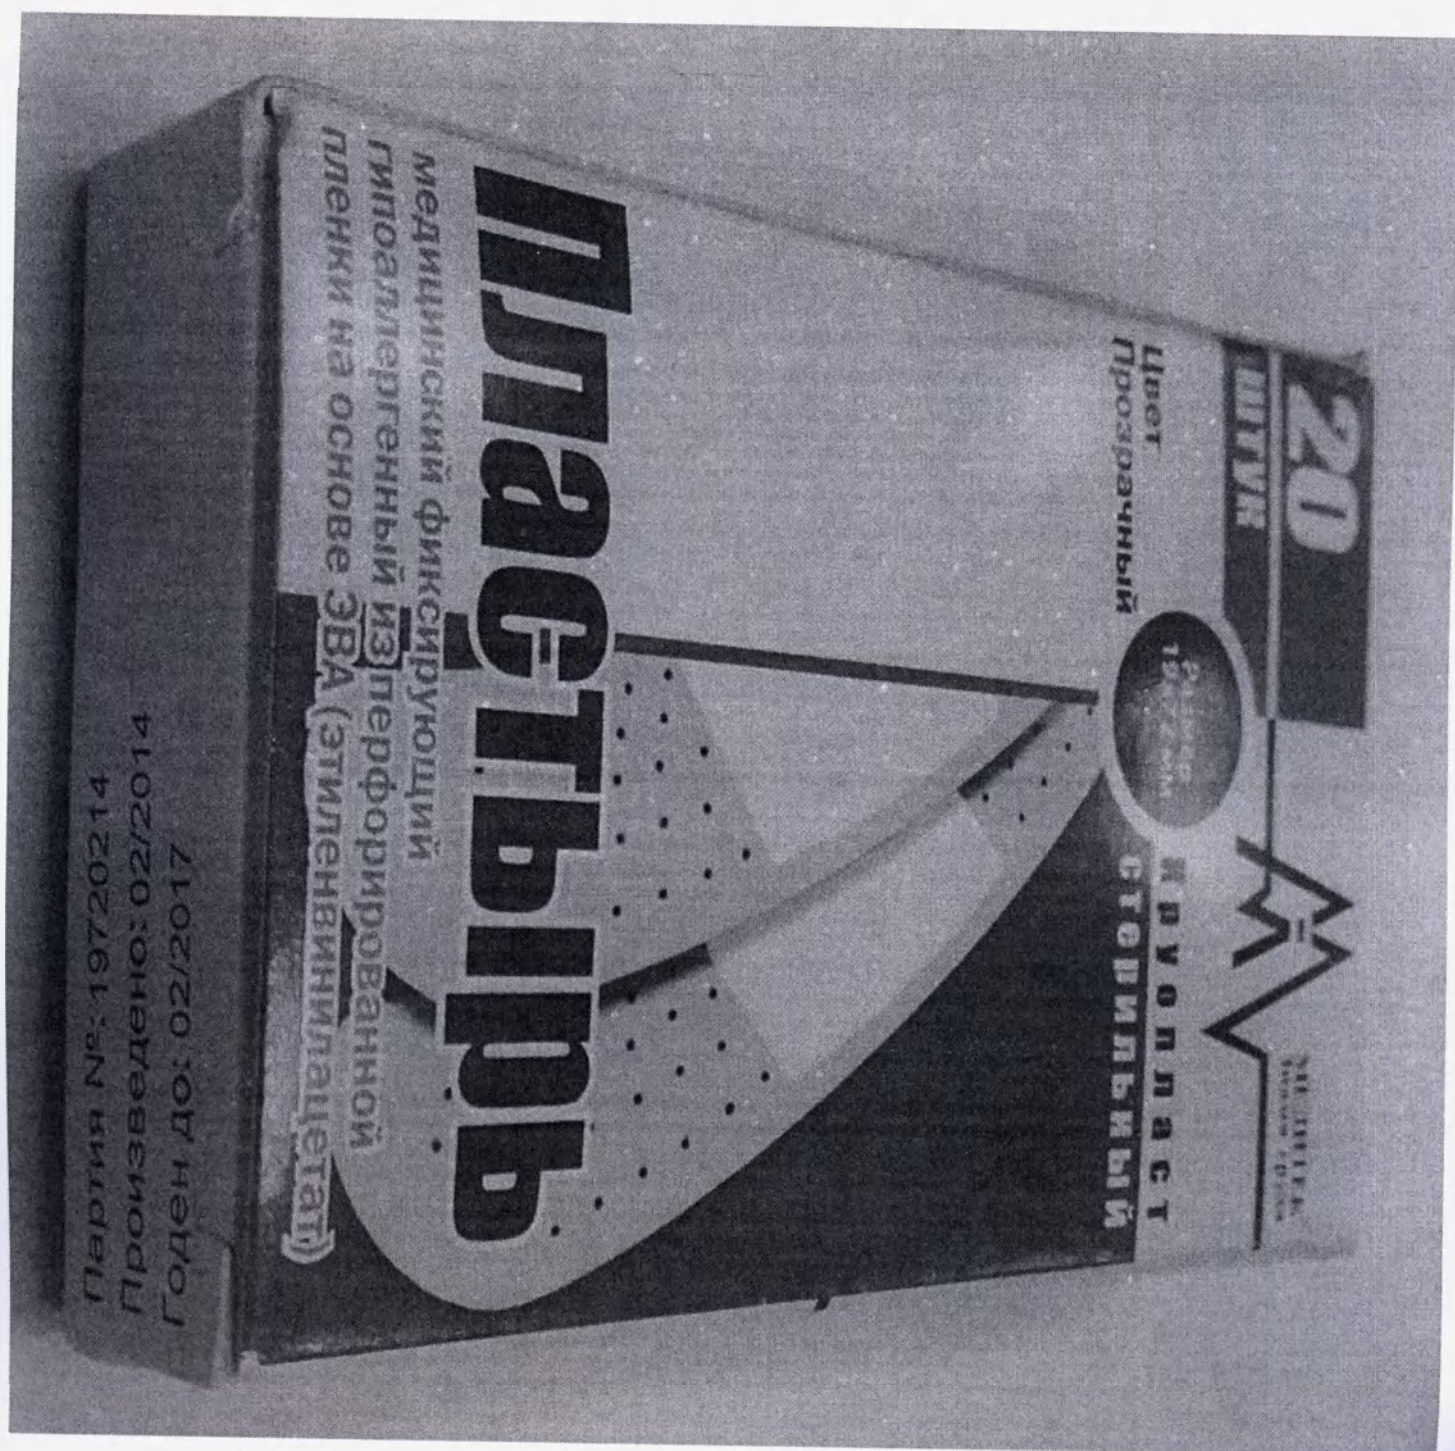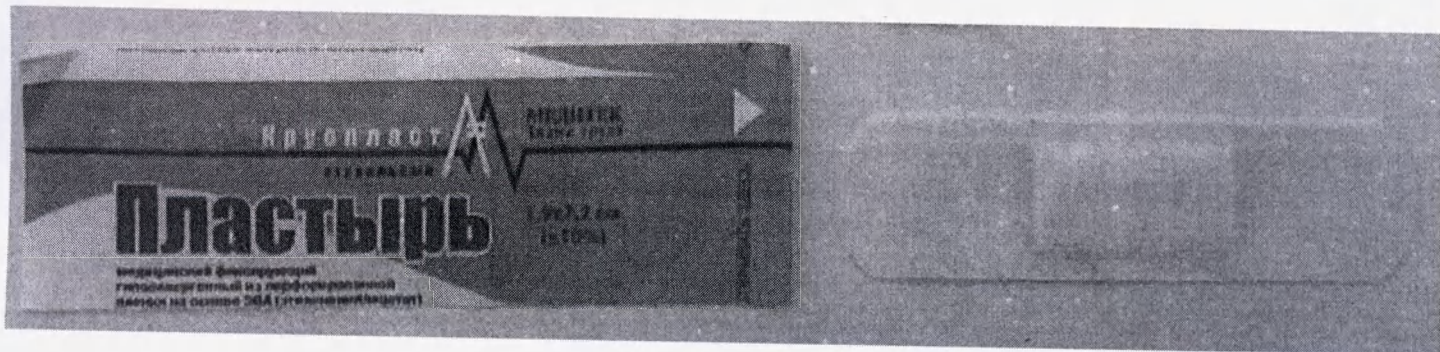

Пластырь медицинский фиксирующий Круподерм



МЕДИТЕК
Знамя Труда

КРУПОДЕРМ[®]

801016

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.", Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Импортер:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,

Магнитогорская ул., 11 лит. А

тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73


Претензии потребителей принимаются импортером.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Годен до: см. на упаковке.

Рег. Уд. ФСЗ № 2010/07988 от 04.06.2013 г.

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru



Серия номер: 10250214

Произведено: 02/2014

Годен до: 02/2017



размер
10x25cm
(±10%)

Применение: для стерильного ухода за послеоперационными ранами и прочими повреждениями кожи, для защиты участков введения внутривенных катетеров и мест венопункции.
Нетоксично. Стерильно.

Состав: основа - нетканый материал, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.

МЕДИТЕК
ЗНАМЯ ТРАДА

КРУТОДЕРМ®

These products are manufactured by Wuyang Medical Co., Ltd., 31 Jiefang Road, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

AND THE POLICE "Support Police", *Phoenix*, 1992/2, Column 16 (1992).

Received for publication 15 October 1998; accepted 10 February 1999.

Consequently, the results will be more relevant to a population that is more similar to the sample.

3. Of course, as indicated, only 72,000 people are employed

© 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Proc. R. Soc. B 2013, 201308205. doi:10.1098/rspb.2013.08205

ЗАО "МЕДИТЕК" ЗАО "Земельный"
195027, Россия, Санкт-Петербург


www.medit4u.com

[illegible]

© 2000 by The McGraw-Hill Companies

For the purpose of this study, the following definitions were used:

100% satisfaction. We have a 24-hour hotline for any questions or concerns. We are committed to providing the best possible service to our customers.



4162076819387641

размер
10x30 см
(±10%)


МЕДИТЕК
ЗНАМЯ ТРУДА

801018


© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 161–168



размер
10x35 cm
(±10%)

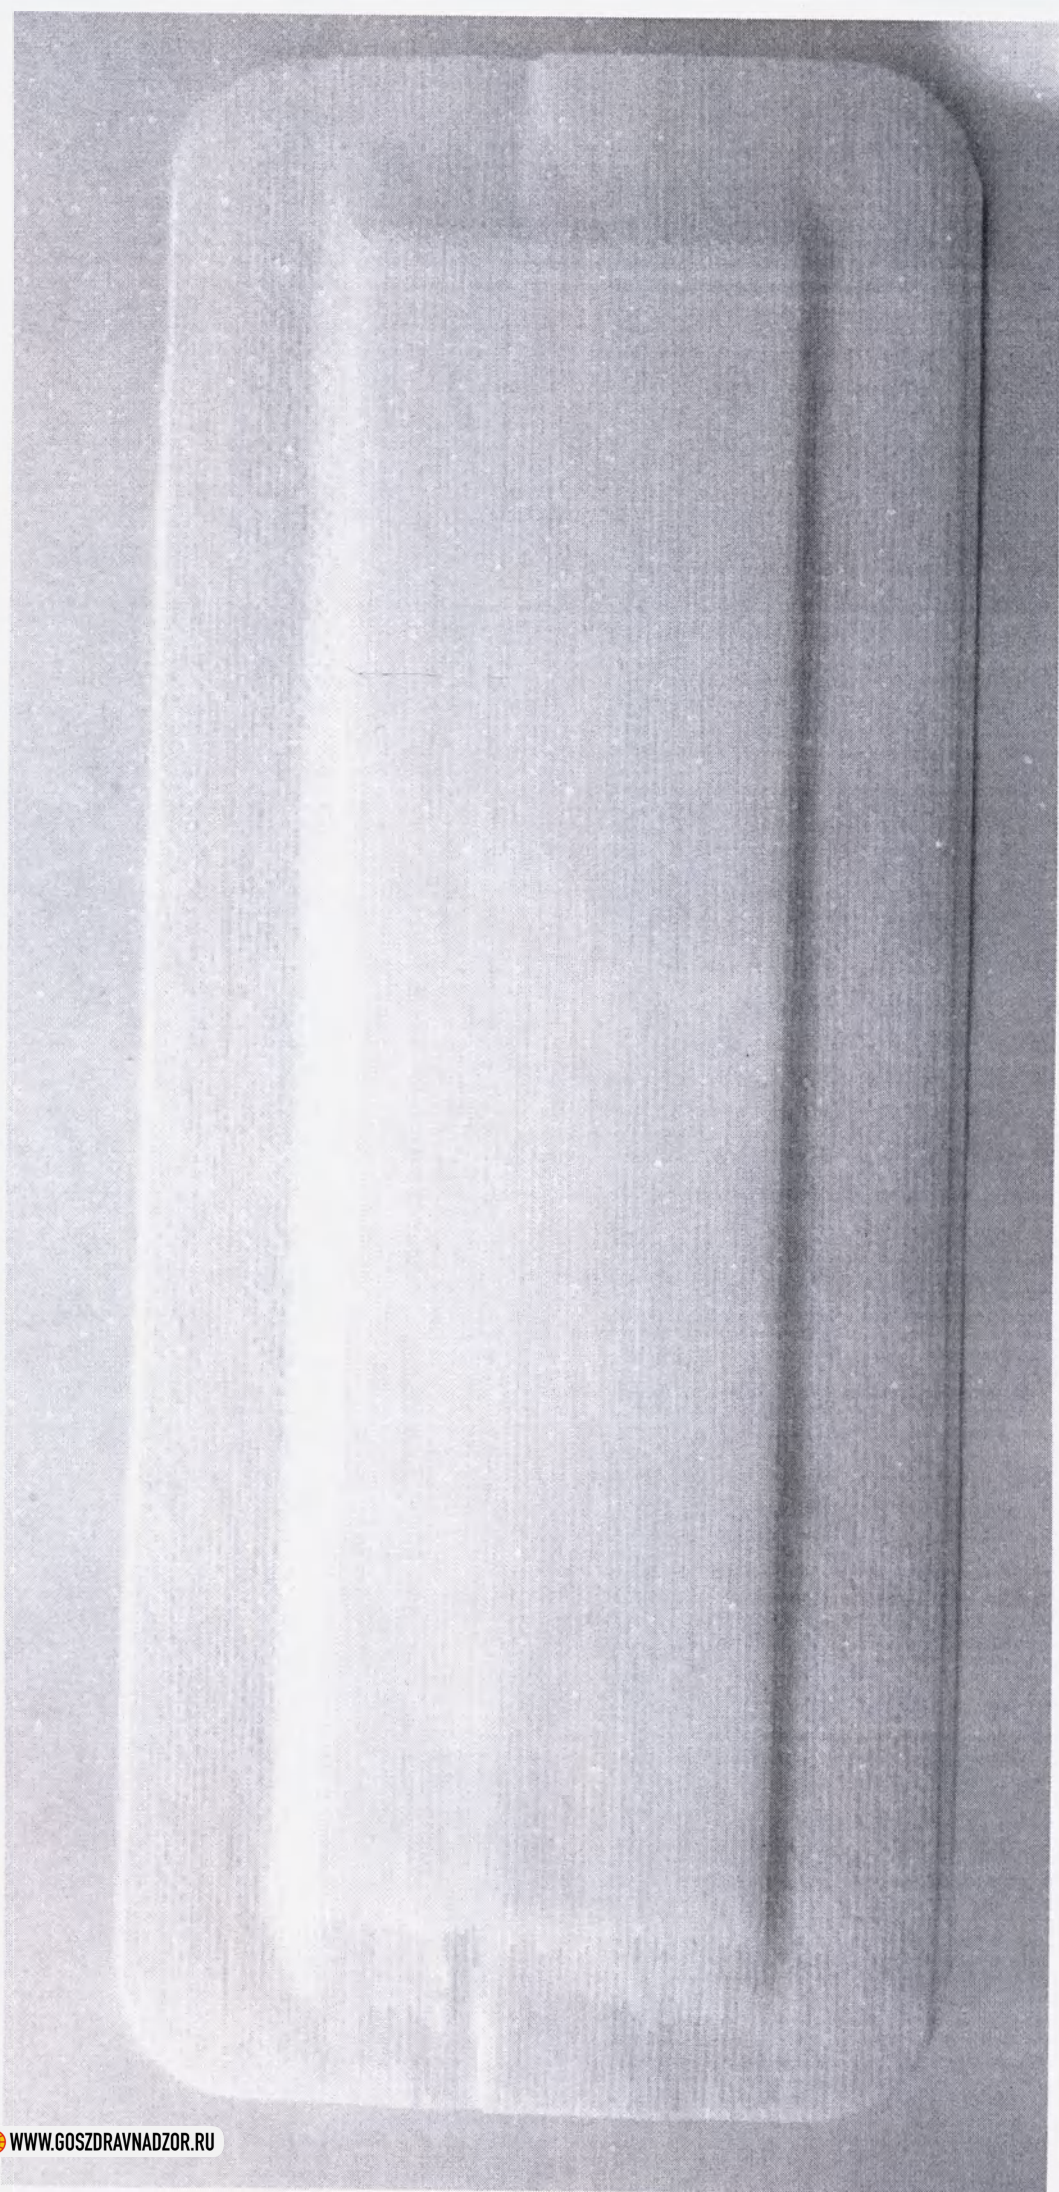

71

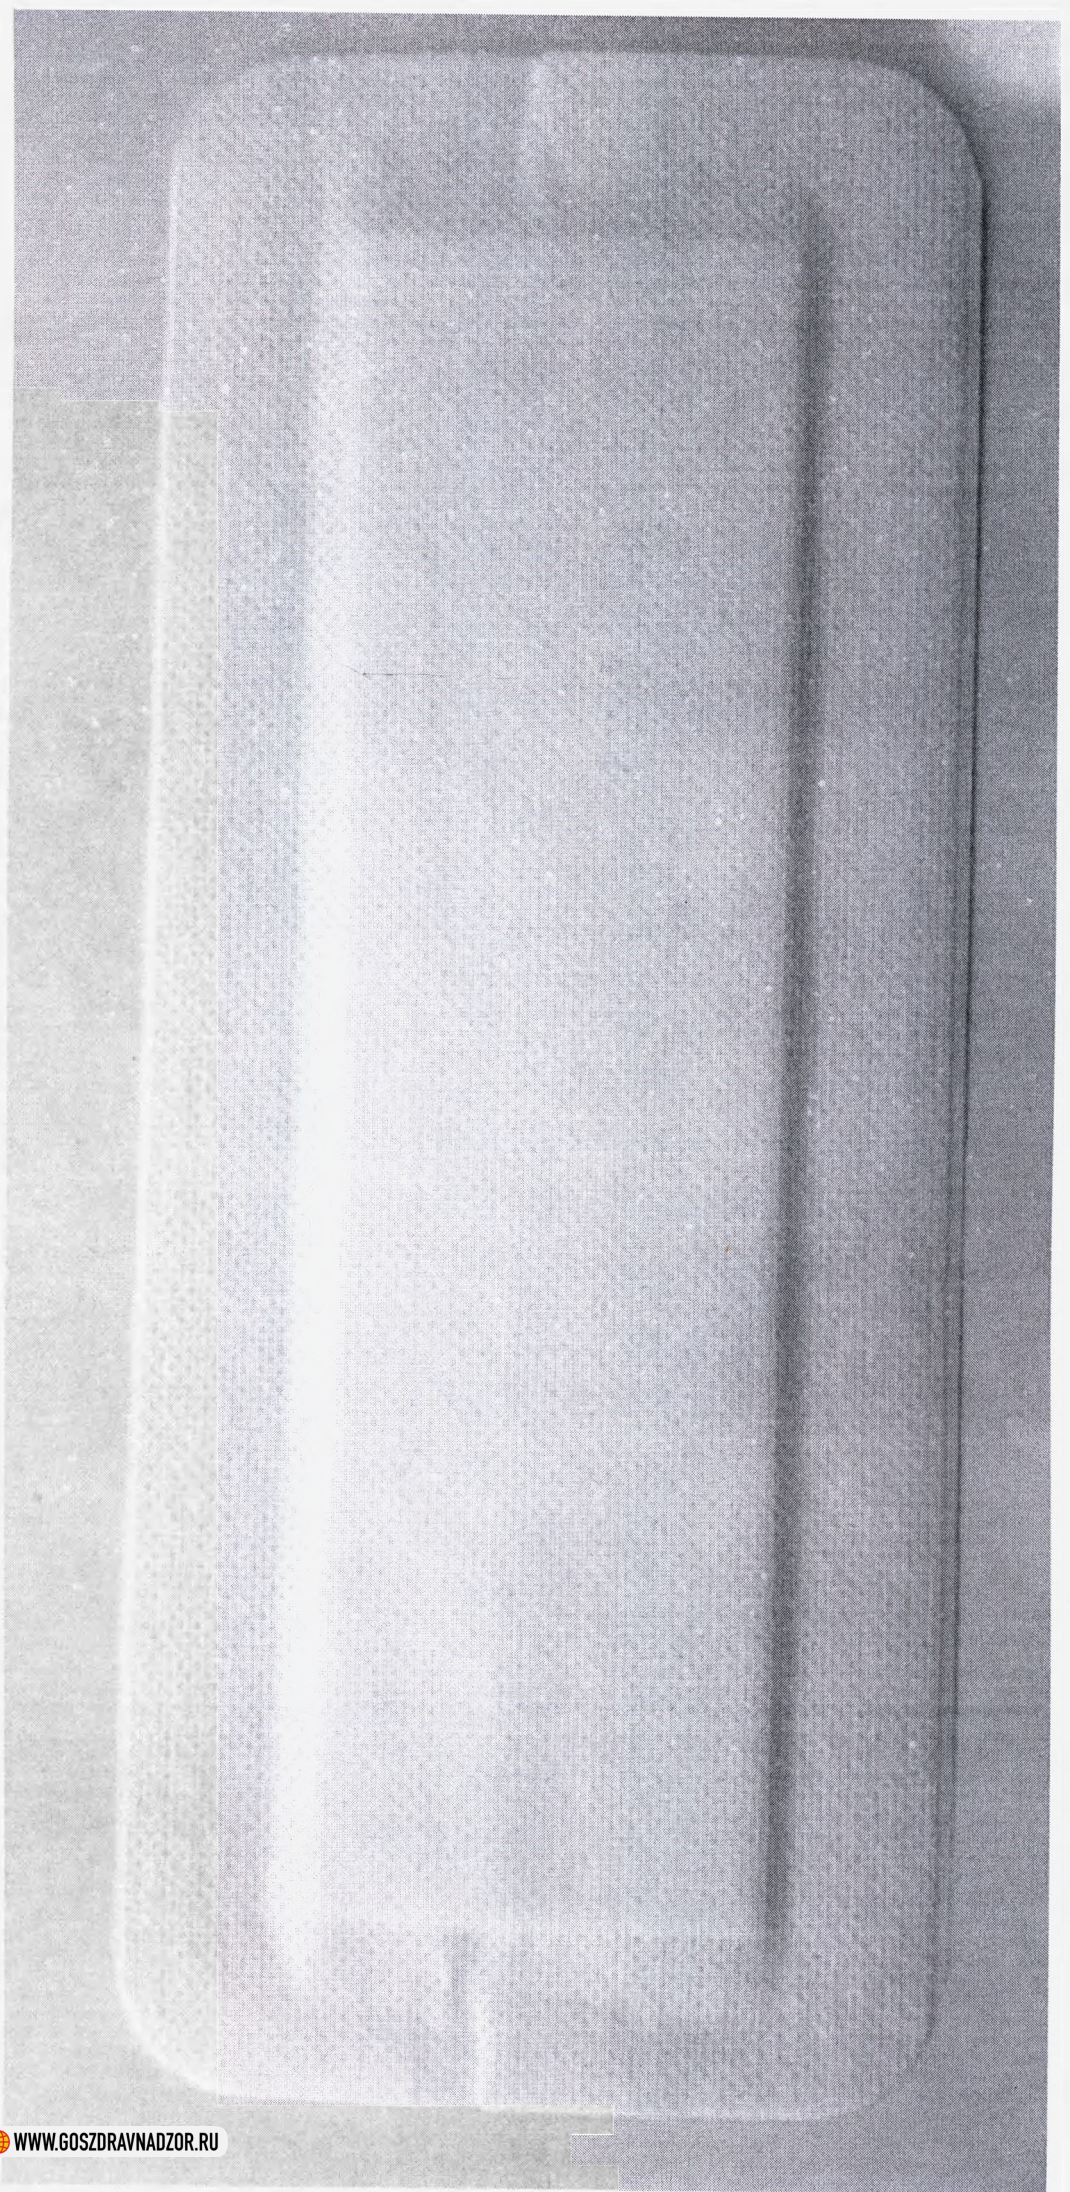

Пластырь медицинский фиксирующий Круосорб



МЕДИТЕК
Знамя Труда

Гипоаллергенная стерильная прозрачная
самоклеющаяся повязка на основе полимерной пленки



КРУОСОРБ

811212

Серия номер: 09150114

Произведено: 01/2014

Годен до: 01/2017

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru

Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China

Импортер:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются импортером.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Годен до: см. на упаковке.

Рег. Уд. ФСЗ № 2010/07988 от 04.06.2013 г.

Применение: для закрытия неинфицированных ран, фиксации катетеров и канюль,
покрытия повязок.

Нетоксично. Стерильно.


Состав: основа - полупроницаемая полимерная пленка, адгезив - безвредный
для кожи полиакрилат.

размер
9x15cm
(±10%)



STERILE EO



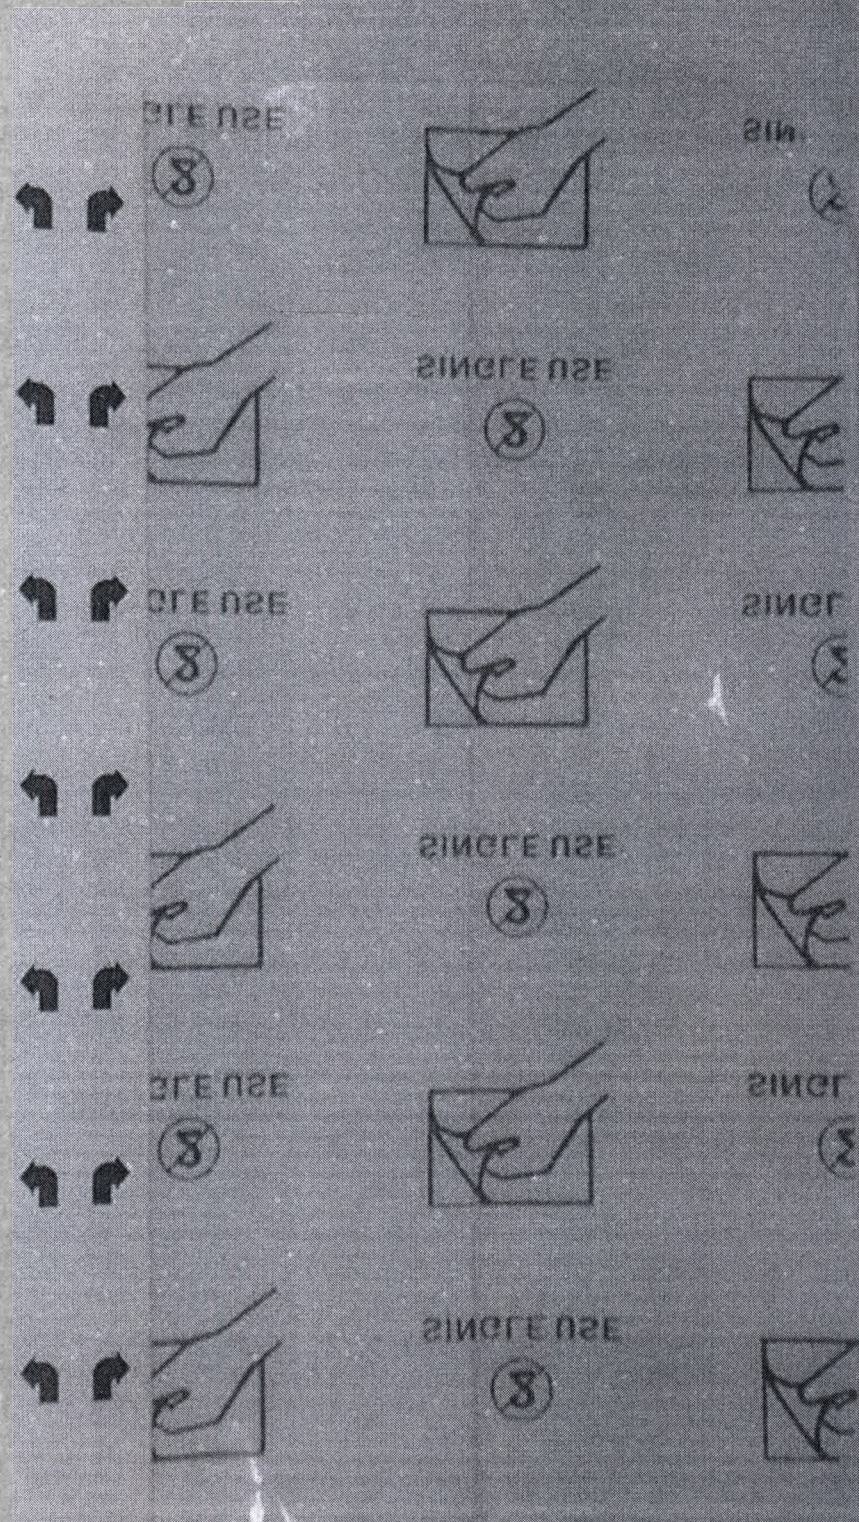

Пластырь медицинский фиксирующий Круотек



МЕДИТЕК
Знамя Труда

Стерильная гипоаллергенная самоклеющаяся повязка
на полимерной основе с впитывающей подушечкой

КРУОТЕК

802016

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.", Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Импортер:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. Ател.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются импортером.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Годен до: см. на упаковке.

Рег. Уд. ФСЗ № 2010/07988 от 04.06.2013 г.

Серия номер: 10200214


Произведено: 02/2014

Годен до: 02/2017

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"

195027, Россия, Санкт-Петербург.

www.mediteczt.ru




размер
10x20cm
(±10%)



Применение: для стерильного ухода
за послеоперационными ранами и прочими
повреждениями кожи, для защиты участков
введения внутривенных катетеров и мест
венепункции. Состав: основа - полупроницаемая
полимерная пленка, адгезив - безвредный для кожи
полиакрилат.
Нетоксично. Стерильно.
Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.

18

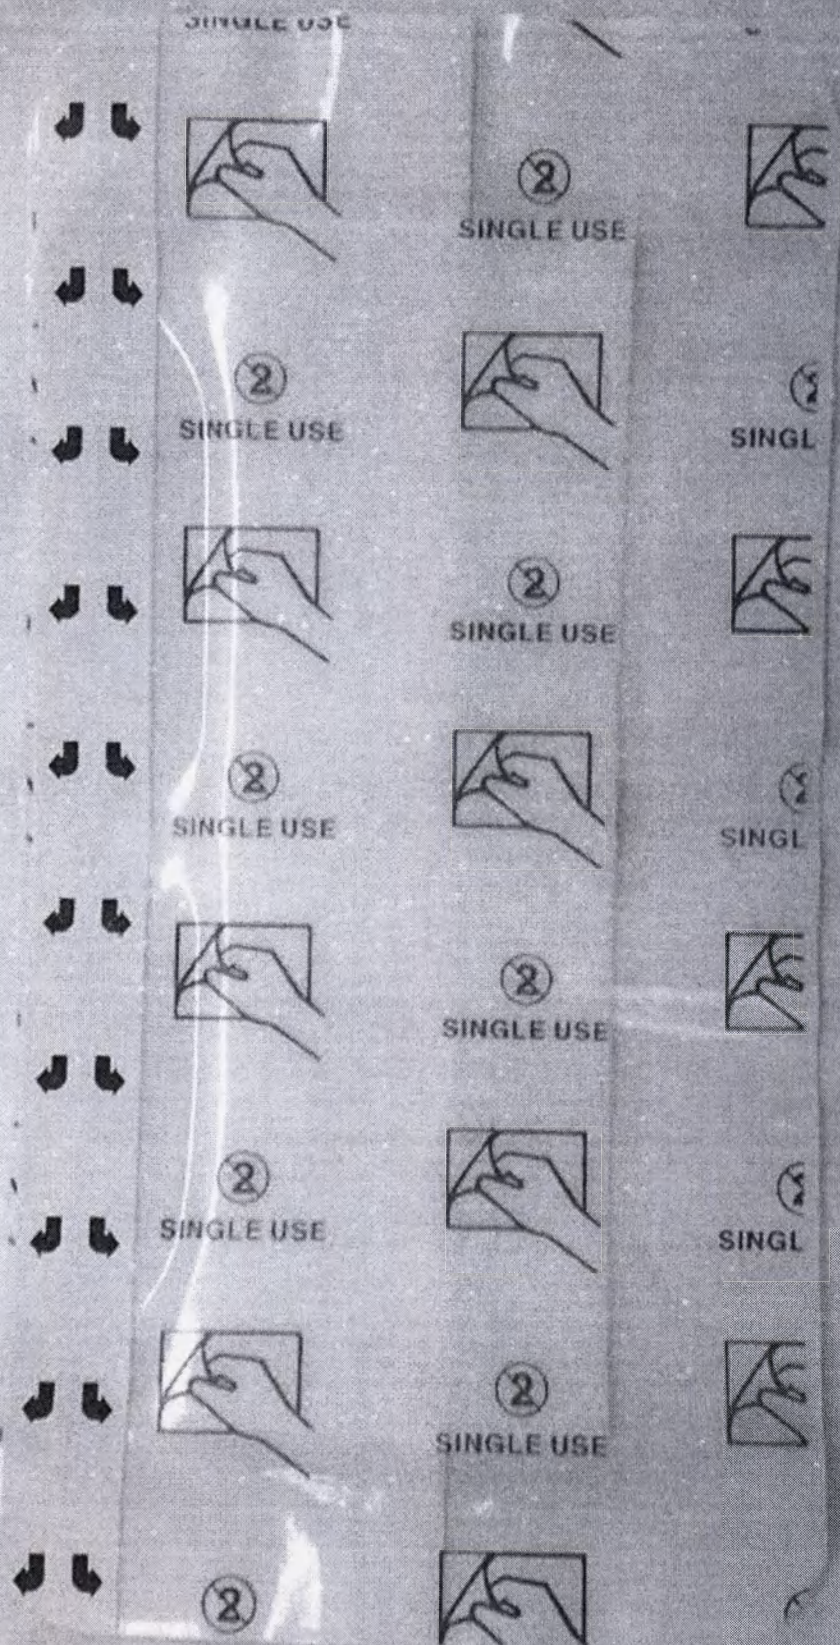

Пластырь медицинский фиксирующий Крюофрейм



МЕДИТЕК
Знамя Труда

Гипоаллергенная стерильная повязка
для фиксации центральных и периферических внутривенных катетеров.

КРЮОФРЕЙМ

размер
8x13,5 см

812009

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.

Производитель:

"БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co.,
Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu,
Guangzhou, China

Импортер:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А, тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются импортером.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Годен до: см. на упаковке.

Рег. Уд. ФСЗ № 2010/07988 от 04 июня 2013 года.

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"

195027, Россия, Санкт-Петербург.

www.meditecz.ru

Серия номер: 08130214

Произведено: 02/2014


Годен до: 02/2017



Применение: для фиксации центральных и периферических
внутривенных катетеров.

Состав: основа - пенополиэтилен полупроницаемая
полимерная пленка, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.




ИМ 35





12

000710 EN IPN

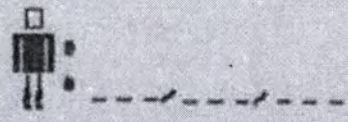

27 96

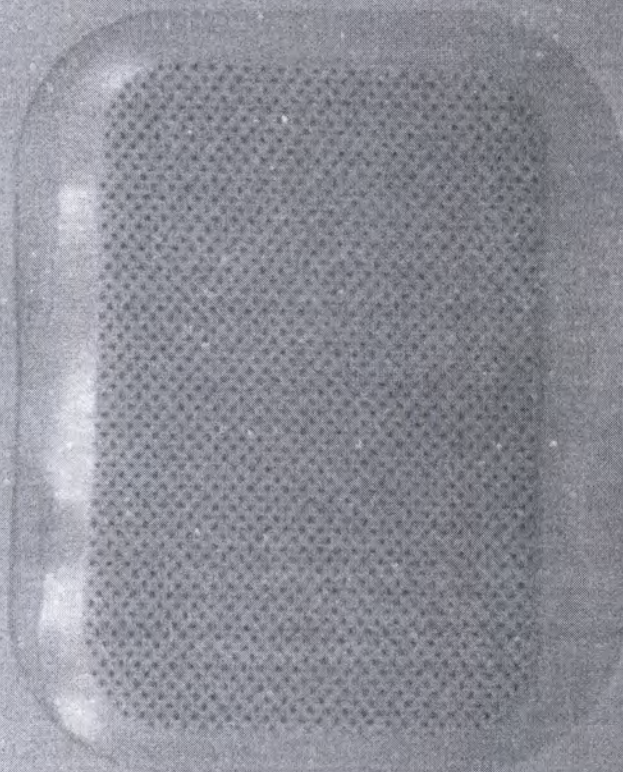

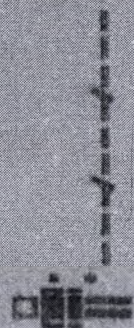

Пластырь медицинский фиксирующий Круопэд



МЕДИТЕК
Знамя Труда



4 620768 931192

КРУОПЭД®

801020

Серия номер: 12140214
Произведено: 02/2014
Годен до: 02/2017

размер
12x14cm
(±10%)

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C


Годен до: см. на упаковке.

Рег. Уд. ФСЗ № 2010/07988 от 04.06.2013 г.

Применение: для фиксации катетеров: дренажных
и периферических.


Нетоксично. Стерильно.

Состав: основа - нетканый
материал, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат
Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.




STERILE EO



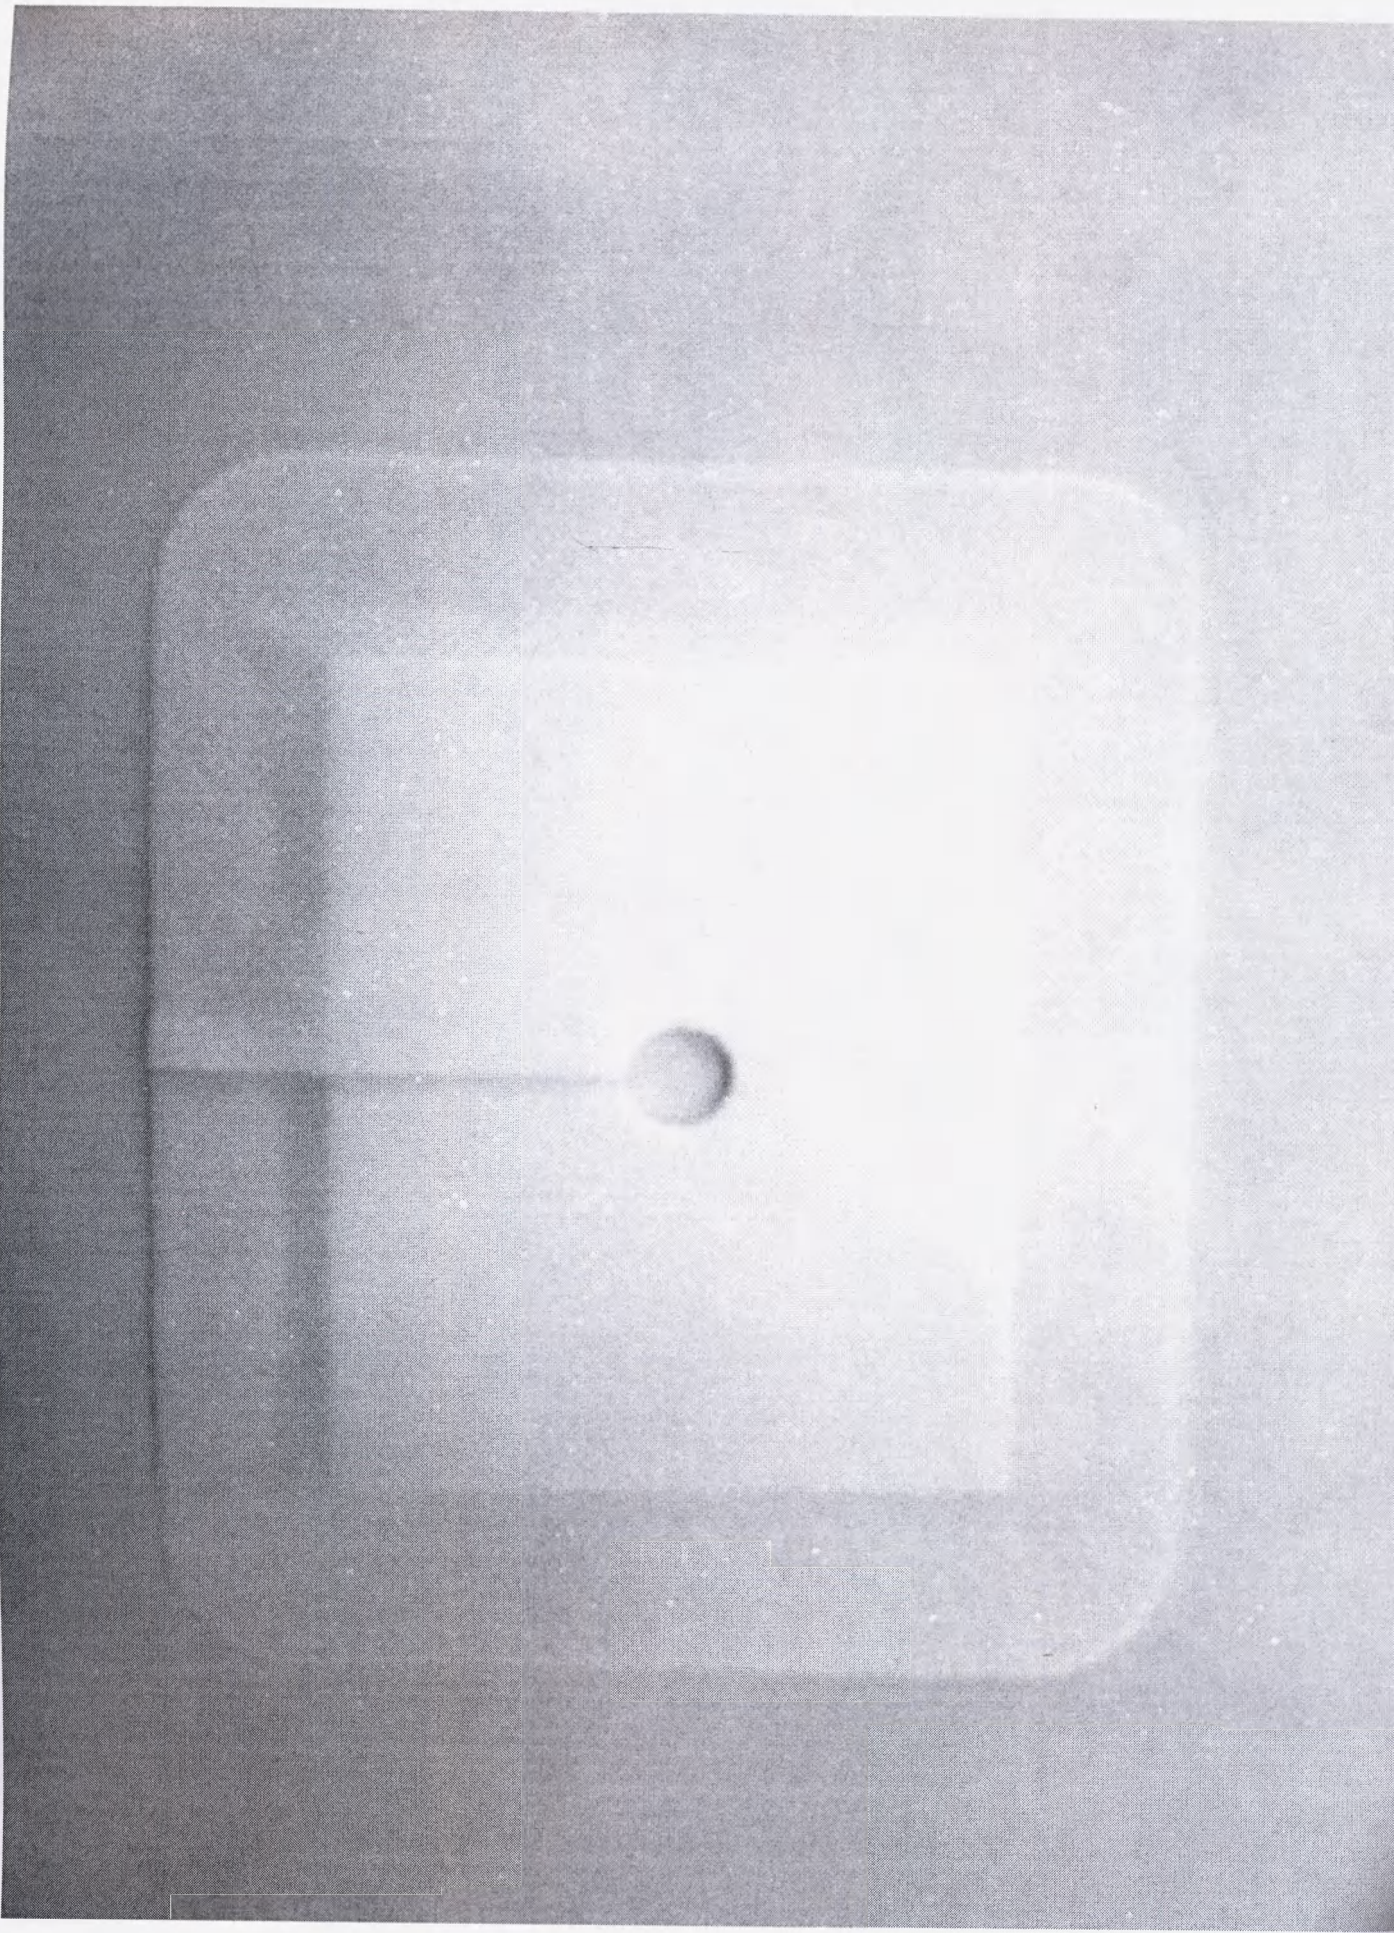

2 2 2 2 2 2

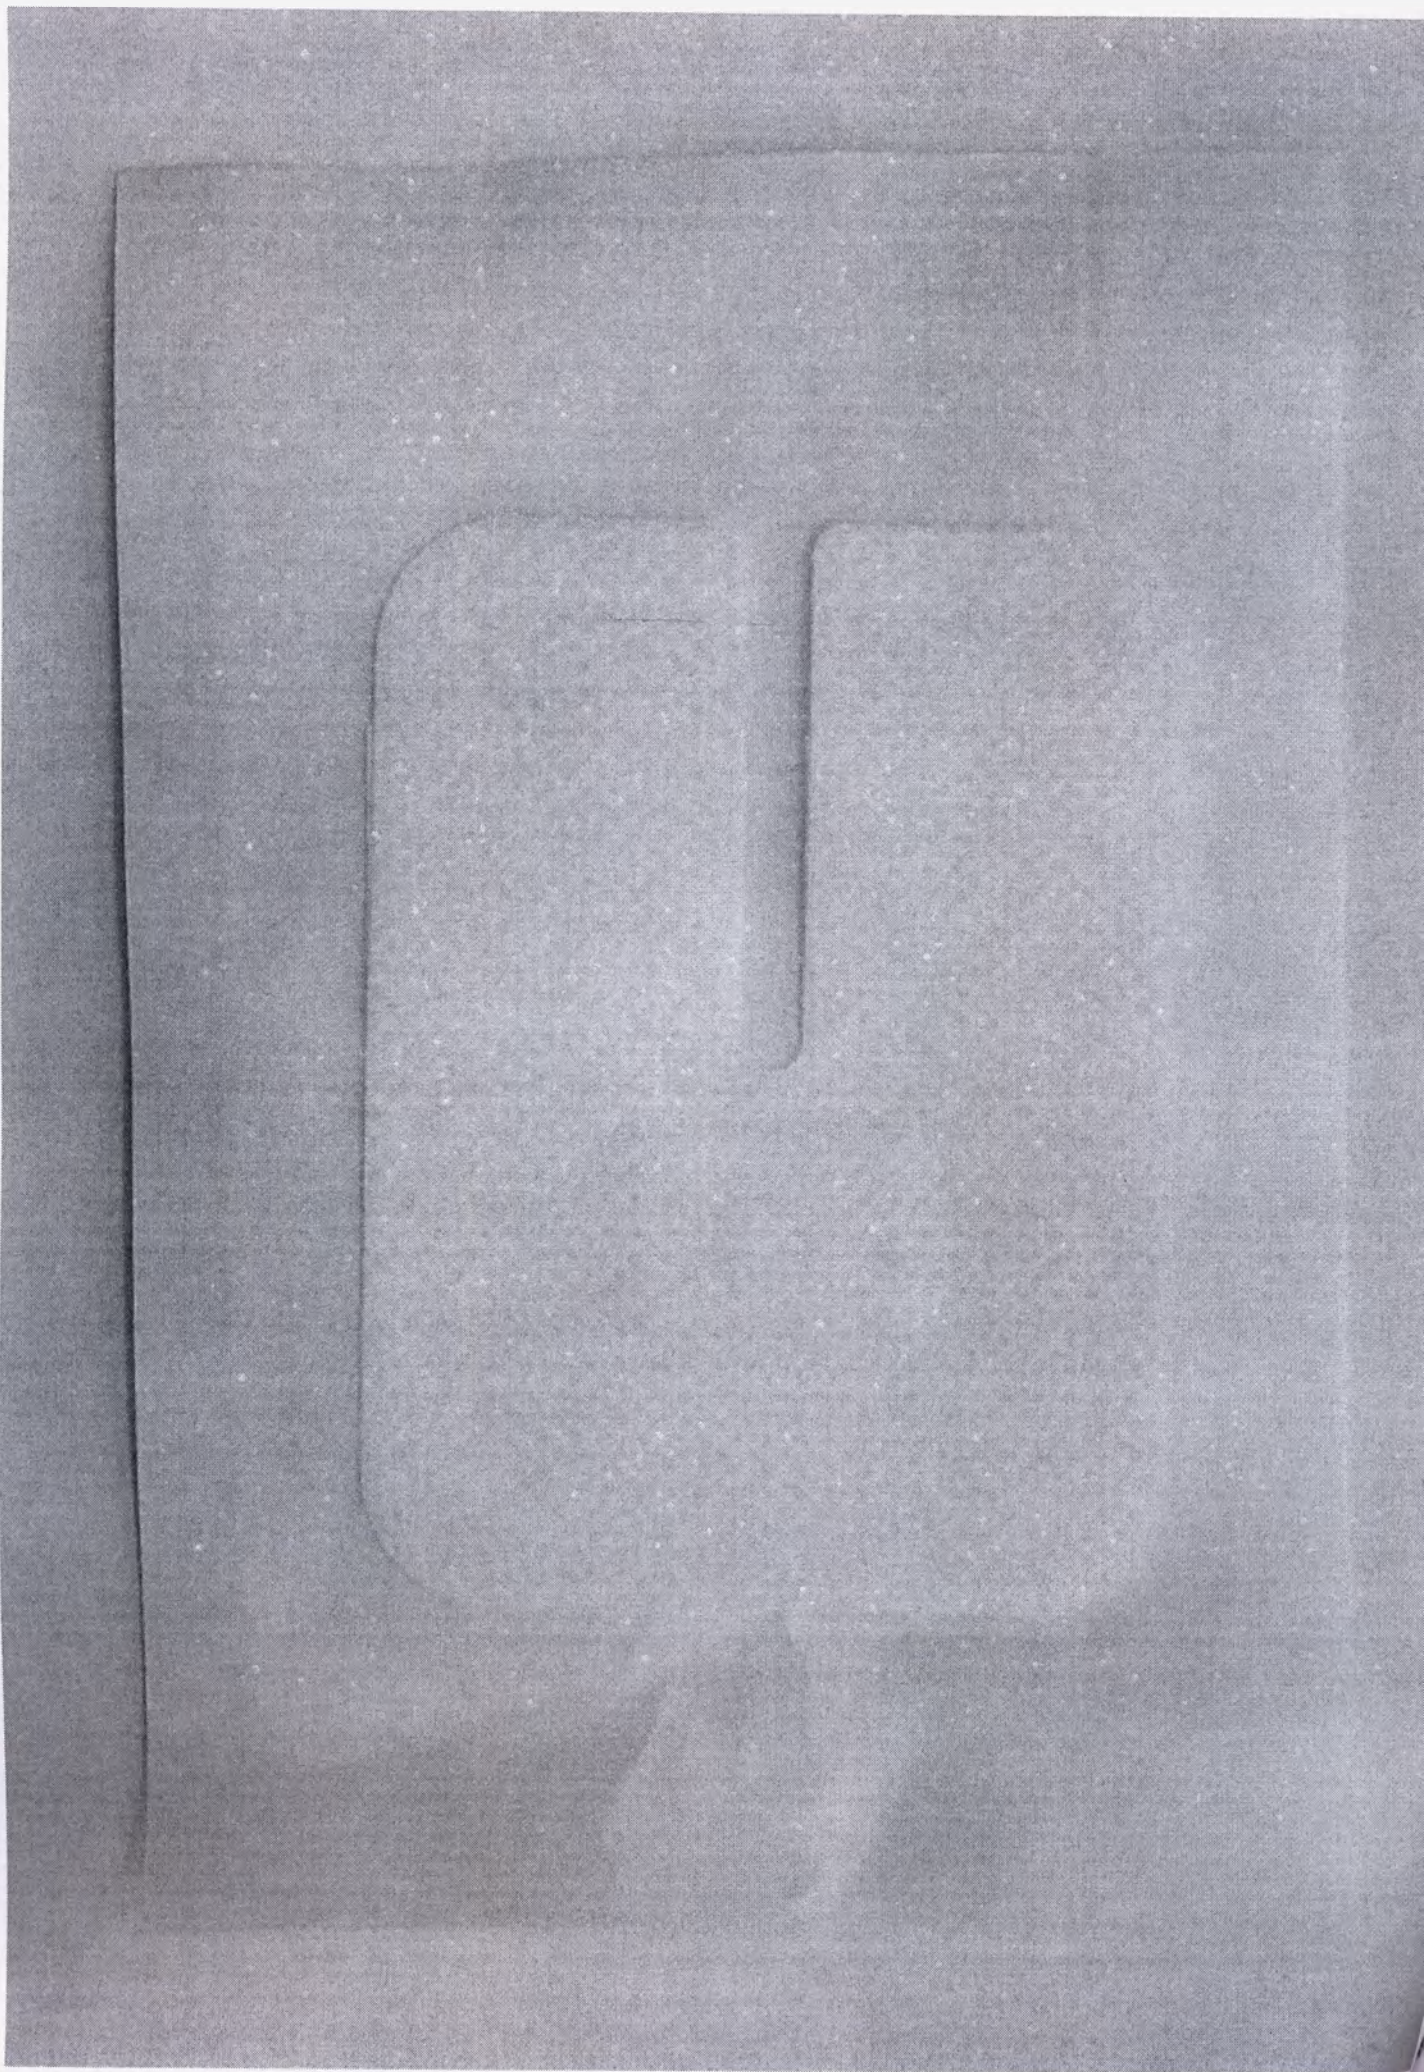

SINGLE USE




SINGLE USE



SINGLE USE



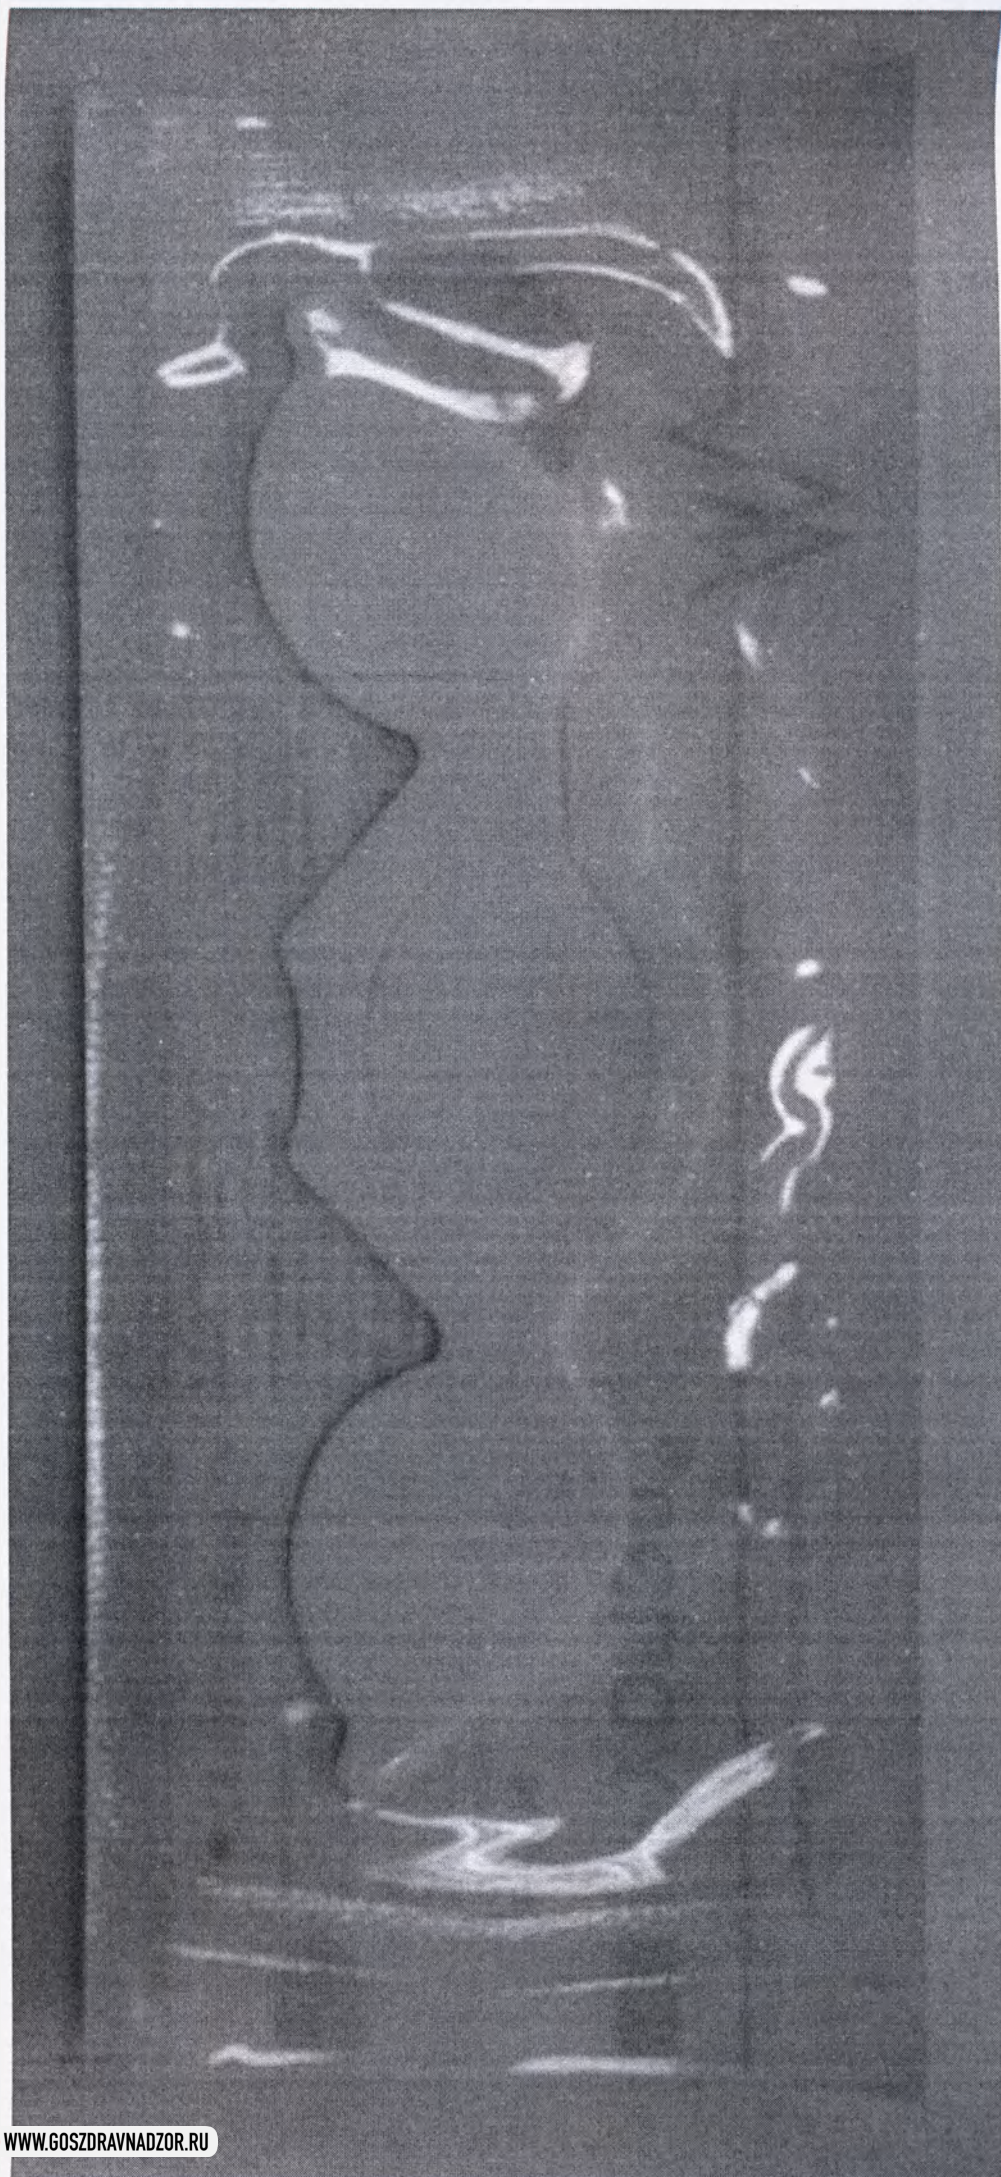

Пластырь медицинский фиксирующий Холмекс
Стерильное разрезаемое операционное покрытие



МЕДИТЕК
Знамя Труда

ХОЛМЕКС

805025


Серия номер: 30400214

Произведено: 02/2014

Годен до: 02/2017

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczf.ru

Способ наложения - вскрыть, достать, наложить,
менять по рекомендации врача
или по мере необходимости.



STERILE EO



Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель:

"БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.", Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81,
Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Импортер:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются импортером.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C

Годен до: см. на упаковке.

Рег. Уд. ФСЗ № 2010/07988 от 04.06.2013 г.

Состав: основа - особо тонкий полимер с антибликовым покрытием, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат



Применение: накладывается на операционное поле, после обычной предоперационной подготовки.

Разрез производится непосредственно через пленку, которая остается на коже до конца операции.

Натяжно. Стерильно.



размер
30x40cm
(±10%)

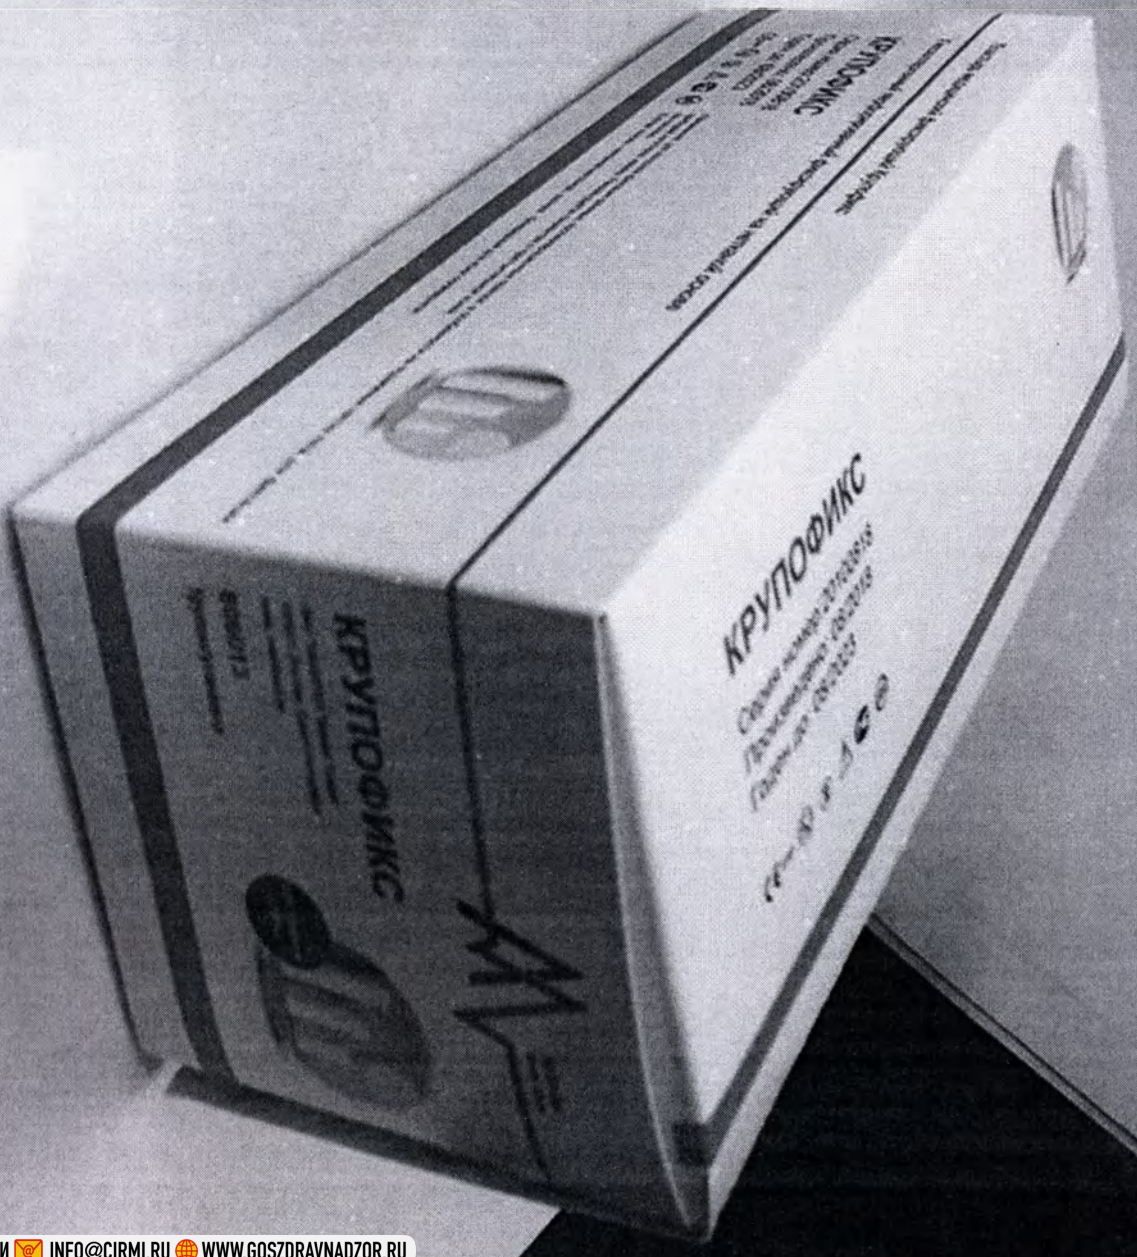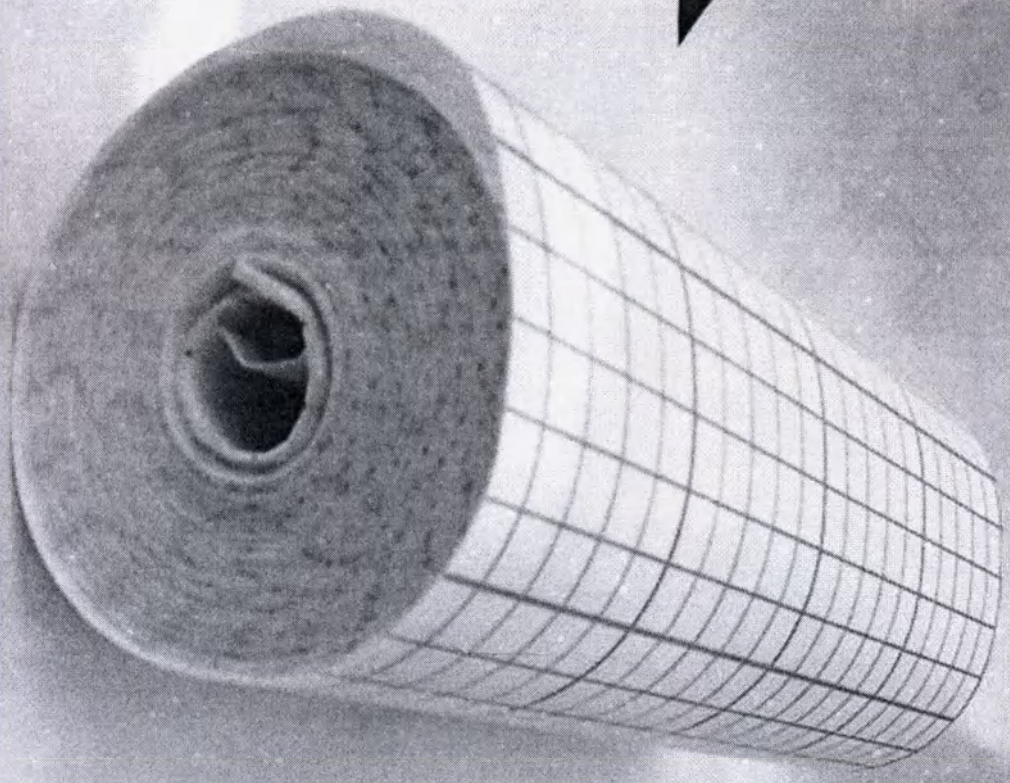

КРУПОФИКС



Модель
Модель 1000

Плоскостной фотоаппарат

Гидроаппаратный фотоаппарат
на нетканой основе
КРУПОФИКС


Серия номер: 20100114
Производство: 01/2014


Годен до: 01/2017

CE - 3 A C O

После проверки в течение 14 дней
на предмет наличия дефектов
на основании гарантийного
сертификата.



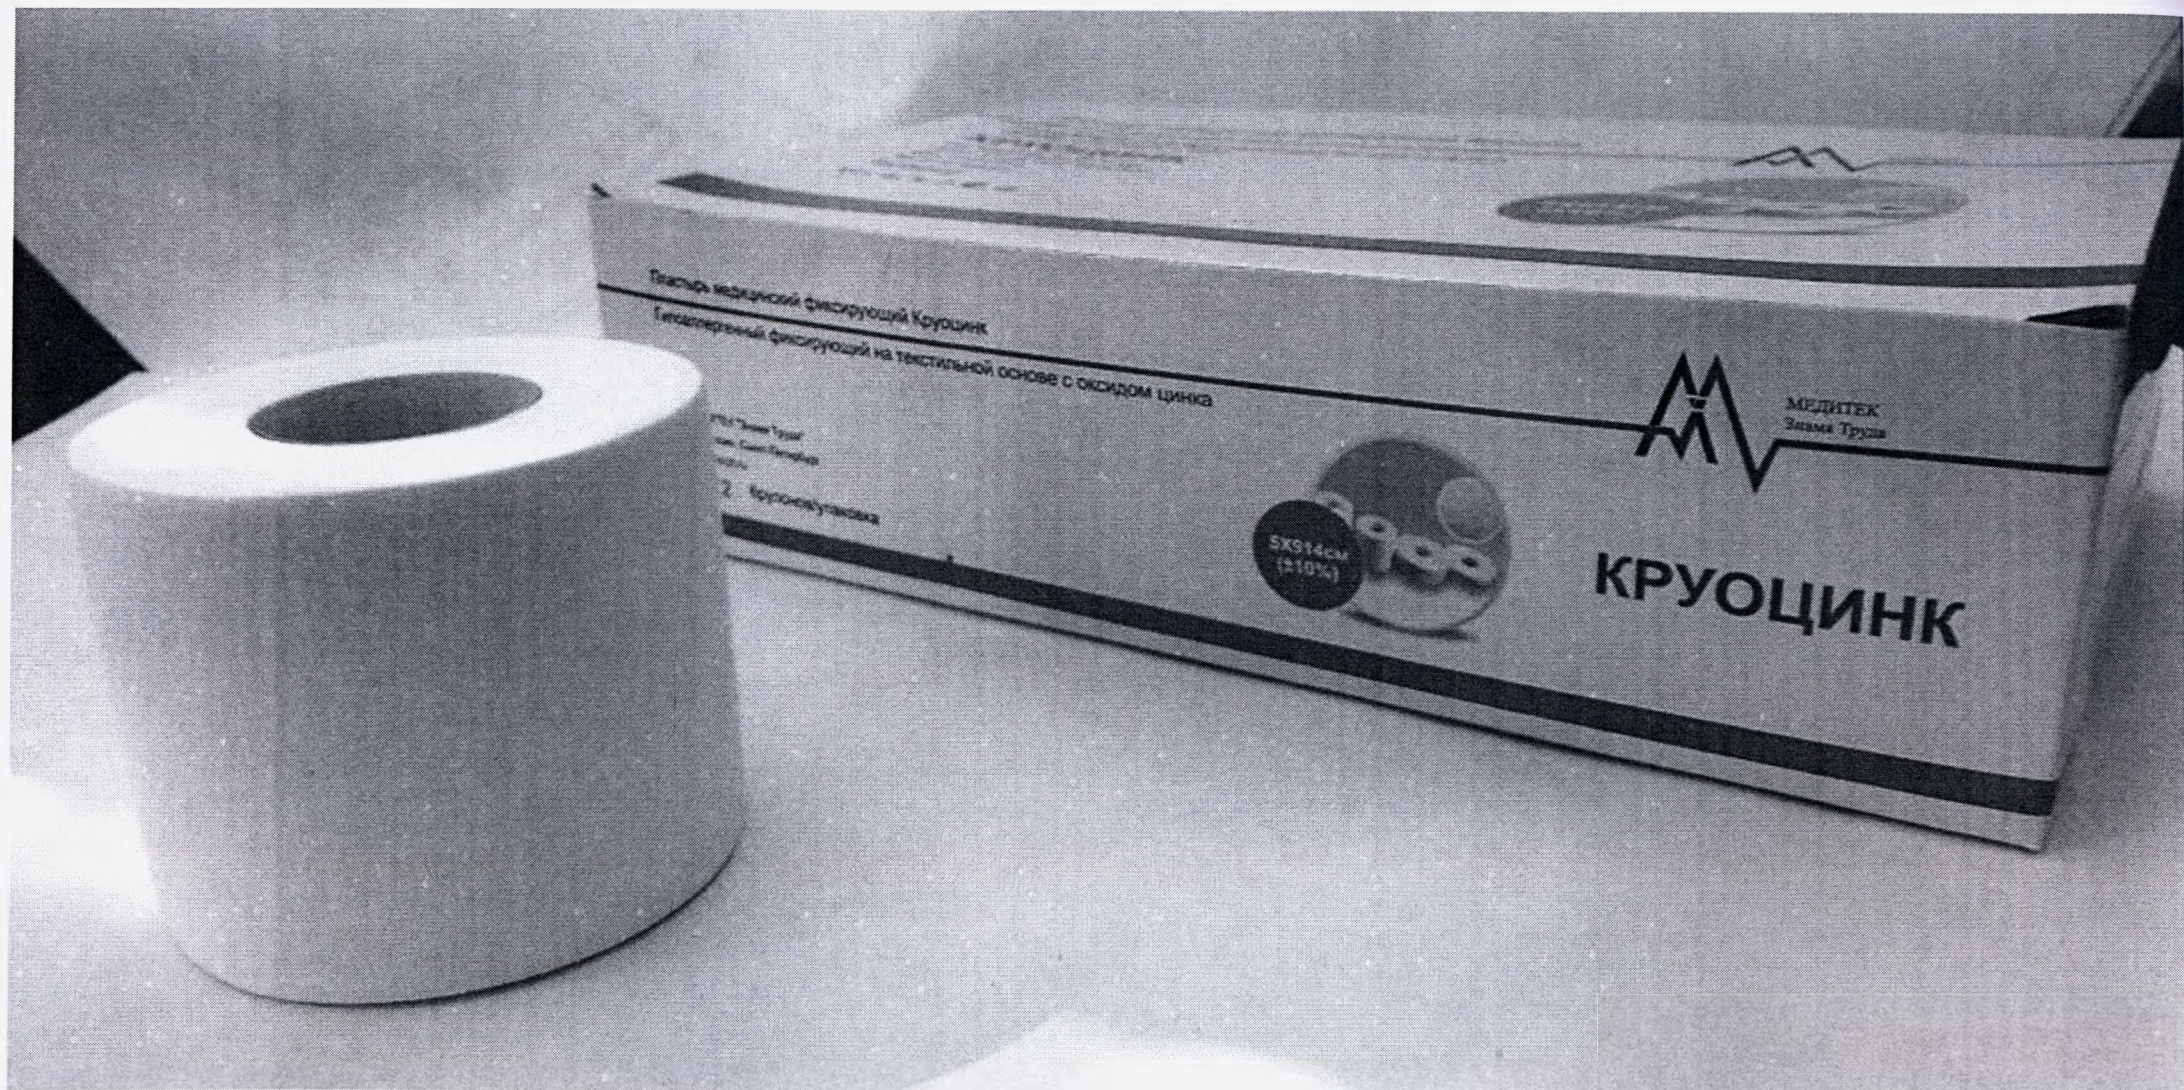

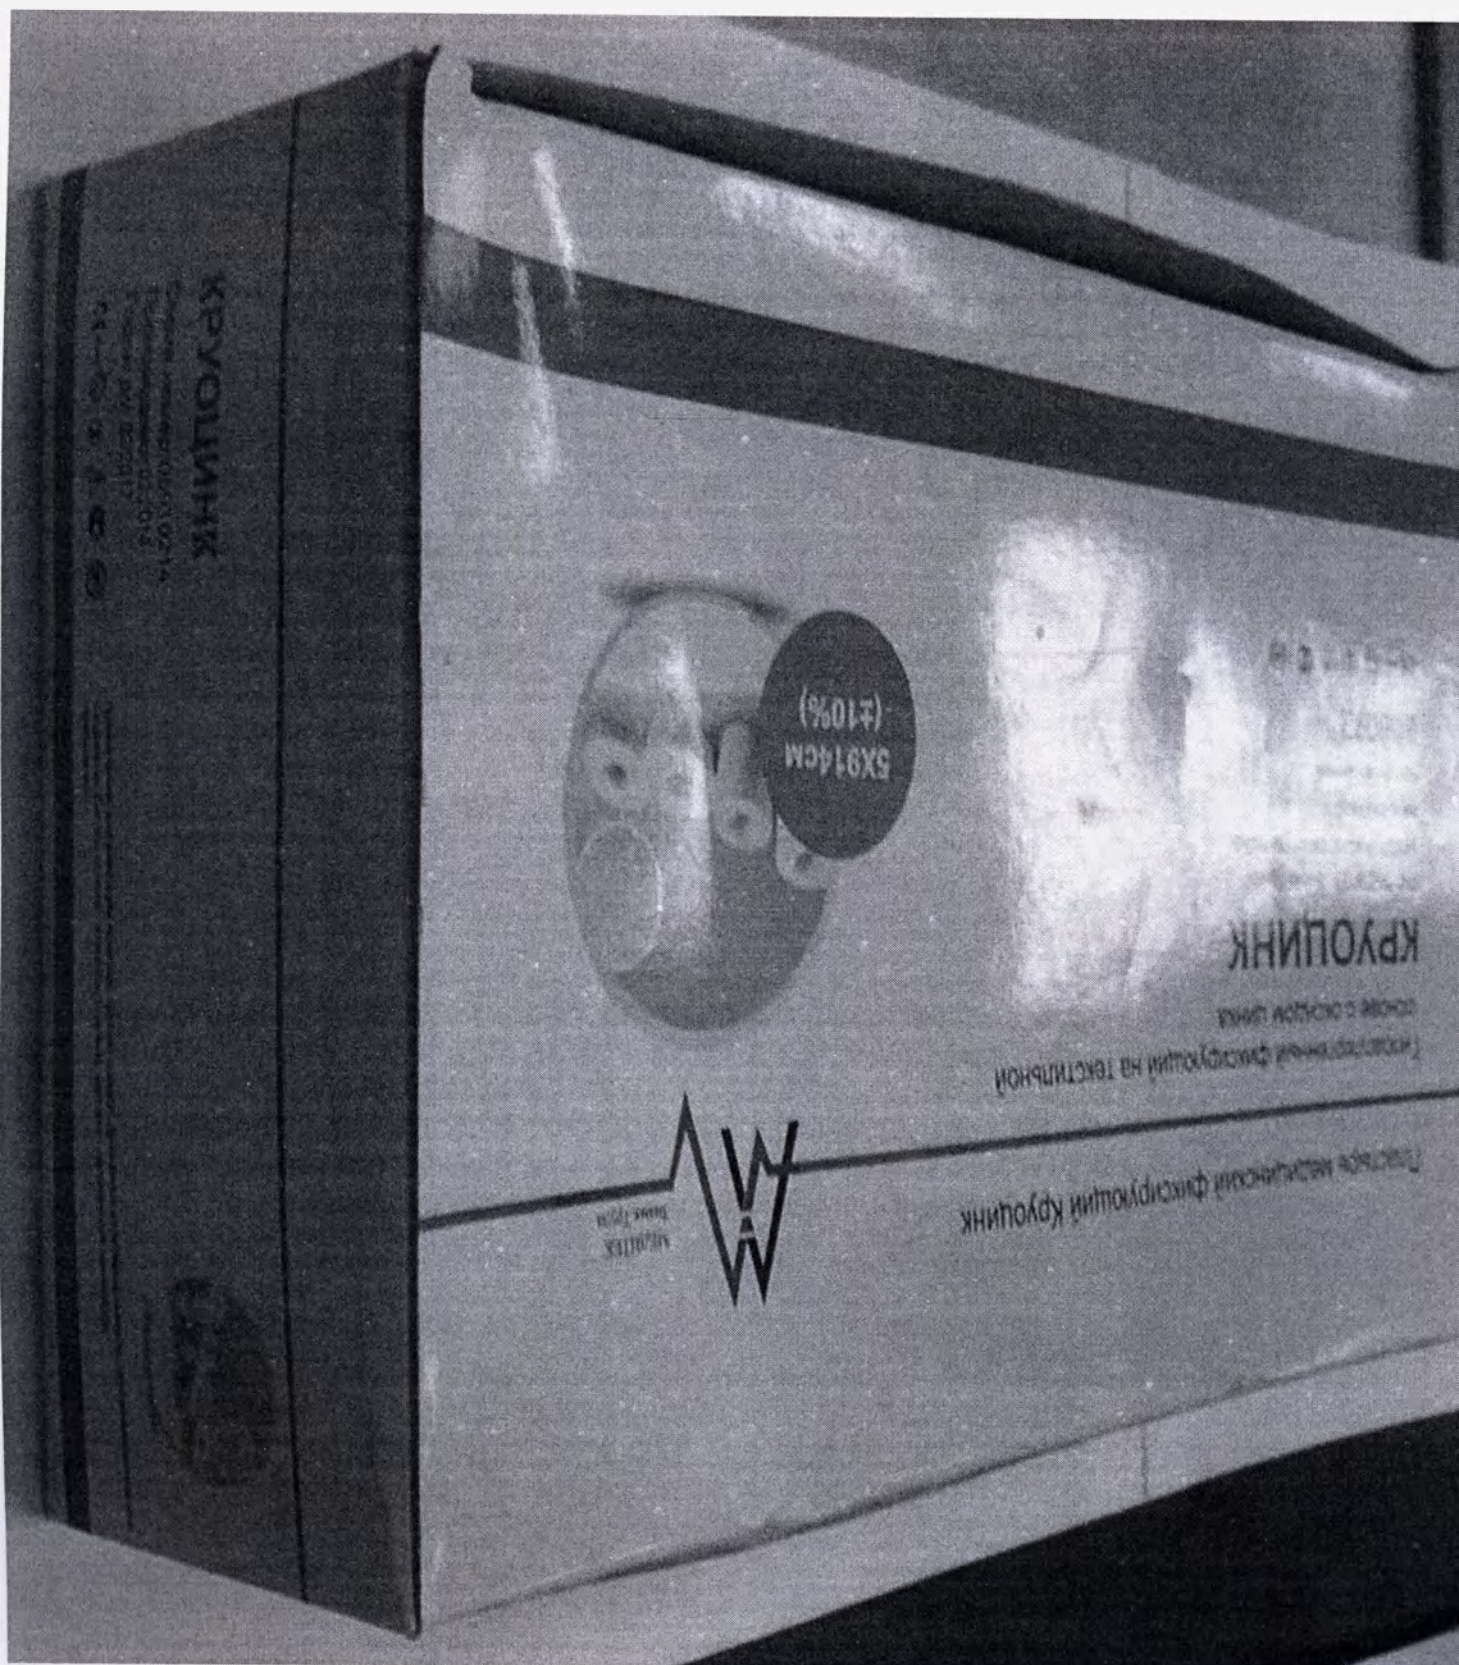

Пластырь медицинский фиксирующий Крюкид




КРЮКИД

811310

Серия номер: 05050414
Произведено: 04/2014
Годен до: 04/2017

размер
5x5 см
(±10%)

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru



Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "ВАЙСИНЬ Медицин Ко. Лтд.",

Китай, WATSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,

Huang Pu, Guangdong, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,

Маршаторская ул., 11 лит. А

тел: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Требования потребителей принимаются

уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте,

при температуре не выше 30°C

Годен до: см. на упаковке.

Рег. Уд. ФСЗ № 2010/07988 от 04.06.2013 г.

Применение: для стерильного ухода за небольшими

операционными ранами и прочими повреждениями кожи,

для защиты участков введения внутривенных катетеров

и мест венепункций, для фиксации катетеров.

Неотоксично. Стерильно.

Состав: основа - нетканый материал, адгезив -


гидролизный, безвредный для кожи медицинский клей.

Способ применения: вскрыть упаковку, достать пластырь,

наложить пластырь, менять по рекомендации врача

или по мере необходимости.



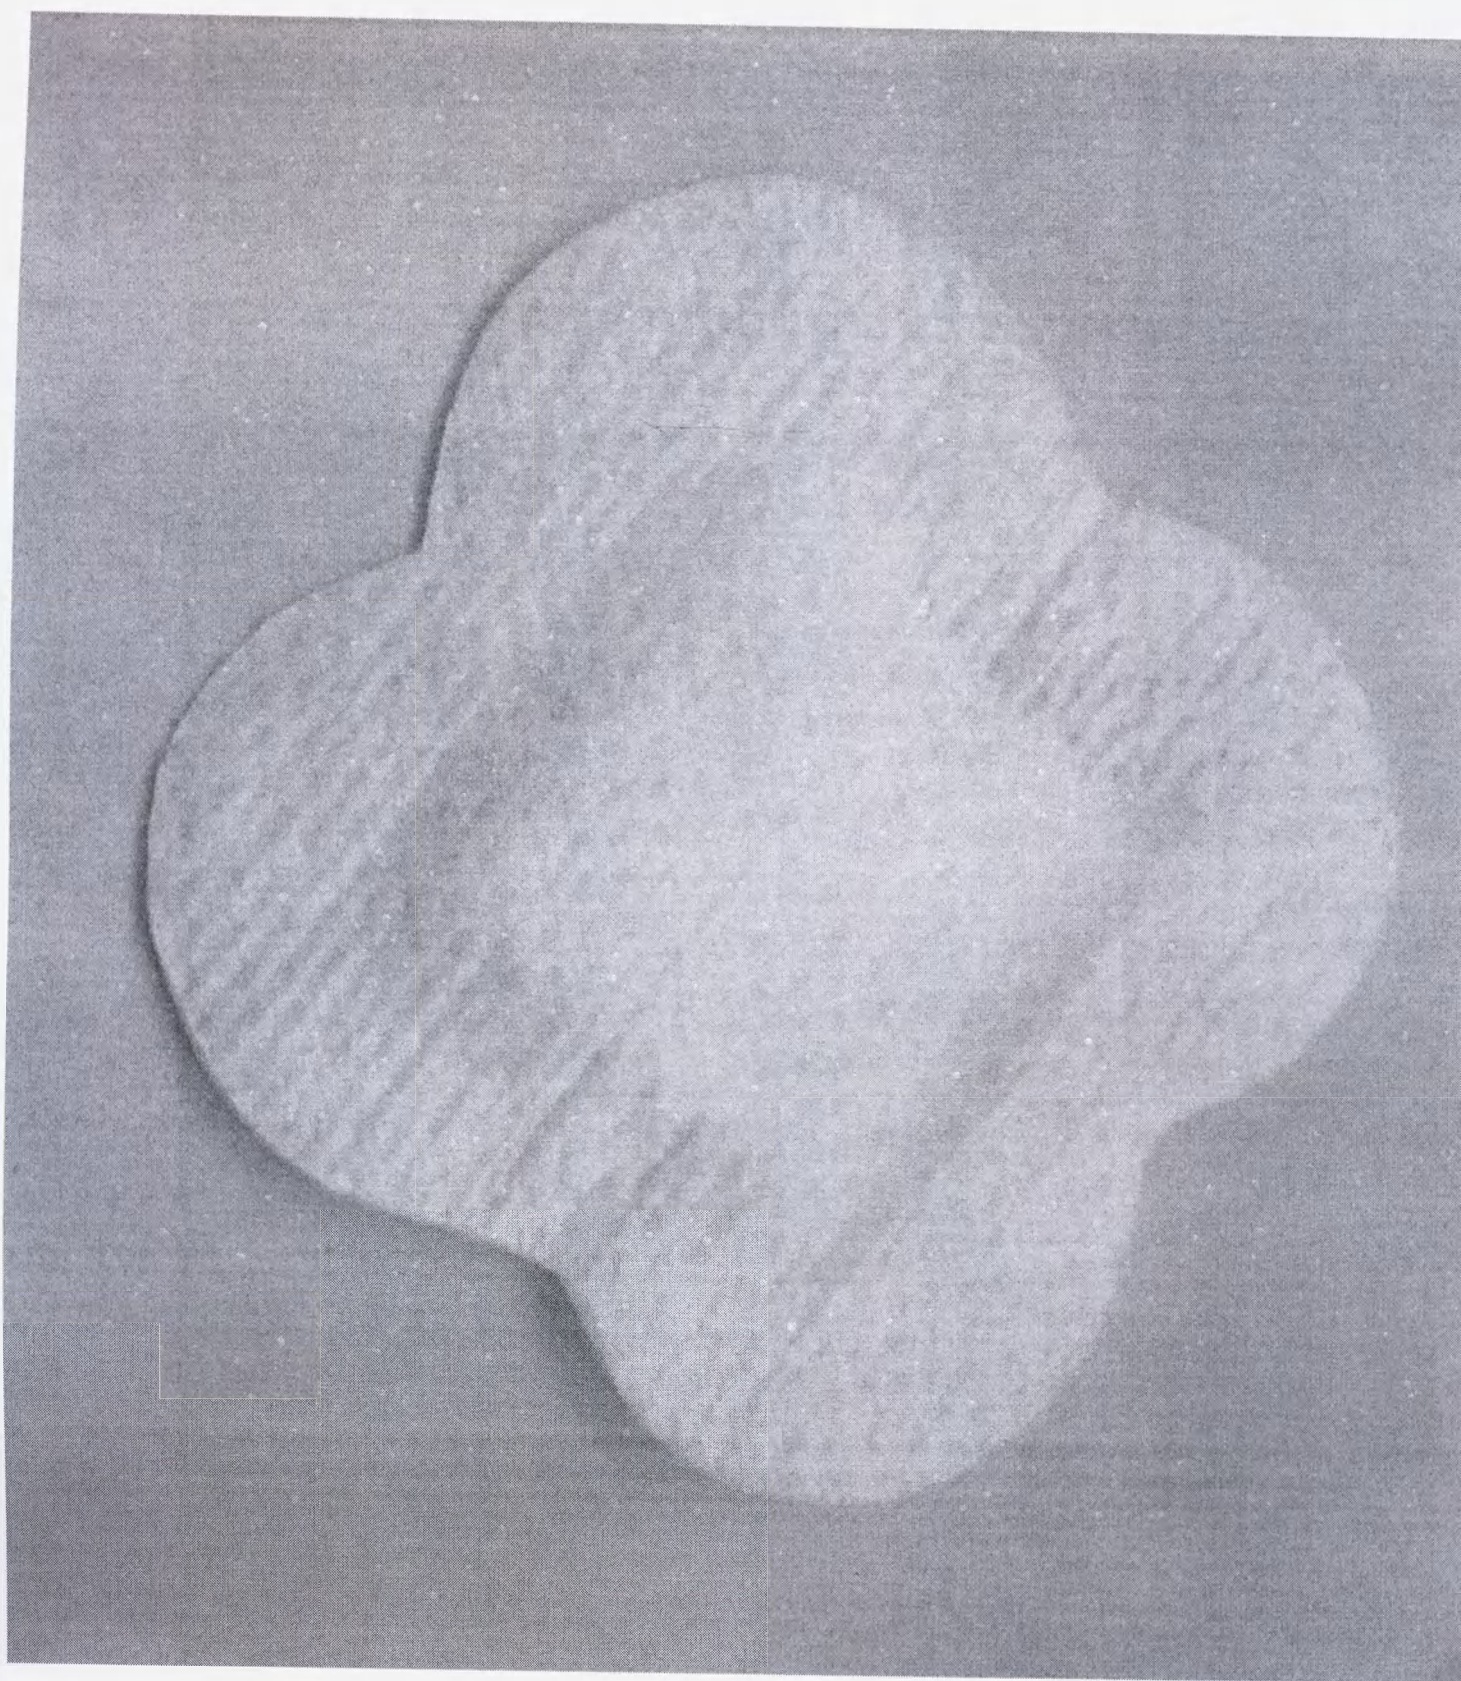

Пластырь медицинский фиксирующий Холмосорб



МЕДИТЕК
Знамя Труда

Карман для катетеров

ХОЛМОСОРБ

810015

Серия номер: **08170314**

Произведено: **03/2014**

Годен до: **03/2017**

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"

195027, Россия, Санкт-Петербург.

www.meditecz.ru


Применение: при лечении для надежной фиксации катетеров и защиты от инфекции

Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь,
менять по рекомендации врача или по мере необходимости.

Нетоксично. Стерильно.

Состав: 100% полиэстер

размер
8x17 см
(±10%)



Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель:

"БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",

Китай, WAYSON Medical Co.,

Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu,

Guangzhou, China

Импортер:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",

195027, Санкт-Петербург,

Магнитогорская ул., 11 лит. А

тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей
принимаются импортером.


Условия хранения: в сухом месте,

при температуре не выше 30°C

Годен до: см. на упаковке.

Per. Уд. ФСЗ № 2010/07988 от 04.06.2013 г.

24

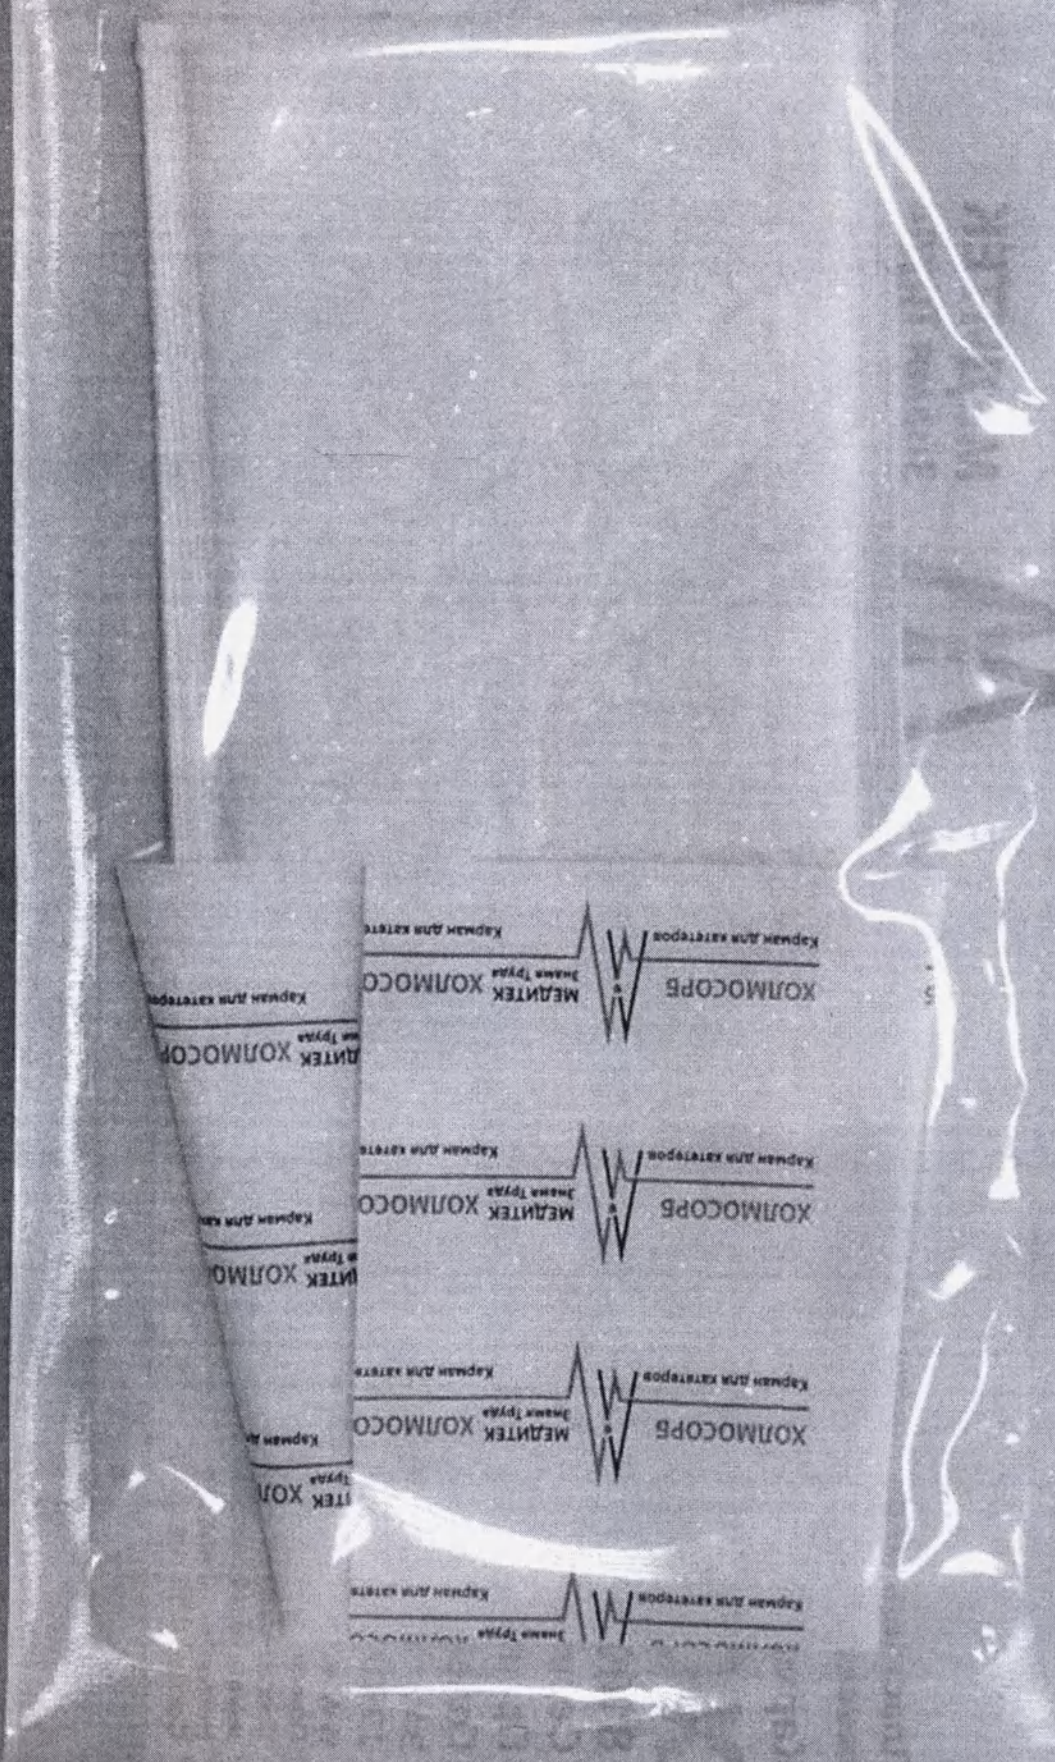

ЕК
да ХОЛМОСОРБ

Карман для катетеров

ХОЛМОСОРБ

Карман для катетеров



МЕДИТЕК
Знамя Труда

ХОЛМОСОТЕК

Труда

ХОЛМОСОРБ

Карман для катетеров

Карман для катетеров

ХОЛМОСОРБ

Карман для катетеров

ЕК
да ХОЛМОСОРБ

Карман для катетеров

ХОЛМОСОРБ

Карман для катетеров



МЕДИТЕК
Знамя Труда

ХОЛМОСОТЕК

Труда

ХОЛМОСОРБ

Карман для катетеров

Карман для катетеров

ХОЛМОСОРБ


Карман для катетеров

ЕК
да ХОЛМОСОРБ

Карман для катетеров

ХОЛМОСОРБ

Карман для катетеров



МЕДИТЕК
Знамя Труда

ХОЛМОСОТЕК

Труда

ХОЛМОСОРБ

Карман для катетеров

Карман для катетеров

ХОЛМОСОРБ

Карман для катетеров

ЕК
да ХОЛМОСОРБ

ХОЛМОСОРБ




МЕДИТЕК
Знамя Труда

ХОЛМОСОТЕК

Труда

ХОЛМОСОРБ

ХОЛМОСОРБ

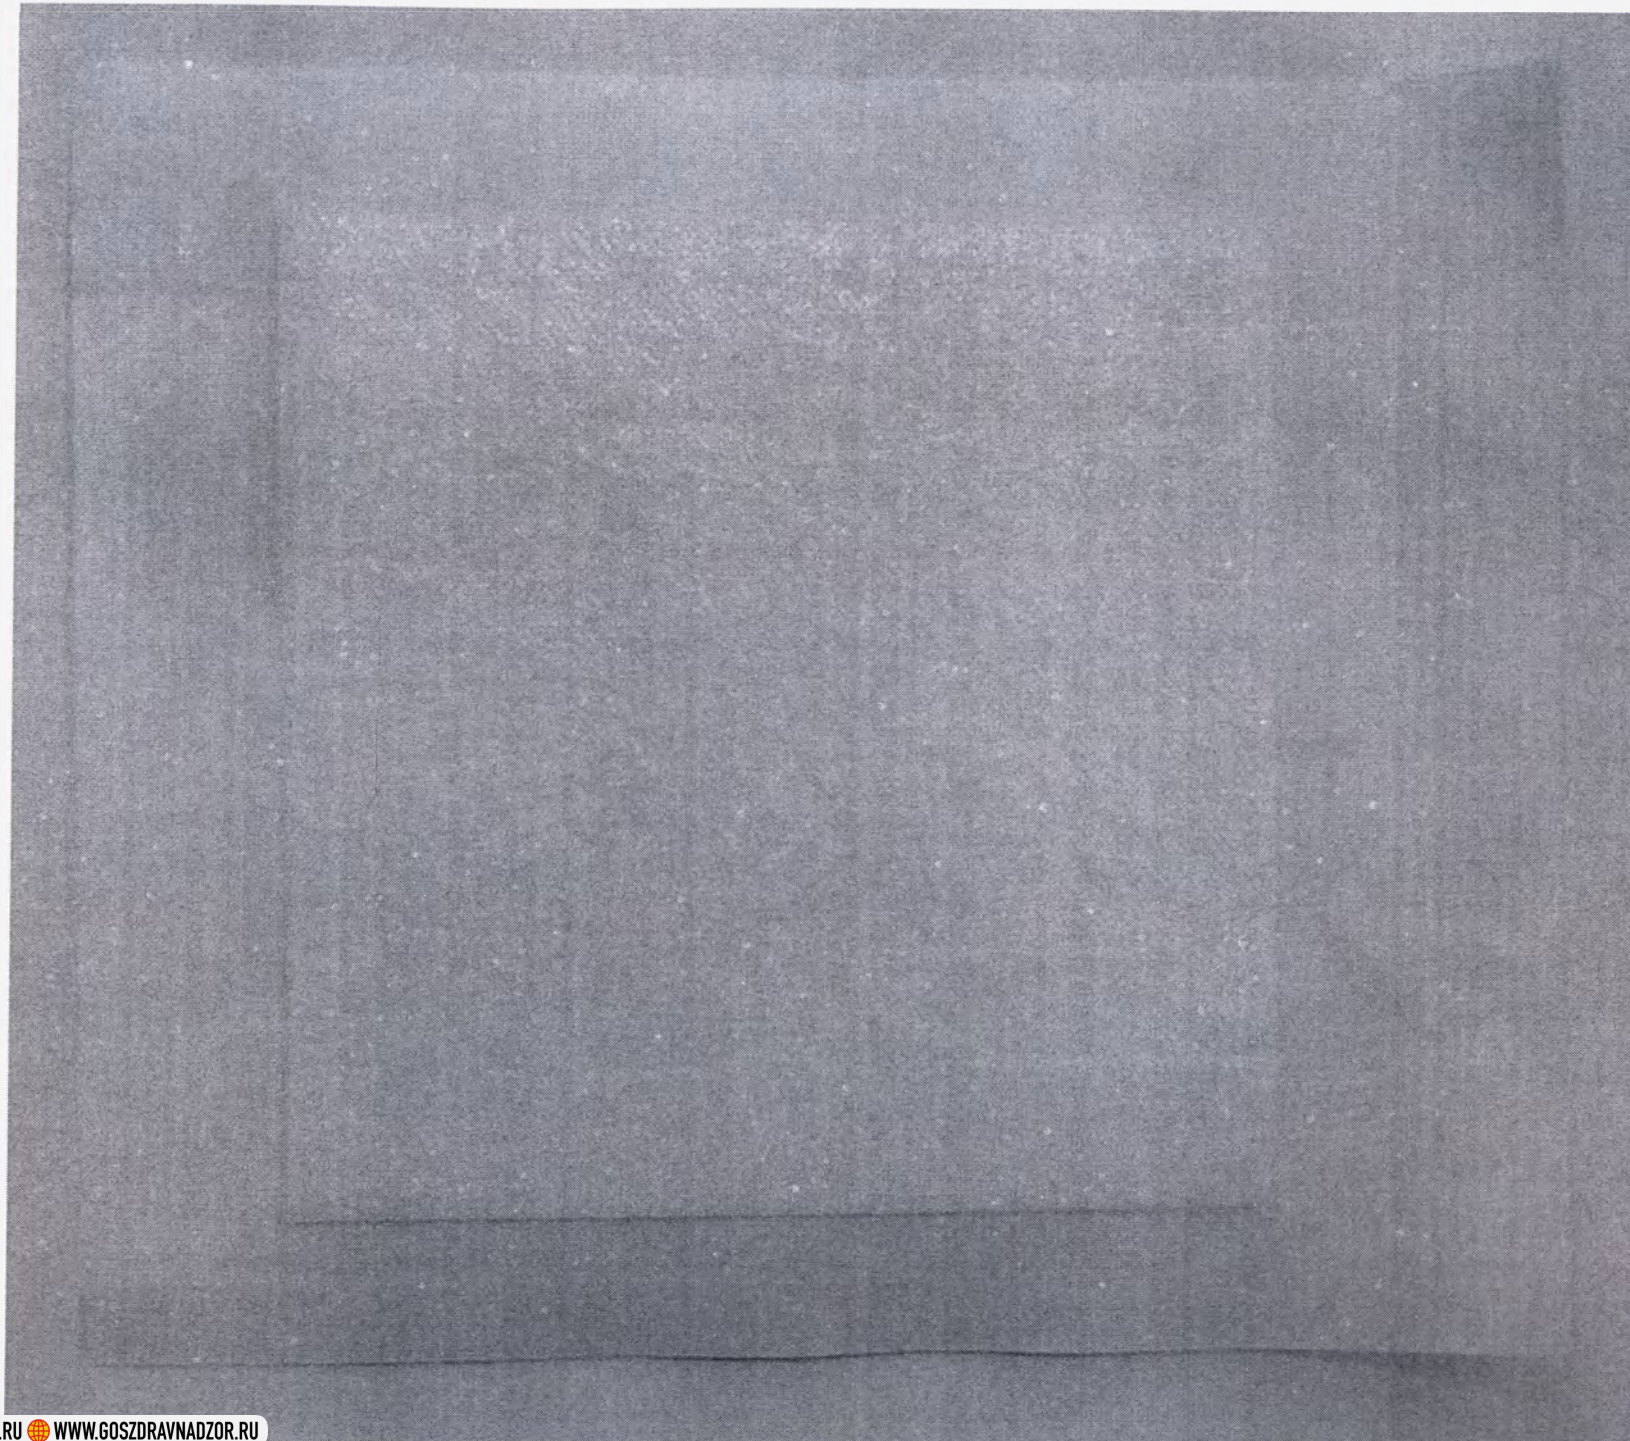

Пластырь медицинский фиксирующий Назофикс



МЕДИТЕК
Знамя Труда

НАЗОФИКС

811014

Серия номер: 07710414


Произведено: 04/2014

Годен до: 04/2017

размер
7x7.1cm
(±10%)

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru

Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь,
менять по рекомендации врача
или по мере необходимости.



Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель:

"БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.", Китай,
WAYSON Medical Co., Ltd., 81,
Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Импортер:


ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",
195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей
принимаются импортером.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C

Годен до: см. на упаковке.

Рег. Уд. ФСЗ № 2010/07988 от 04.06.2013 г.

Применение: для фиксации назальных катетеров.
Нетоксично. Стерильно.
Состав: основа - нетканый материал, адгезив -
безвредный для кожи полиакрилат.

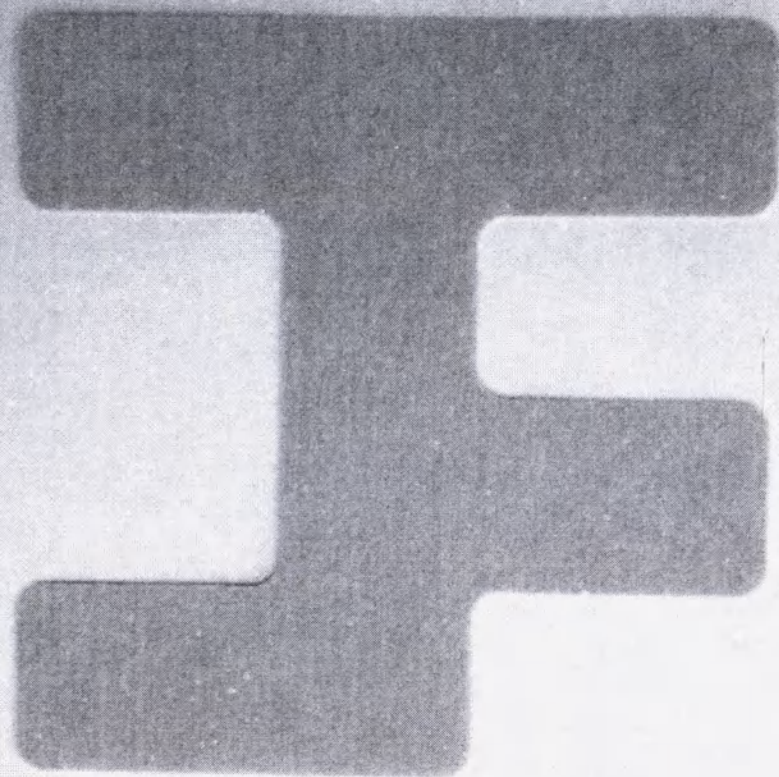

Пластырь медицинский фиксирующий Офталофикс



МЕДИТЕК
Знамя Труда

Гипоаллергенная стерильная повязка на глаз

ОФТАЛОФИКС

размер
6.5x9.5cm
(±10%)


803211

цвет: бежевый

Серия номер: 65950214
Произведено: 02/2014
Годен до: 02/2017



ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru



Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81,
Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",
195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C


Годен до: см. на упаковке.


Рег. Уд. ФСЗ № 2010/07988 от 04.06.2013г.


Применение: при лечении косоглазия, амблиопии
и закрытия глаза после хирургического вмешательства.
Нетоксично. Стерильно.

Состав: основа - нетканый материал, адгезив - безвредный
для кожи полиакрилат.

Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь,
наложить пластырь, менять по рекомендации врача
или по мере необходимости.

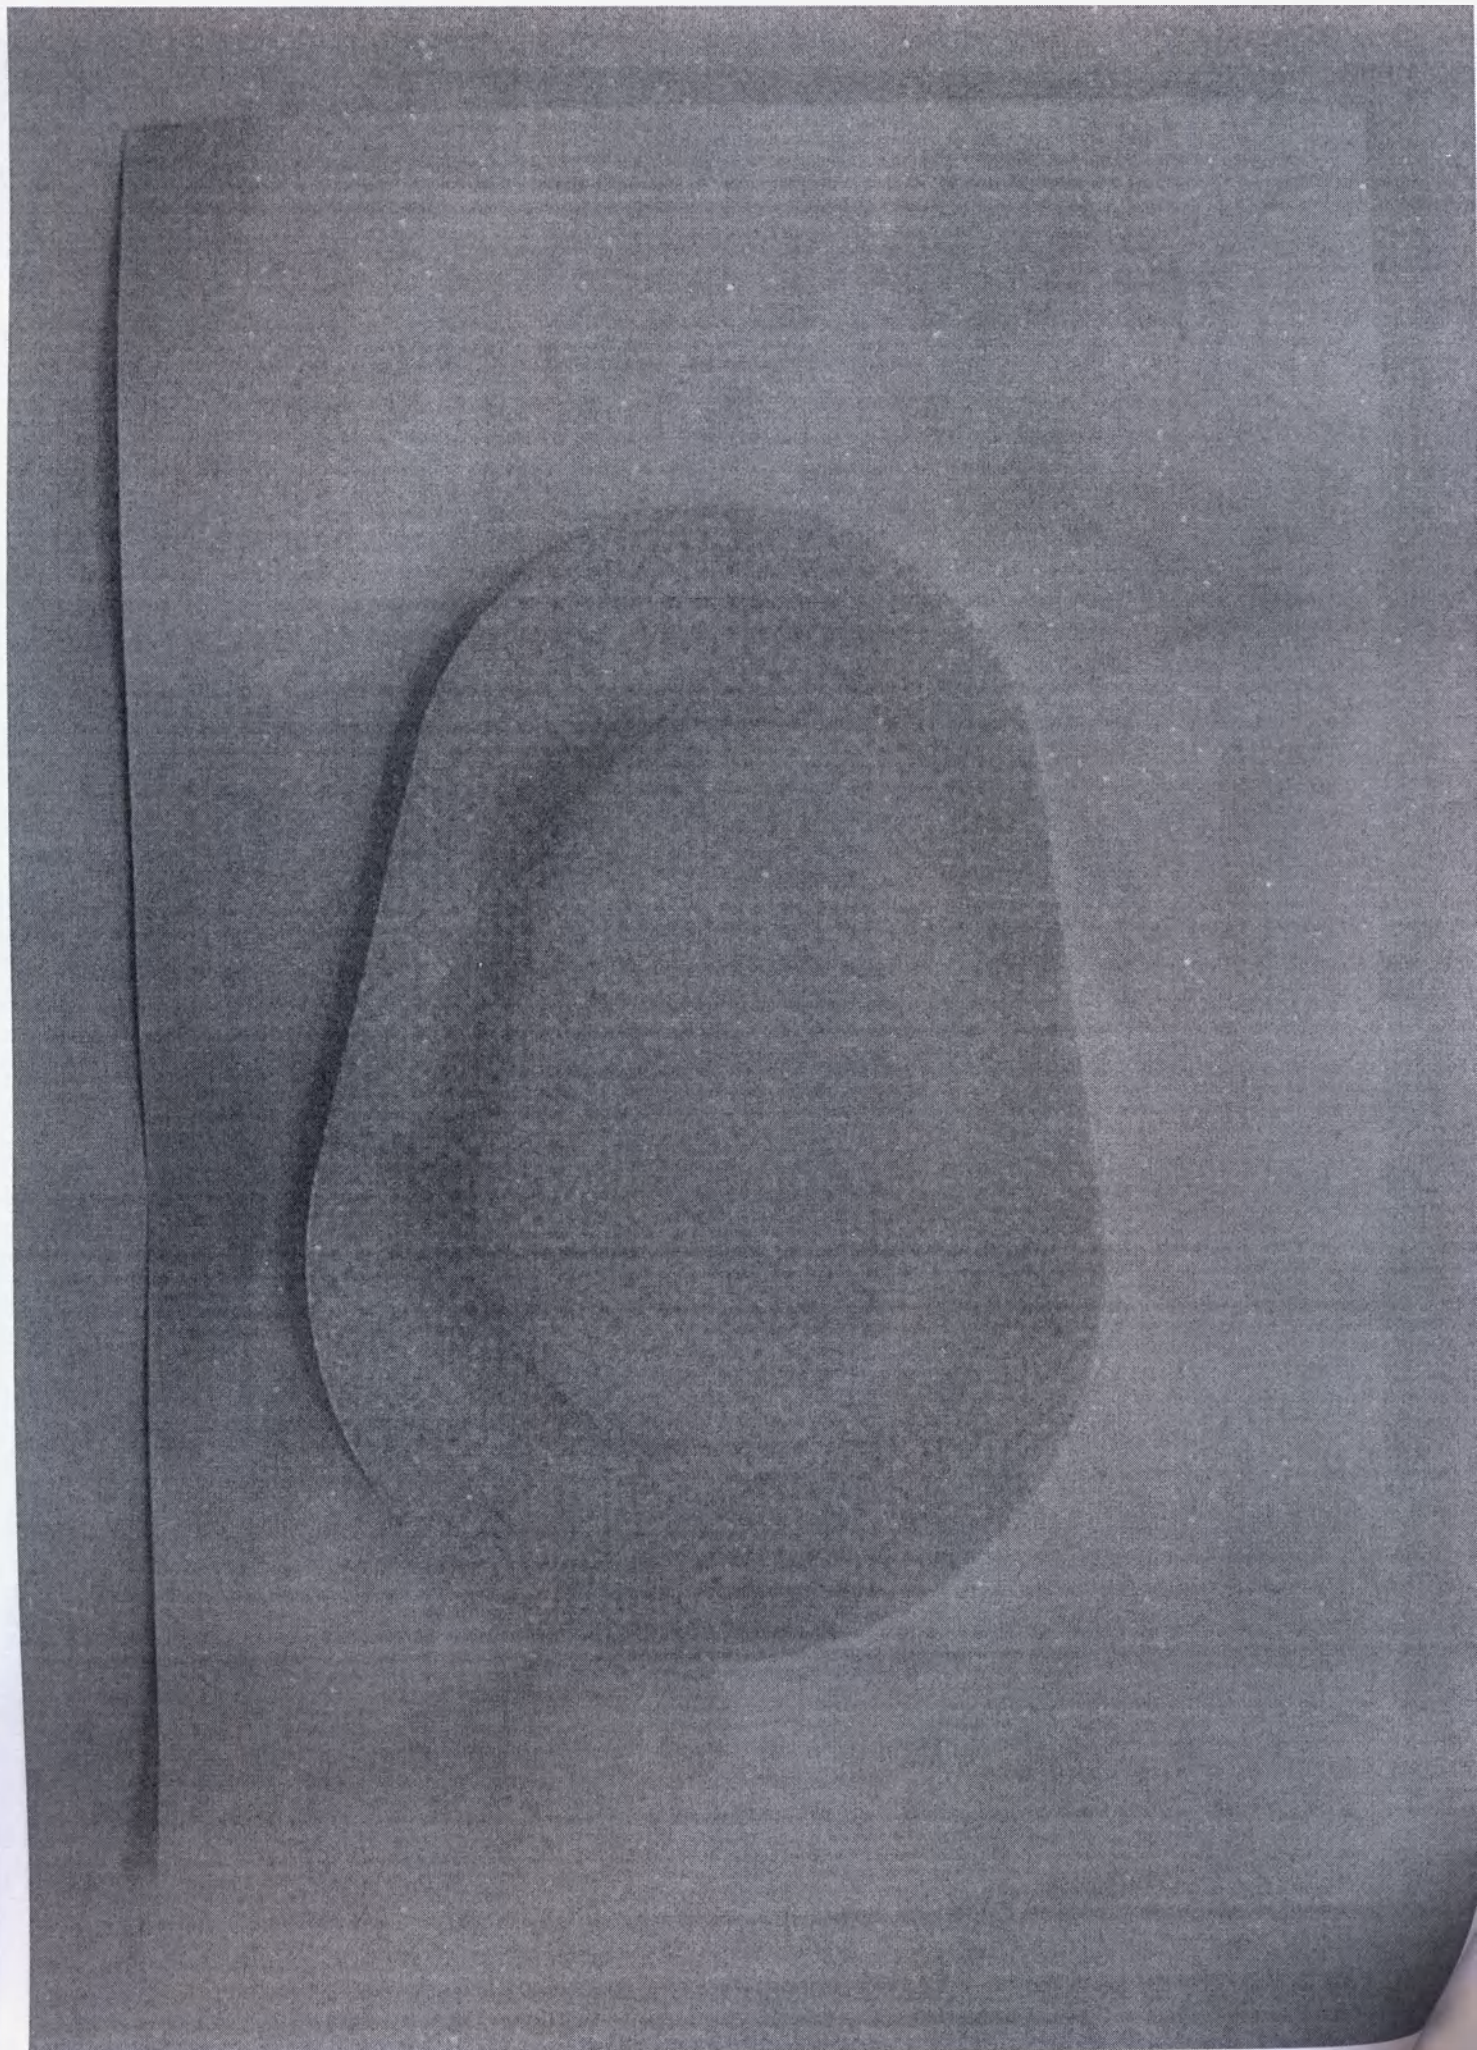


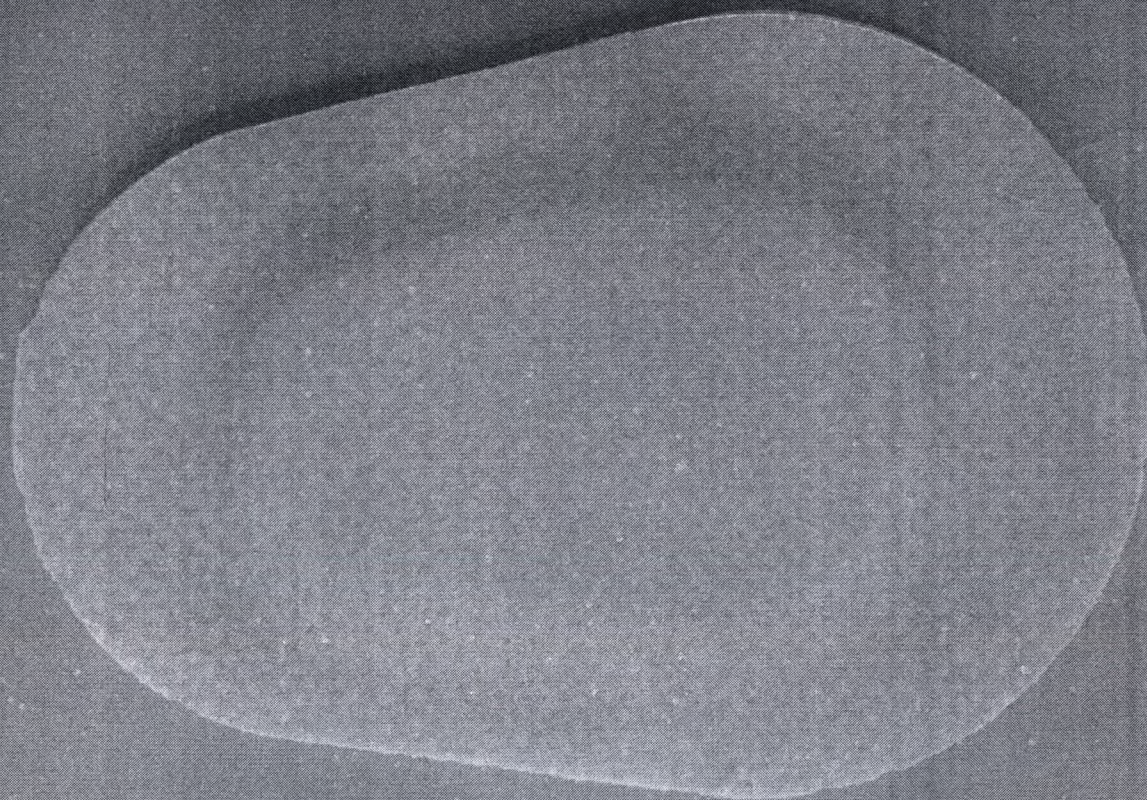

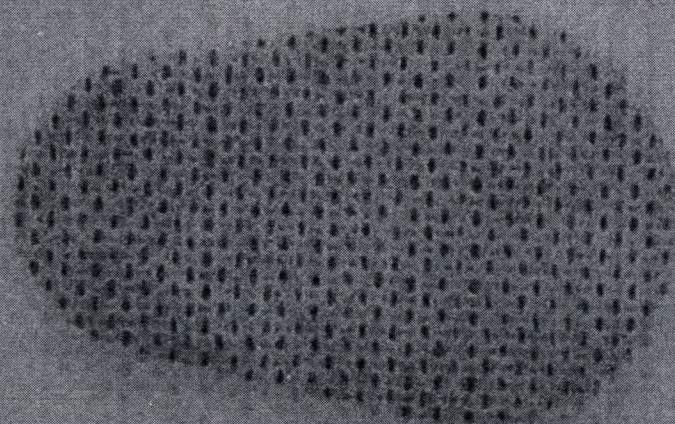

АЙПЭД 803310

Пластырь медицинский фиксирующий Айпэд

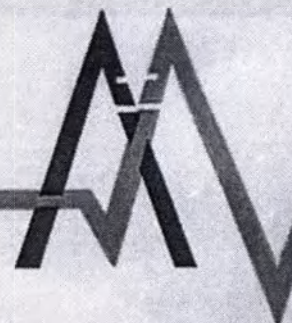

МЕДИТЕК
Знамя Труда

Гипоаллергенная стерильная повязка на глаз

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China

Импортер: ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"

195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются
импортером.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C

Годен до: см. на упаковке.

Рег. Уд. ФСЗ № 2010/07988 от 04.06.2013 г.
www.meditecz.ru

Серия номер: 05750314
Произведено: 03/2014
Годен до: 03/2017




размер
5.5x7.5cm
(±10%)

Применение: при лечении косоглазия, амблиопии
и закрытия глаза после хирургического вмешательства.
Нетоксично. Стерильно.

Состав: нетканый материал.

Способ наложения - вскрыть, достать, наложить,
менять по рекомендации врача
или по мере необходимости.



Пластырь медицинский фиксирующий Сейфофикс



МЕДИТЕК
Знамя Труда

Гипоаллергенная стерильная лечебная
компресс-повязка с подушечкой

СЕЙФОФИКС

801022

Серия номер: 18180214

Произведено: 02/2014

Годен до: 02/2017

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург
www.meditecz.ru

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",

Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81,
Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Импортер: ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",
195027, Санкт-Петербург,

Магнитогорская ул., 11 лит. А

тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73


Претензии потребителей принимаются импортером.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C

Годен до: см. на упаковке.

Per. Уд. ФСЗ № 2010/07988 от 04.06.2013 г.



размер
18x18cm
(±10%)



Применение: для фиксации при наложении лечебных, холодных, горячих, согревающих компрессов.
Нетоксично. Стерильно.

Состав: состоит из трех компонентов: наружный слой - особо плотная гипоаллергенная адгезивная нетканая основа, средний слой - полимерная пленка и внутренняя часть - круглая подушечка.

Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.

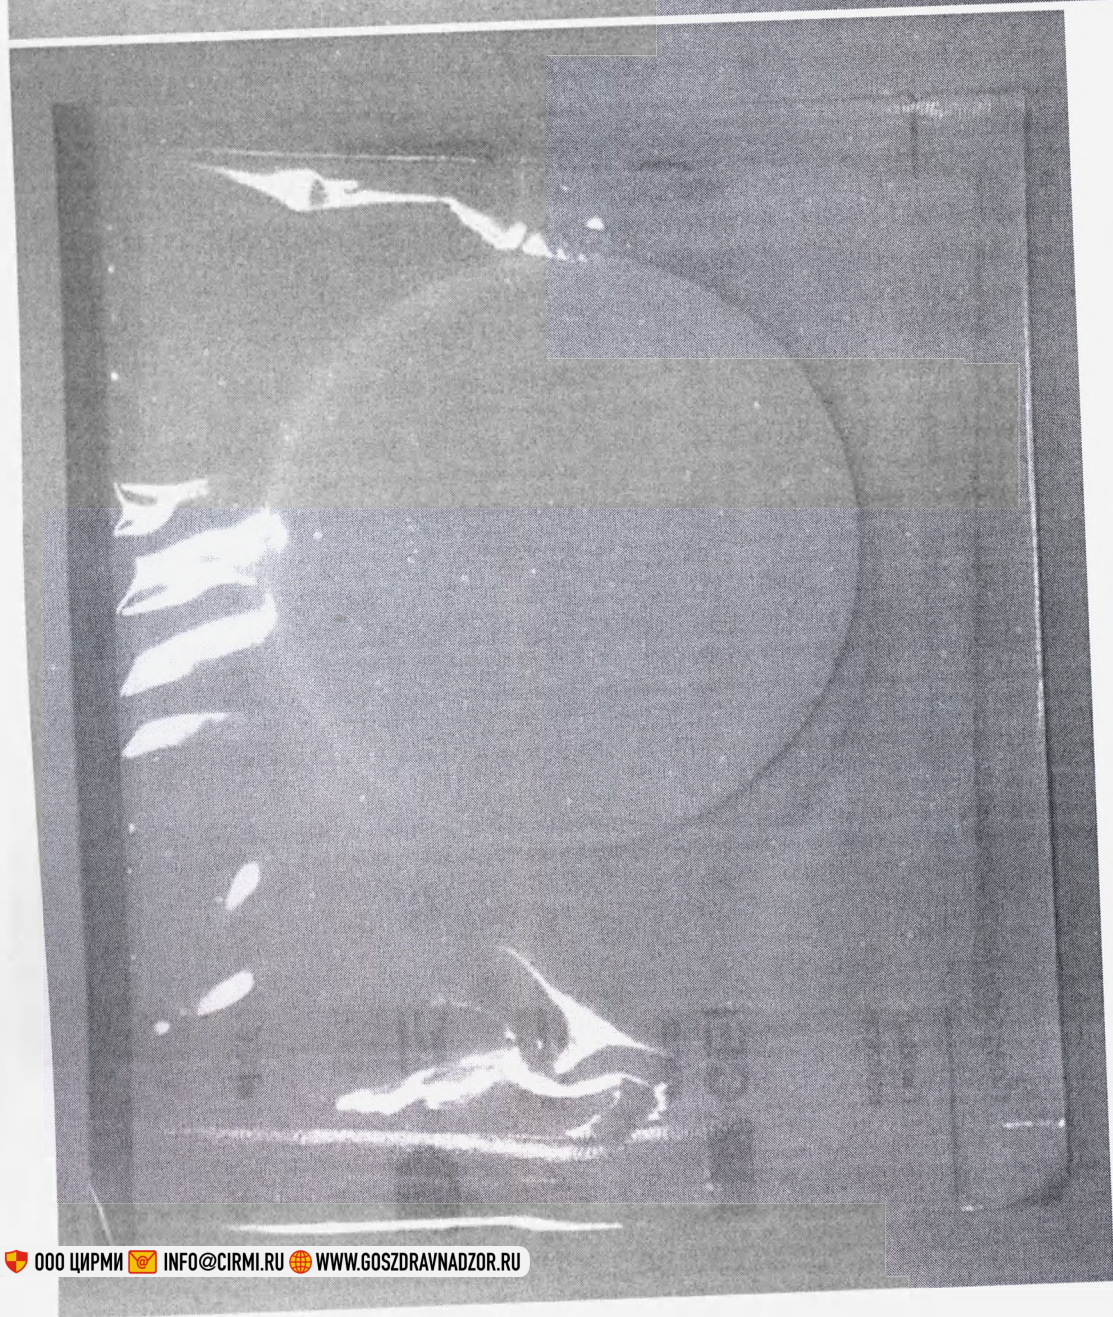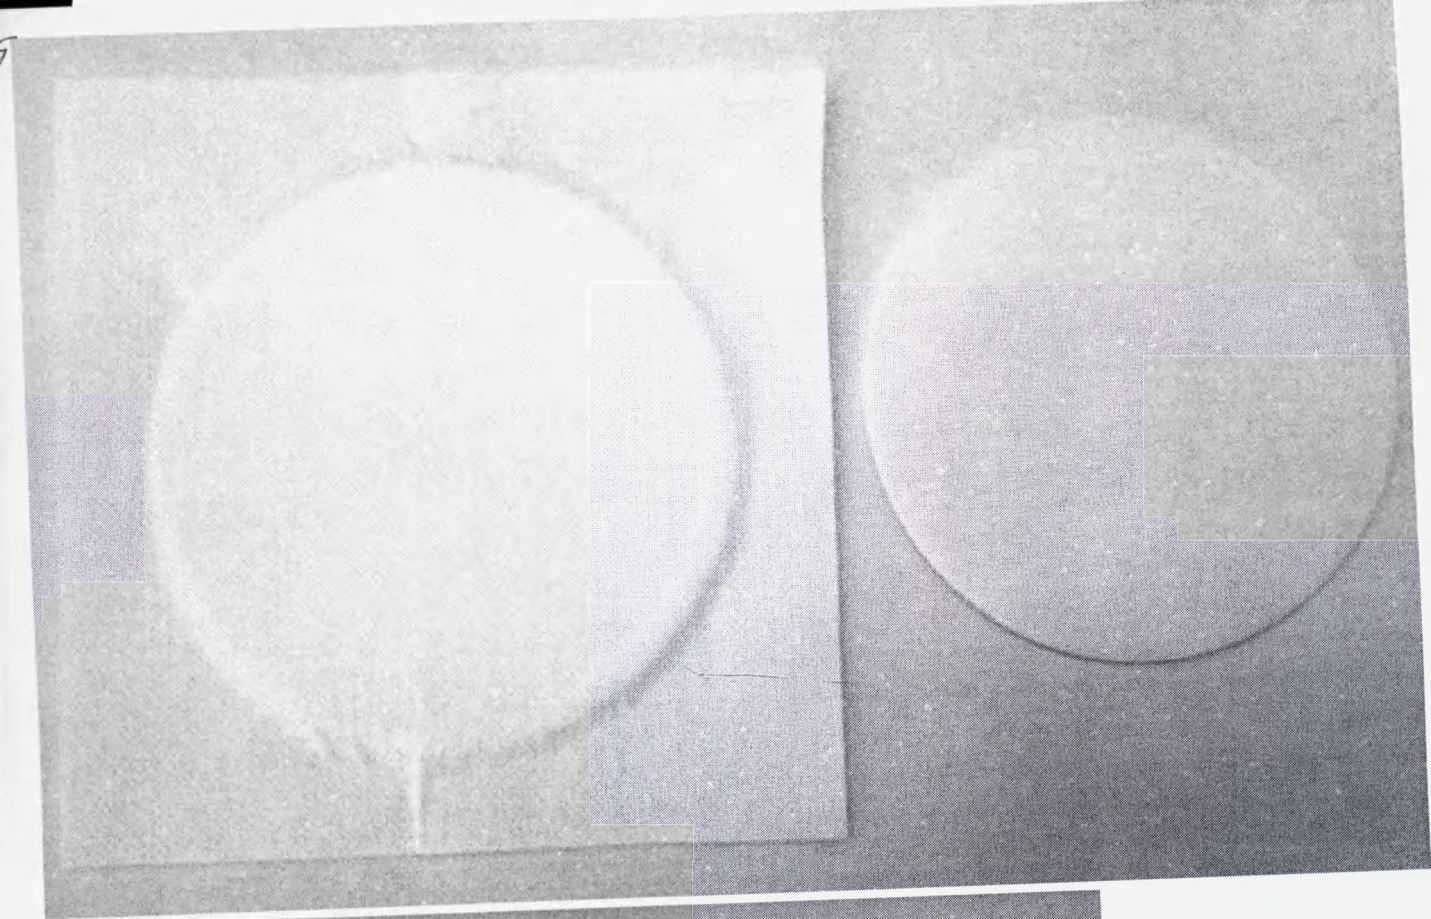

Пластырь медицинский фиксирующий Артофикс



Гипоаллергенная стерильная лечебная компресс-повязка
с ограждающей рамкой

АРТОФИКС

801023

Серия номер: **15150114**
Произведено: **01/2014**
Годен до: **01/2017**

размер
15x15cm
(±10%)

ЗАО "МЕДИТЕК" "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург
www.meditecz.ru

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",

Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81,
Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Импортер: ЗАО "МЕДИТЕК" "Знамя Труда",
95027, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются импортером.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C

Годен до: см. на упаковке.


Рег. Уд. ФСЗ № 2010/07988 от 04.06.2013 г.


Состав: состоит из трех компонентов: наружный слой - особо плотная гипоаллергенная адгезивная нетканая основа, средний слой - полимерная пленка и внутренняя часть - квадратная нетканая ламинированная рамка.

Применение: для фиксации при наложении лечебных, холодных, горячих, согревающих компрессов. Нетоксично. Стерильно.



Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.



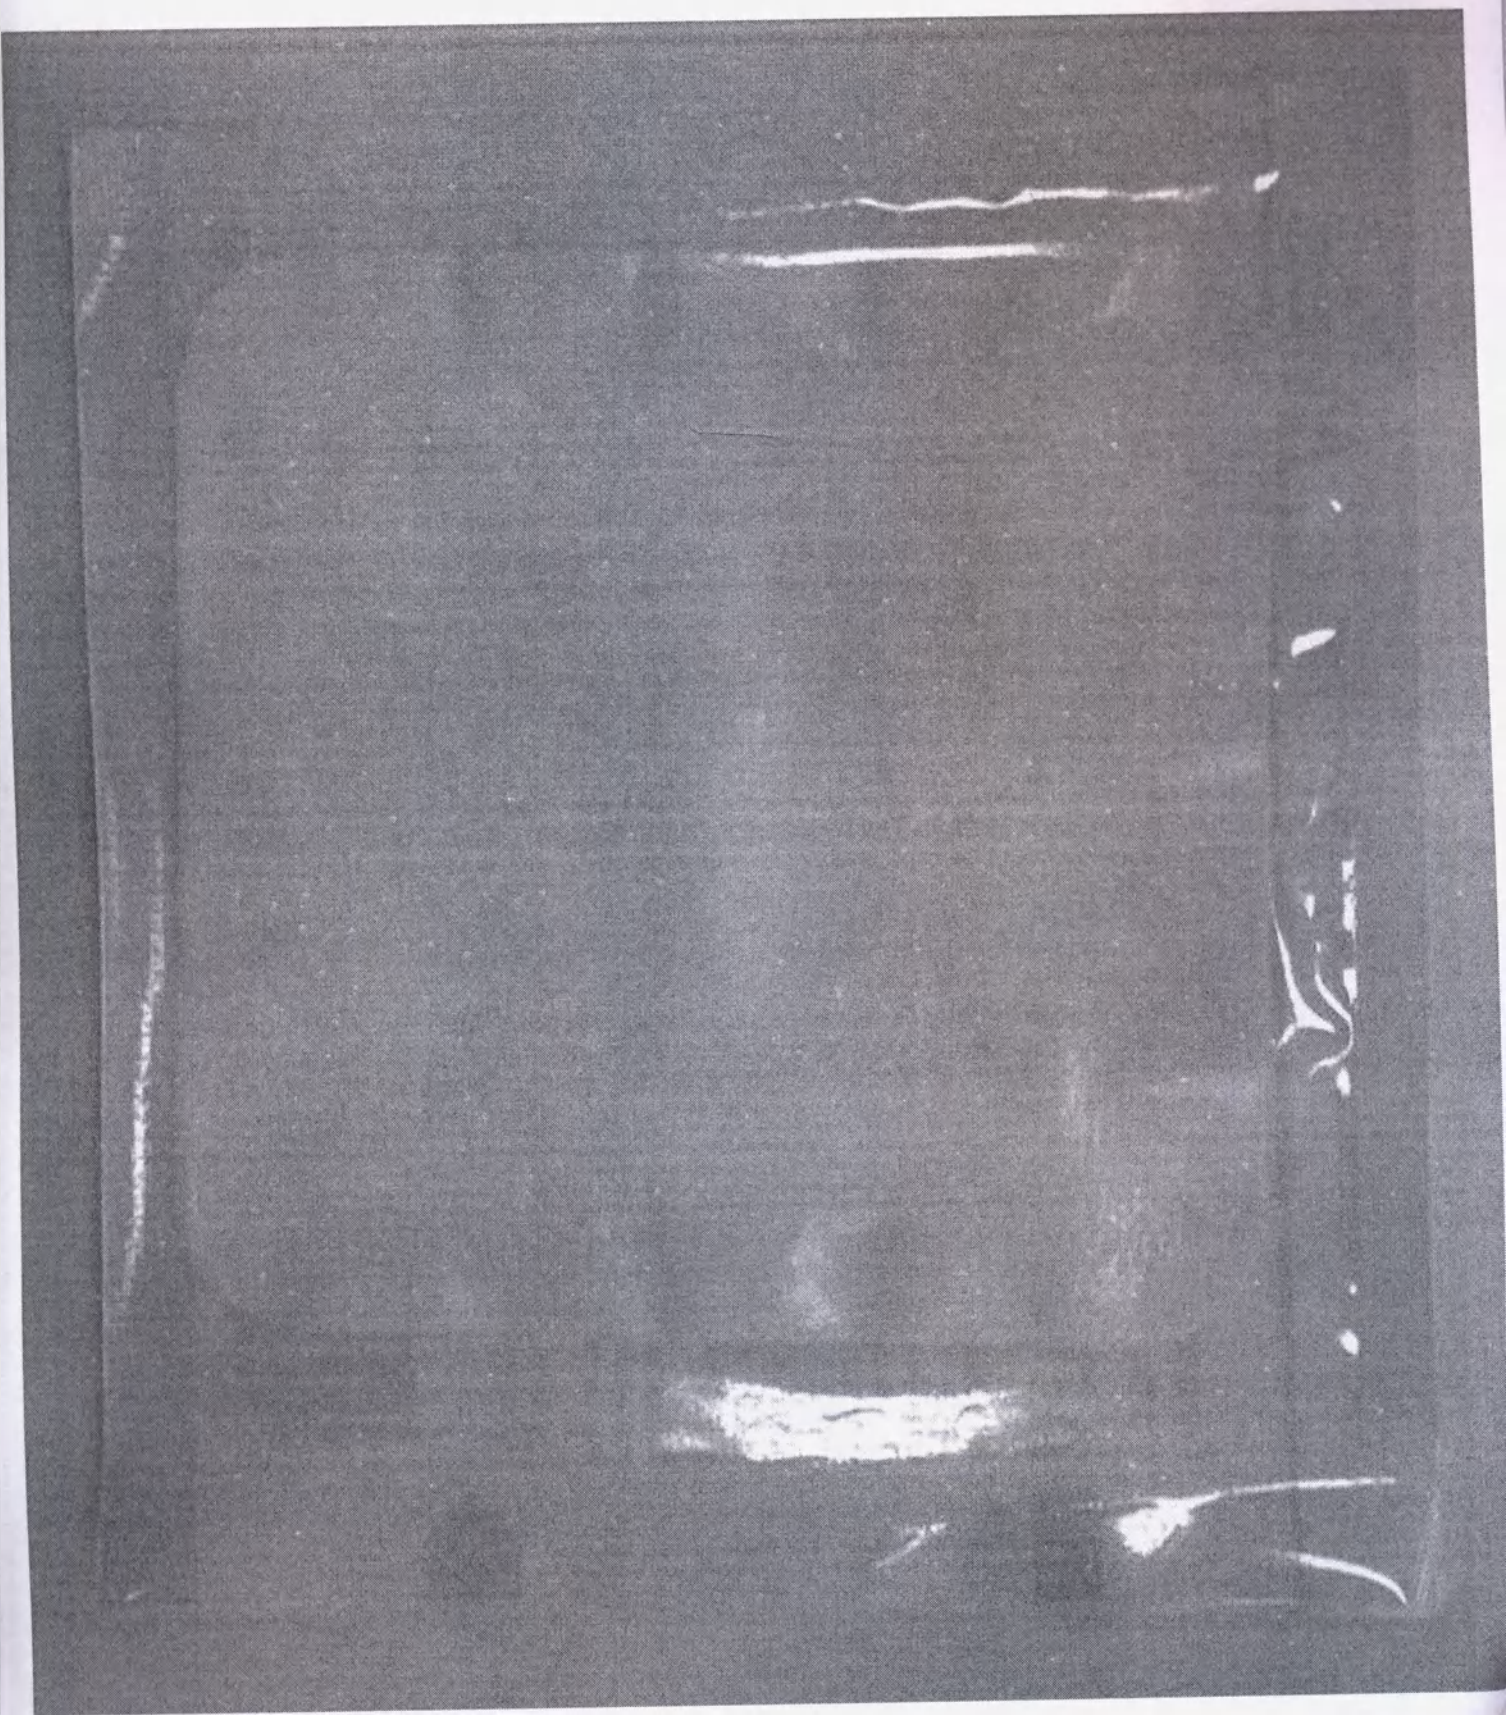



ALCANTARA
Suede Type

РОПФИКС

806034

1992

© 1999

WJMO
WJMO
WJMO

15

ВЕРХНИЙ ТАБЛИЦА

РОПТОФИКС

1000

ПОПОВИЧ

Copyright © 1974
Quintessence Publishing
Chicago, Ill. 60606
(1-800-541-0000)

[illegible]

Пластырь медицинский фиксирующий Круострип



МЕДИТЕК
Знамя Труда

Гипоаллергенные стерильные полоски
для сведения краев ран

КРУОСТРИП

815002

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru


Серия номер: 06750114

Произведено: 01/2014

Годен до: 01/2017



Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.



Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China

Импортер:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А

тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются импортером.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C

Годен до: см. на упаковке.

Рег. Уд. ФСЗ № 2010/07988 от 04.06.2013 г.


Применение: для сопоставления краев раны
и стабилизации свежих послеоперационных рубцов.

Нетоксично. Стерильно.

Состав: основа - 100% нейлон, адгезив - безвредный
для кожи полиакрилат.

размер
0,6x7,5cm
(±10%)

27

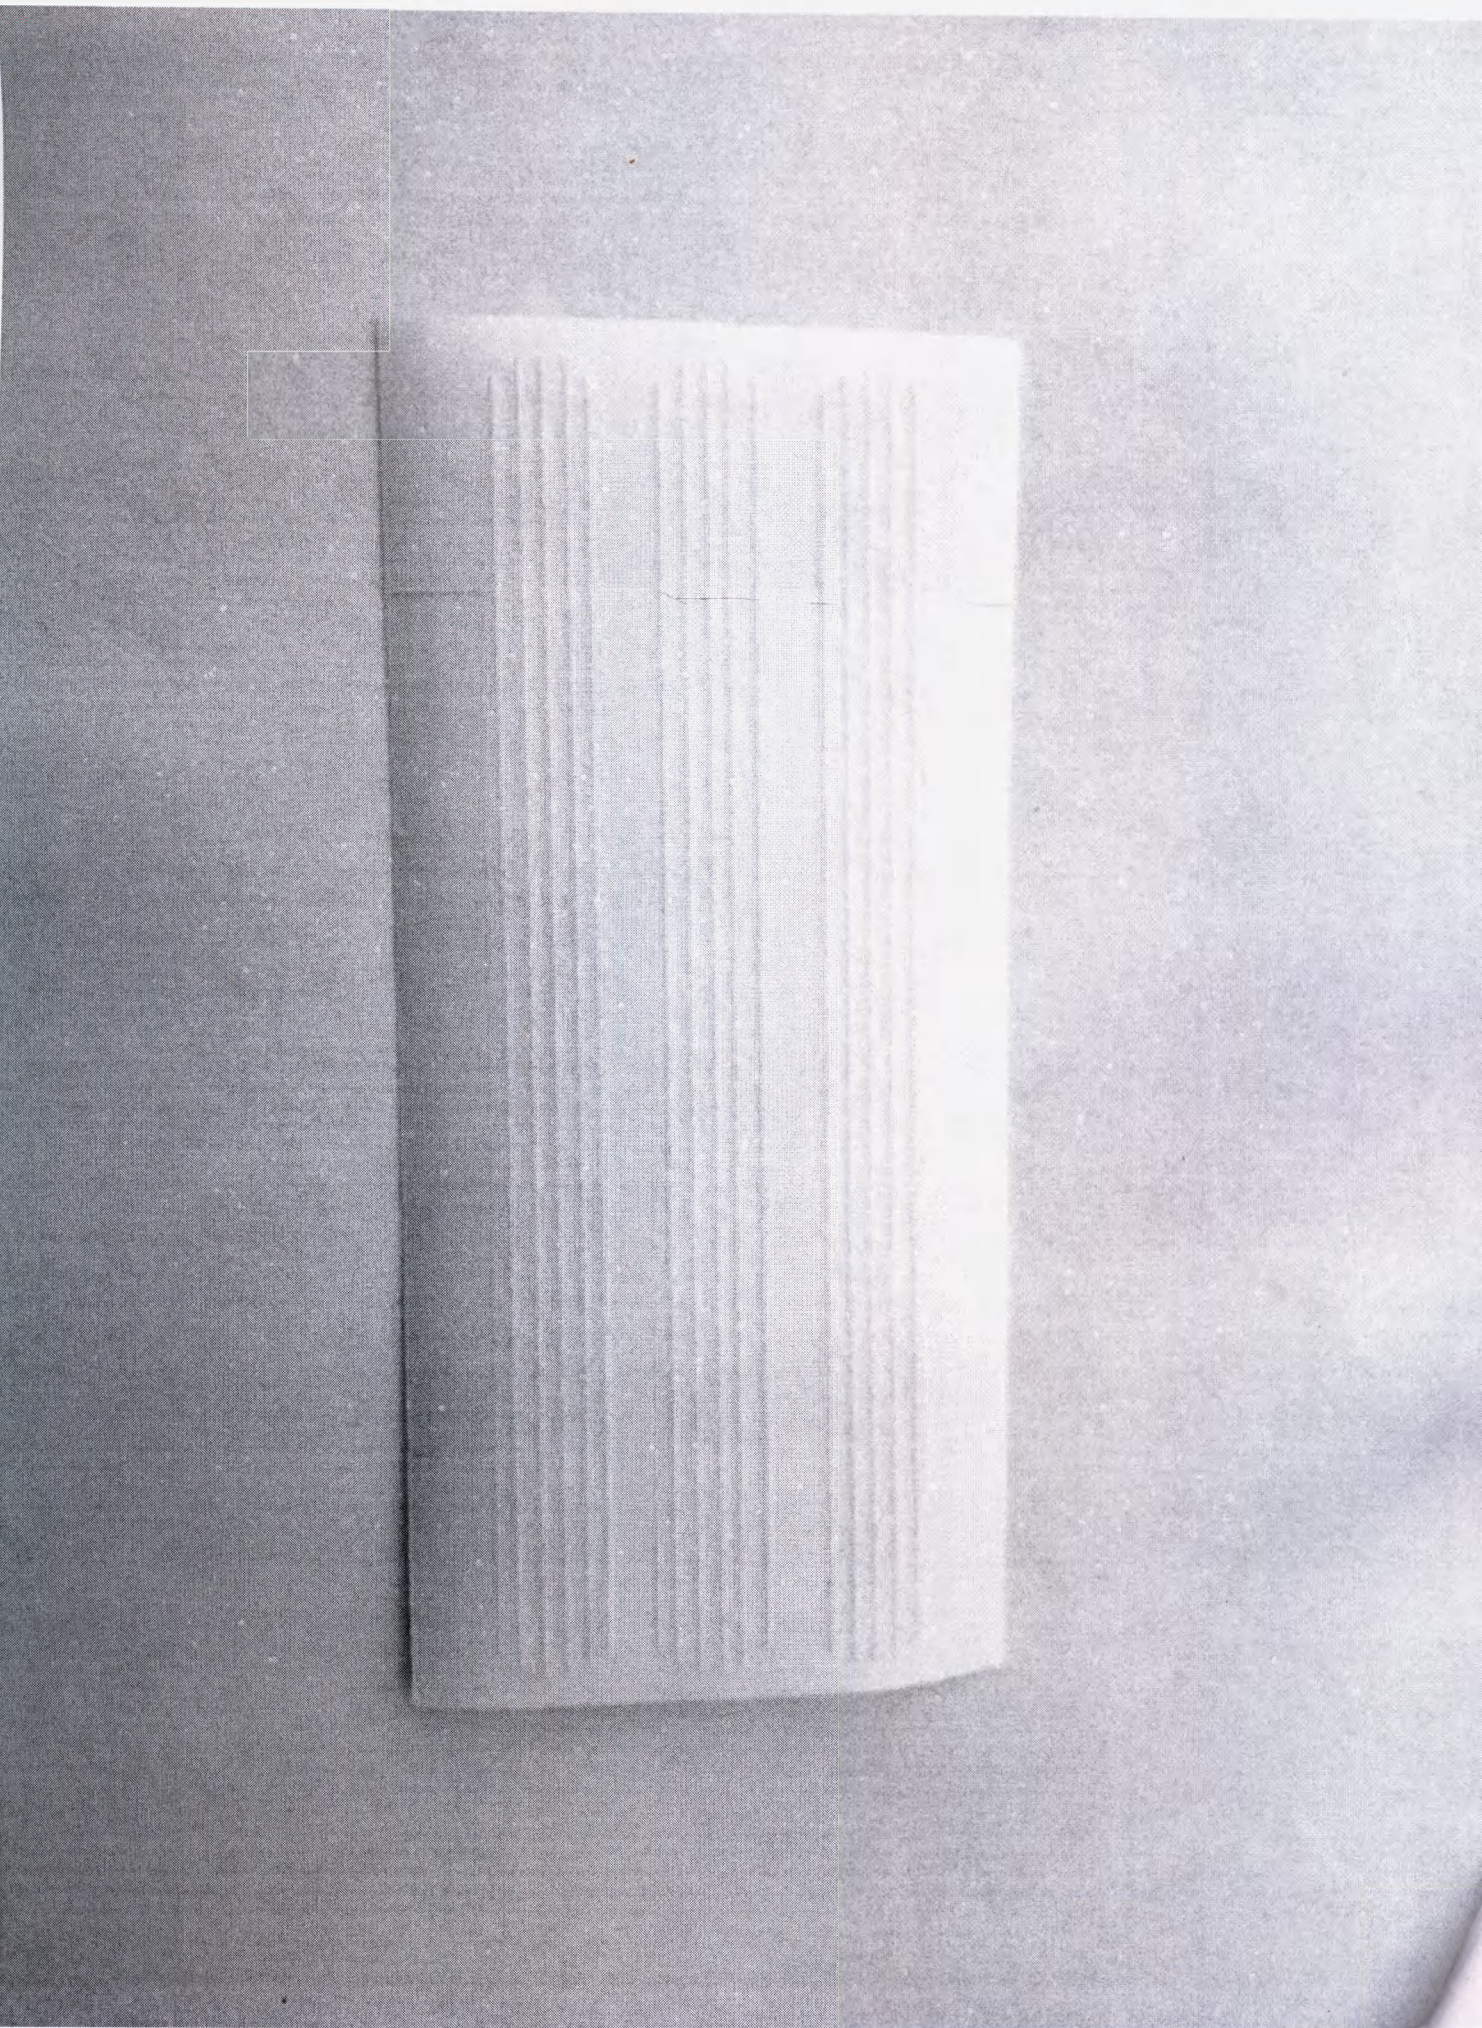

Пластырь медицинский фиксирующий Круофин



Стерильная мазевая повязка
из крупноячеистой хлопковой ткани

КРУОФИН

808013




размер
10x20cm
(±10%)

Серия номер: **10200314**
Произведено: **03/2014**
Годеи до: **03/2017**

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

Состав: основа – 100% обезжиренная
хлопковая ткань, мазевая масса
на основе парафина.



Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель:

"БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.", Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81,
Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Импортёр:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",
195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей
принимаются импортером.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C

Годеи до: см. на упаковке.

Рег. Уд. ФСЗ № 2010/07988 от 04.06.2013 г.

Применение: при лечении ожогов, трофических
и диабетических язв, пролежней, ссадин, при трансплантации
кожи, для фиксации кожных трансплантатов.

Нетоксично. Стерильно.

Способ наложения – вскрыть, достать, наложить, менять по рекомендации
врача или по мере необходимости.





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью:
шестьдесят два (62) листов

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

_____ Крутицкий Д.Е.

И.П. _____
«МЕДИТЕК
Знамя Труда»

_____ 20__ года



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»



Д.Е. Крупицкий

2020 г.

МАКЕТЫ УПАКОВКИ
(ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ)
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Пластырь медицинский фиксирующий»

производства:

БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд., Китай

(WAYSON Medical Co., Ltd., No.81, JunfengRoad., HuangpuDis, GuangZhou, China),

Tel: 86-20-82030500; Fax: 86-20-32282845; email: wayson@wayson.cn


2020

Пластырь медицинский фиксирующий Крусилк



КРУОСИЛК

Типоаллергенный фиксирующий
на основе искусственного шелка

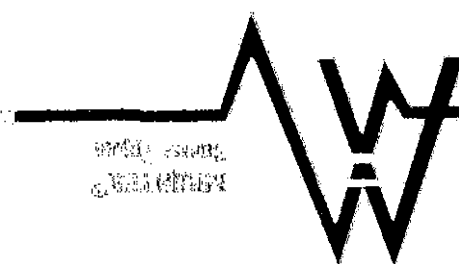

Пластырь медицинский фиксирующий Крусилк

ООО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
193017, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditek.ru
XX рулонов/упаковка


Пластырь медицинский фиксирующий Крусилк

Типоаллергенный фиксирующий на основе
искусственного шелка

КРУОСИЛК

ООО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
193017, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditek.ru

XX рулонов/упаковка

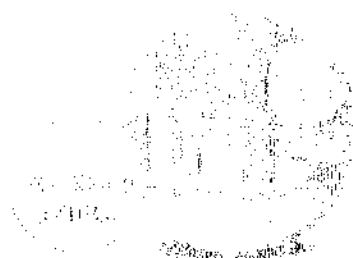

КРУОСИЛК

Серия номер: ХХХХХХХХ
Производитель: ХХХХХХХХ
Годы д.р.: ХХХХХХ

CE... 2 1

Противопоказания:
Склонность к аллергии, заболевания кожи.
Противопоказания: "Знамя Труда" Мединформ, ООО, 193017, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бухарина, 10.
Упаковка: 10 рулонов/упаковка.
Условия хранения: в сухом, защищенном от влаги и света месте, при температуре от 15 до 25 °С.
Срок годности: 3 года.

XXXXXX XX рулонов/упаковка


ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditecz.ru

КРУОСИЛК

искусственного шелка

Гипоаллергенный фиксирующий на основе

Пластырь медицинский фиксирующий Крусилк

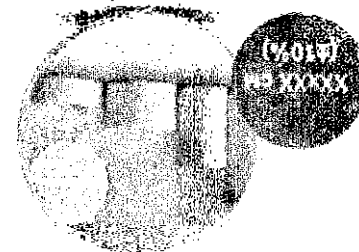

CE mark and other regulatory symbols

Серия кодер: XXXXXXXX
Произведено: XXXXXXXX
Годен до: XXXXXXXX

КРУОСИЛК

Продукция предназначена для фиксации
Правильно использовать: Вязать по инструкции.
Китай, WUZHONG Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,
Тяньцзинь, Китай.
Упаковка: 10 шт. в коробе.
Минимальная температура хранения: -20 °C.
Максимальная температура хранения: +30 °C.
Срок годности: 3 года.
Упаковка: 10 шт. в коробе.
XXXXXX

Пластырь медицинский фиксирующий Крусилк



Гипоаллергенный фиксирующий
на основе искусственного шелка

КРУОСИЛК

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XX рулонов/упаковка

XXXXXX

CE mark and other regulatory symbols



Пластырь медицинский фиксирующий Крюсилк

Гипоаллергенный фиксирующий на основе
искусственного шелка

КРЮСИЛК

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditek.ru

XXXXXX XX рулонов/упаковка



КРЮСИЛК

Серия номер: XXXXXXXX

Произведено: XXXXXXXX

Годен до: XXXXXXXX



Применение: для фиксации повязок, трубчатых марлевых бинтов, катетеров.
Рекомендуется пациентам с чувствительной кожей.
Неотоксично.
Состав: основа - искусственный шелк, адгезив - безводный
для кожи полиакрилат.
Способ применения - вскрыть упаковку, достать пластырь,
нанести пластырь, снять по рекомендации врача
или по мере необходимости.



XXXXXX
XX рулонов/упаковка
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditek.ru

КРЮСИЛК

Гипоаллергенный фиксирующий на основе
искусственного шелка



Пластырь медицинский фиксирующий Крюсилк

Пластырь медицинский фиксирующий Крюсилк

Гипоаллергенный фиксирующий на основе
искусственного шелка

КРЮСИЛК

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditek.ru

XXXXXX XX рулонов/упаковка



КРЮСИЛК

Серия номер: XXXXXXXX

Произведено: XXXXXXXX

Годен до: XXXXXXXX



Применение: для фиксации повязок, трубчатых марлевых бинтов, катетеров.
Рекомендуется пациентам с чувствительной кожей.
Неотоксично.
Состав: основа - искусственный шелк, адгезив - безводный
для кожи полиакрилат.
Способ применения - вскрыть упаковку, достать пластырь,
нанести пластырь, снять по рекомендации врача
или по мере необходимости.


Пластырь медицинский фиксирующий Крюсилк

Гипоаллергенный фиксирующий на основе
искусственного шелка

КРЮСИЛК

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditek.ru

XXXXXX XX рулонов/упаковка



КРЮСИЛК

Серия номер: XXXXXXXX


Произведено: XXXXXXXX

Годен до: XXXXXXXX



Применение: для фиксации повязок, трубчатых марлевых бинтов, катетеров.
Рекомендуется пациентам с чувствительной кожей.
Неотоксично.
Состав: основа - искусственный шелк, адгезив - безводный
для кожи полиакрилат.
Способ применения - вскрыть упаковку, достать пластырь,
нанести пластырь, снять по рекомендации врача
или по мере необходимости.

нский фиксирующий Круофильм:

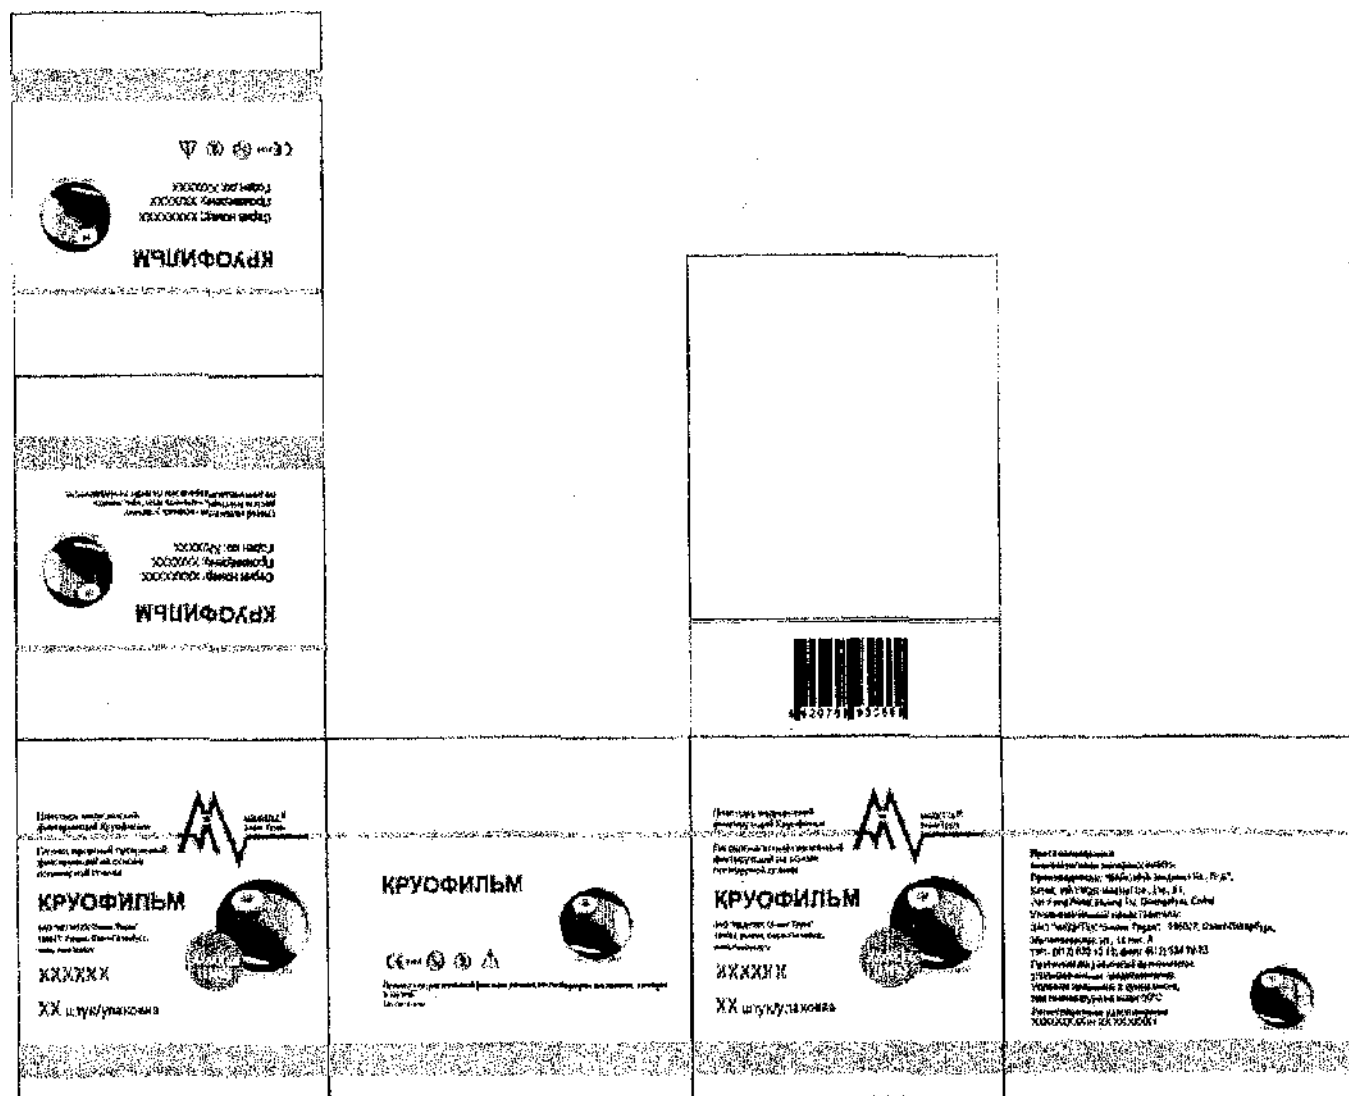

МЕДИТЕК® Знамя Труда	КРУОФИЛЬМ Применение: для стерильной фиксации раневых, послеоперационных повязок, катетеров и канюль. 000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	Пластырь медицинский фиксирующий Круофильм КРУОФИЛЬМ Гипоаллергенный прозрачный фиксирующий на основе полимерной пленки ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда" 195027, Россия, Санкт-Петербург. www.meditek.ru XX штук/упаковка	Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Производители: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд". Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China Уполномоченный представитель: ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., 11 лит. А тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73 Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем. Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 39°C Регистрационное удостоверение XXXXXXX от XX.XX.XXXX г.
---------------------------------	--	--	--



КРУОФИЛЬМ

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX



Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.

КРУОФИЛЬМ

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX



Пластырь медицинский фиксирующий Круопор:

Гипоаллергенный фиксирующий на бумажной основе КРУОПОР® ЗАО "МЕДИТЕК" Знамя Труда 195027, Россия, Санкт-Петербург www.meditek.ru XXXXXX XX рулонов/упаковка XXXXXX см (±10%) МЕДИТЕК® Знамя Труда	Пластырь медицинский фиксирующий Круопор® Гипоаллергенный Фиксирующий на бумажной основе КРУОПОР® ЗАО "МЕДИТЕК" Знамя Труда 195027, Россия, Санкт-Петербург www.meditek.ru XXXXXX XX рулонов/упаковка XXXXXX см (±10%) МЕДИТЕК® Знамя Труда	Пластырь медицинский фиксирующий Круопор® Гипоаллергенный Фиксирующий на бумажной основе КРУОПОР® ЗАО "МЕДИТЕК" Знамя Труда 195027, Россия, Санкт-Петербург www.meditek.ru XXXXXX XX рулонов/упаковка XXXXXX см (±10%) МЕДИТЕК® Знамя Труда	Пластырь медицинский фиксирующий Круопор® Гипоаллергенный Фиксирующий на бумажной основе КРУОПОР® Серия номер: XXXXXXXX Произведена: XX/XXXX Годен до: XX/XXXX XXXXXX см (±10%) МЕДИТЕК® Знамя Труда
--	---	---	---

Пластырь медицинский фиксирующий Круопор® Гипоаллергенный фиксирующий на бумажной основе КРУОПОР® ЗАО "МЕДИТЕК" Знамя Труда 195027, Россия, Санкт-Петербург www.meditek.ru XXXXXX XX рулонов/упаковка XXXXXX см (±10%) МЕДИТЕК® Знамя Труда	КРУОПОР® Серия номер: XXXXXXXX Произведена: XX/XXXX Годен до: XX/XXXX XXXXXX см (±10%) МЕДИТЕК® Знамя Труда Применяется для надежной фиксации повязок, грубых, зондов, дренажей, катетеров, канюль. Материал: нетканый. Состав: основа - нетканый, адгезив - безводный для кожи полиуретановый.
---	---



XXXX CM
(8-10%)

Пластырь медицинский фиксирующий Крюопласт:

я пластыря в рулонах: кат.№ 806050-806053; 806150-806153



Пластырь медицинский фиксирующий Крюопласт

Гипоаллергенный фиксирующий на основе перфорированного прозрачного пластика

КРУОПЛАСТ

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditec.ru

XXXXXX XX рулонов/упаковка

Пластырь медицинский фиксирующий Крюопласт

Гипоаллергенный фиксирующий на основе перфорированного прозрачного пластика

КРУОПЛАСТ

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditec.ru

XXXXXX XX рулонов/упаковка

Пластырь медицинский фиксирующий Крюопласт

Гипоаллергенный фиксирующий на основе перфорированного прозрачного пластика

КРУОПЛАСТ

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XXXXXX

XXXXXX XX рулонов/упаковка

Пластырь медицинский фиксирующий Крюопласт

Гипоаллергенный фиксирующий на основе перфорированного прозрачного пластика

КРУОПЛАСТ

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XXXXXX

XXXXXX XX рулонов/упаковка

Пластырь медицинский фиксирующий Крюопласт

На основе перфорированного прозрачного пластика

КРУОПЛАСТ

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XXXXXX
Годен до: XXXXXX

XXXXXX XX рулонов/упаковка

Пластырь медицинский фиксирующий Крюопласт

Гипоаллергенный фиксирующий на основе перфорированного прозрачного пластика

КРУОПЛАСТ

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditec.ru

XXXXXX XX рулонов/упаковка


Пластырь медицинский фиксирующий Крюопласт

На основе перфорированного прозрачного пластика

КРУОПЛАСТ

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XXXXXX

XXXXXX XX рулонов/упаковка

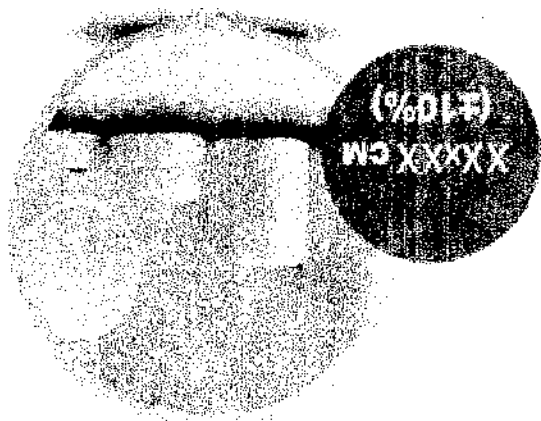

XXXXXX

XX рулонов/упаковка

www.meditecz.ru

3АО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.

КРУОПЛАСТ

гипоаллергенный фиксирующий на основе перфорированного

прозрачного пластика



Пластырь медицинский фиксирующий Крюопласт


Пластырь медицинский фиксирующий Крюопласт

Гипоаллергенный фиксирующий на основе перфорированного
прозрачного пластика

КРУОПЛАСТ

3АО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XXXXXX XX рулонов/упаковка

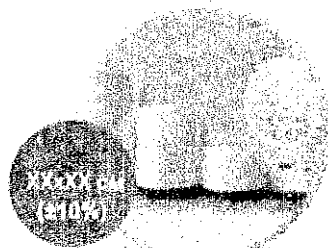

КРУОПЛАСТ

Серия номер: XXXXXXXX

Произведено: XX/XXXXX

Годен до: XX/XXXXX



Состав: основа - латекс (10%); адгезив - биологический для легкой фиксации.
Применение: для фиксации повязок, трубок, катетеров, дренажей, зондов, канюль.
Предупреждение.





ПЛАСТИРЬ
 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
Пластырь
 медицинский фиксирующий
 гипсололептический на эластичной
 текстильной основе

МЕДИТЕК
 Зинин труды

XX x XX см
 (±10%)

СТОПОВАТЬ ЗДЕСЬ


Для пластыря кат. № 105012
Индивидуальная упаковка

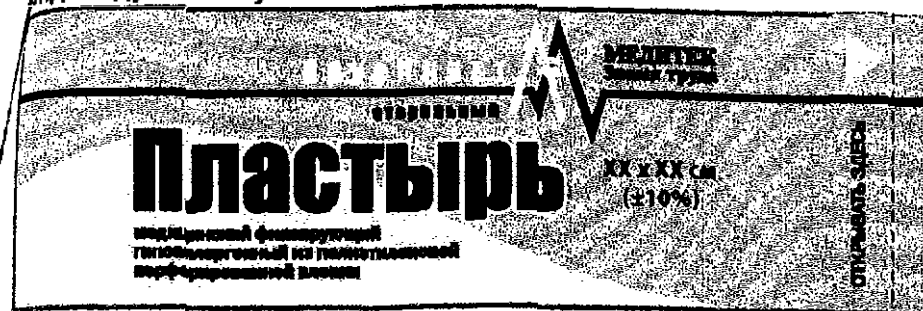

Групповая упаковка



Для пластыря кат. № 105016
Индивидуальная упаковка

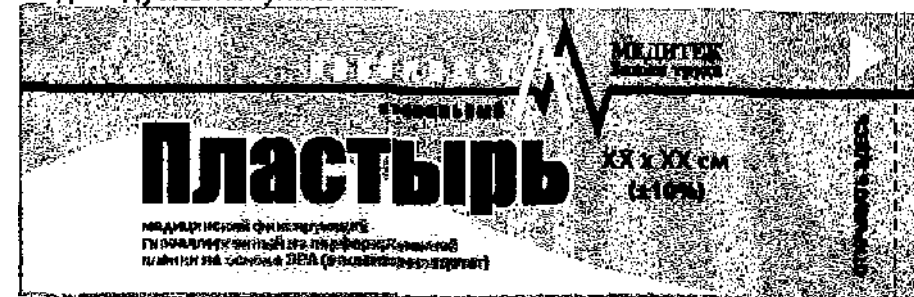

Групповая упаковка



Пластырь медицинский фиксирующий Круподерм®

МЕДИТЕК®
Знамя Труда



КРУПОДЕРМ®
XXXXXX

размер
XXxXX см
(±10%)

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.":

Китай, WAYSON Medical Co., Ltd, 81, Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,

Магнитогорская ул., 11 лит. А, тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение XXXXXXXX от XX.XX.XXXX г



Серия номер: XXXXXXXX

Произведено: XX/XXXX

Годен до: XX/XXXX

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru



Применение: для закрытия поверхности послеоперационных ранам и прочих повреждений кожи, для защиты участков введения внутривенных катетеров и мест венопункции.

Нетоксично. Стерильно.

Состав: основа - нетканый материал, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.



Пластырь медицинский фиксирующий Круподерм®



Пластырь медицинский фиксирующий Круподерм®



КРУПОДЕРМ®

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX



Применение: для закрытия поверхности послеоперационных ран и прочих повреждений кожи, для защиты участков введения внутривенных катетеров и мест венотомии.
Негигиенично, Стерильно.
Состав: основа - нетканый материал, адгезив - безрезиновый для кожи полиакрилат.
Способ наложения: вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.

КРУПОДЕРМ®

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка

XXxXX см
(±10%)



КРУПОДЕРМ®

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А

тел: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются

уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте,

при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение XXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.



КРУПОДЕРМ®

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка

XXxXX см
(±10%)



Пластырь медицинский фиксирующий Круосорб



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

Гипоаллергенная стерильная прозрачная
самоклеющаяся повязка на основе полимерной пленки



КРУОСОРБ

XXXXXX

размер
XXxXX см
(±10%)

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.
Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81,
Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А, тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте, при температуре
не выше 30°C
Регистрационное удостоверение XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru

Серия номер: XXXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX

Применение: для закрытия
неинфицированных ран, фиксации
катетеров и канюль, покрытия повязок.
Состав: основа - полупроницаемая
полимерная пленка, адгезив -
безвредный для кожи полиакрилат.
Нетоксично. Стерильно.

Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь,
менять по рекомендации врача
или по мере необходимости.





MEDITEK®
Знамя Труда

Пластырь медицинский фиксирующий КрУОСОРБ



MEDITEK®
Знамя Труда



Пластырь медицинский фиксирующий КрУОСОРБ



MEDITEK®
Знамя Труда



КРУОСОРБ

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XXXXXX
Годен до: XX/XXXX

Способ нанесения - согласно упаковке.
доказано, что пластырь, наклеенный на кожу,
не вызывает аллергии и не вызывает раздражения.



Гипоаллергенная стерильная прозрачная
самоклеющаяся повязка на основе
полимерной пленки

КРУОСОРБ

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczl.ru

XXXXXX
XX штук



Применение: для закрывания неинфицированных ран, фиксации
катетеров и бандаж, покрытие повязок.
Натягивание, Стерильно.
Состав: основа - полупрозрачная полимерная пленка,
адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.




КРУОСОРБ

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.
Производитель: "BAIYU Medical Co., Ltd.",
Китай, WATSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Fang Road,
Ningbo City, Guangdong, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Малютинская ул., 11 лит. А
тел: (812) 622 10 15, факс: (812) 624 70 73
Препараты потребителя принимаются
уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение
XXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

КРУОСОРБ

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczl.ru

XXXXXX
XX штук

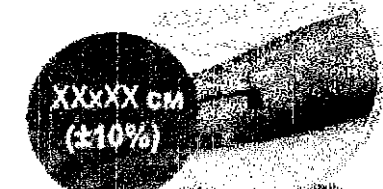

Применение: для закрывания неинфицированных ран, фиксации
катетеров и бандаж, покрытие повязок.
Натягивание, Стерильно.
Состав: основа - полупрозрачная полимерная пленка,
адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Пластырь медицинский фиксирующий Круотек



Стерильная гипоаллергенная самоклеющаяся повязка
на полимерной основе с впитывающей подушечкой

КРУОТЕК

XXXXXX

размер
XXxXX см
(±10%)

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.", Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81,
Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China.

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А, тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение XXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.



Серия номер: XXXXXXXX

Произведено: XX/XXXX

Годен до: XX/XXXX

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru



STERILE EO




Применение: для закрытия поверхности послеоперационных
ран и прочих повреждений кожи, для защиты участков введения
внутривенных катетеров и мест венопункции.

венопункции.

Нетоксично. Стерильно.
Состав: основа - полупроницаемая полимерная
пленка, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.

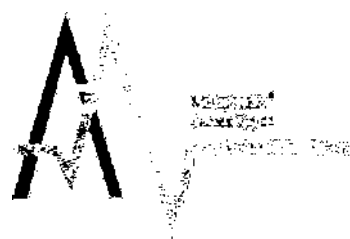

Министерство медицинской фиксации Циртек

МЕДИТЕК
Знамя Труда

Открытая полимерная
самозатягивающаяся повязка на полимерной
основе с впитывающей подушкой

КРЮОТЕК

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка



КРЮОТЕК

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.
Производитель: ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",
Адрес: 195027, Россия, Санкт-Петербург, ул. Родовая, 81, лит. Родовая, 81.
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Малышевская ул., 11 лит. А
тел: (812) 322 12 15, факс: (812) 324 34 33
Доставка по территории приемной и
уполномоченным представителем.
Условия хранения: сухое место,
при температуре не выше 30°C.
Регистрационный номер: XXXXXXXX-XXXXXXX.

Министерство медицинской фиксации Циртек

МЕДИТЕК
Знамя Труда

Открытая полимерная
самозатягивающаяся повязка на полимерной
основе с впитывающей подушкой

КРЮОТЕК


ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка

8. Пластырь медицинский фиксирующий Круофрейм:
Для пластыря кат. № 812009
Индивидуальная упаковка

Пластырь медицинский фиксирующий Круофрейм

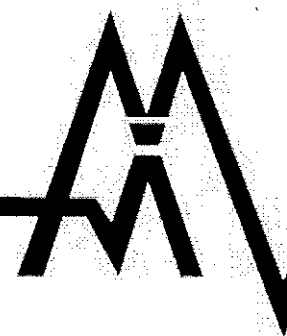

МЕДИТЕК®
Знамя Труда

размер
XXxXX см
(±10%)

КРУОФРЕЙМ

XXXXXX

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Уполномоченный представитель:

"БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co.,
Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu,
Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А, тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"

195027, Россия, Санкт-Петербург.

www.meditecz.ru



Серия номер: XXXXXXXXX

Произведено: XX/XXXX

Годен до: XX/XXXX



Применение: для фиксации внутривенных, периферических
и центральных катетеров.

Нетоксично. Стерильно.

Состав: основа - пенополиэтилен полупроницаемая

полимерная пленка, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Способ наложения - вскрыть упаковку,

достать пластырь, наложить пластырь, менять

по рекомендации врача или по мере необходимости.



КРУОФРЕЙМ

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XXXXXXXX
Годен до: XXXXXXXX

Применение: для фиксации внутривенных, периферических и центральных катетеров.
Неотоксично. Стерильно.
Состав: основа - полупроницаемая полимерная пленка, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.
Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.

Пластырь медицинский фиксирующий Крузфрейм

КРУОФРЕЙМ

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditek.ru

XXXXXX
XX штук/упаковка



КРУОФРЕЙМ




Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.
Производитель: "BAO SHIN Medical Co., Ltd.",
Kuang WATSON Medical Co., Ltd., 81, Jiao Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 79
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение
XXXXXXXX от XXXXXXXX гг.

Пластырь медицинский фиксирующий Крузфрейм


КРУОФРЕЙМ

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditek.ru

XXXXXX
XX штук/упаковка

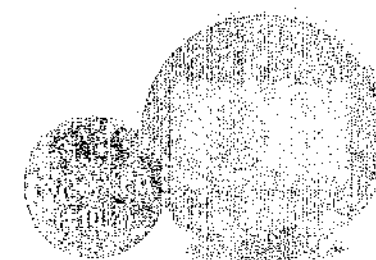

Пластырь медицинский фиксирующий Круофрейм

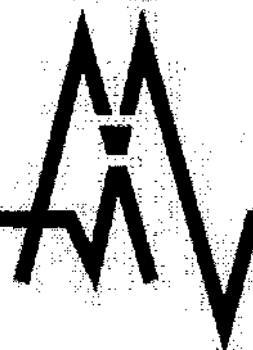

МЕДИТЕК®
Знамя Труда

КРУОФРЕЙМ

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX

размер
XXxXX см
(±10%)

XXXXXX

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",

Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,

Магнитогорская ул., 11 лит. А, тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.



ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru

Применение: для фиксации внутривенных, периферических
и центральных катетеров.

Нетоксично. Стерильно.

Состав: основа - полупроницаемая полимерная пленка,
адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.





МЕДИТЕК®
Знамя Труда

Пластырь медицинский фиксирующий Крюофрейм



МЕДИТЕК®
Знамя Труда



Пластырь медицинский фиксирующий Крюофрейм



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

КРЮОФРЕЙМ

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX



Применение: для фиксации внутривенных, периферических и центральных катетеров. Нетоксично. Стерильно.
Состав: основа - полупроницаемая полимерная пленка, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.
Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.


КРЮОФРЕЙМ

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка

XXxXX см
(±10%)



КРЮОФРЕЙМ



Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.
Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд", Китай, WATSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China.
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург, Малиновская ул., 11 лит. А
тел: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C.
Регистрационное удостоверение XXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.


КРЮОФРЕЙМ

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru


XXXXXX

XX штук/упаковка

XXxXX см
(±10%)



Пластырь медицинский фиксирующий Крюофрейм

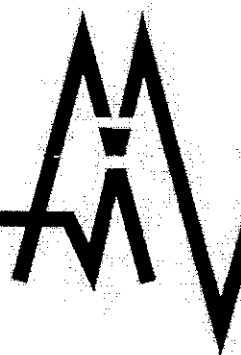

МЕДИТЕК®
Знамя Труда

КРЮОФРЕЙМ

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX

размер
XXxXX см
(±10%)
С ВЫРЕЗОМ

XXXXXX

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",

Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,

Магнитогорская ул., 11 лит. А, тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение

XXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"

195027, Россия, Санкт-Петербург.

www.meditecz.ru



Применение: для фиксации внутривенных, периферических и центральных катетеров.

Нетоксично. Стерильно.

Состав: основа - полупроницаемая полимерная пленка,

адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Способ наложения - вскрыть упаковку,

достать пластырь, наложить пластырь, менять

по рекомендации врача или по мере необходимости.





МЕДИТЕК®
Знамя Труда

Пластырь медицинский фиксирующий Круофрейм



МЕДИТЕК®
Знамя Труда



Пластырь медицинский фиксирующий Круофрейм



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

КРУОФРЕЙМ

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XXXXXX
Годен до: XXXXXXXX



Применение: Для фиксации внутривенных, периферических и центральных катетеров. Нетоксично. Стерильно.
Состав: основа - полупроницаемая полимерная пленка, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.
Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.

КРУОФРЕЙМ

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка

XXxXX см
(±10%)
С ВЫРЕЗОМ



КРУОФРЕЙМ



Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.
Производитель: "ВАЙСОН Медицин Ко., Лтд", Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение XXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

КРУОФРЕЙМ

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка

XXxXX см
(±10%)
С ВЫРЕЗОМ



Пластырь медицинский фиксирующий Круофрейм



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

КРУОФРЕЙМ

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX

размер
XXxXX см
с подушечкой
(±10%)

XXXXXX

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",

Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,

Магнитогорская ул., 11 лит. А, тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение

XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"

195027, Россия, Санкт-Петербург.

www.mediteczt.ru



STERILE EO



Применение: для фиксации внутривенных, периферических и центральных катетеров.

Нетоксично. Стерильно.


Состав: основа - полупроницаемая полимерная пленка,

адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Способ наложения - вскрыть упаковку,

достать пластырь, наложить пластырь, менять

по рекомендации врача или по мере необходимости.

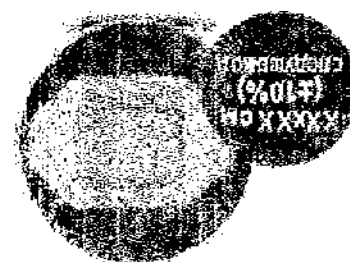

www.meditec.ru
195027, Россия, Санкт-Петербург
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"

КРУОФРЕЙМ

Пластырь медицинский фиксирующий Крусфрейм



МЕДИТЕК®
Знамя Труда




Пластырь медицинский фиксирующий Крусфрейм



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

КРУОФРЕЙМ

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XXXXXXXX
Годен до: XXXXXXXX




Применение: для фиксации внутривенных, периферических и центральных катетеров. Неподвижно. Стерильно.
Состав: основа - полупроницаемая полимерная пленка, адгезив - безопасный для кожи напихиватель.
Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.

КРУОФРЕЙМ

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург
www.meditec.ru

XXXXXX
XX штук/упаковка

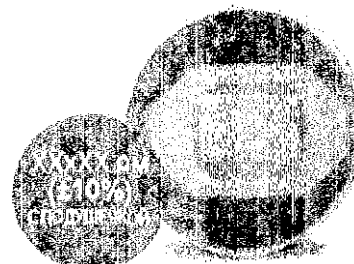

КРУОФРЕЙМ

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.
Производитель: "WATSON Medical Co., Ltd.", Китай, WATSON Medical Co., Ltd., 61, Jin Feng Road, Huang Pi, Guangdong, China.
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург, Матвеевская ул., 11 лит. А
Тел: (812) 622 10 19, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C.
Регистрационное удостоверение:
XXXXXXX от XX.XX.XX г.

КРУОФРЕЙМ

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург
www.meditec.ru

XXXXXX
XX штук/упаковка



9. Пластырь медицинский фиксирующий Круопэд:
Для пластыря кат. № 811013
Индивидуальная упаковка

Пластырь медицинский фиксирующий Круопэд



МЕДИТЕК®
Знамя Труда


КРУОПЭД®

XXXXXX

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX

размер
XXxXX см
(±10%)

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru



Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение
XXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Применение: для фиксации катетеров: дренажных
и периферических.

Нетоксично. Стерильно.

Состав: основа - нетканый материал,
адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

Пластырь медицинский фиксирующий Крнопэд



МЕДИТЕК®
Знамя Труда



Пластырь медицинский фиксирующий Крнопэд



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

КРУОПЭД®

Серия номер: ХХХХХХХХ
Произведено: ХХ/ХХ/ХХ
Годен до: ХХ/ХХ/ХХ



CE E E A

Применение: для фиксации катетеров, дренажных и периферических.
Состав: основа - нетканый материал, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.
Нетоксичен. Стерильно.

Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.

КРУОПЭД®

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru

ХХХХХХ
ХХ штук/упаковка



ХХХХ см
(±10%)

КРУОПЭД®

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.
Производитель: "БАЙСОН Медикал Ко., Лтд",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., A1,
Jin Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China.
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",
195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорский ул., 11, лит. А.
Тел: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73.
Петензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.
Условия хранения в сухом месте,
при температуре не выше 30°C.
Регистрационное удостоверение ХА00000010Х от ХХХХ.ХХХХ г.



КРУОПЭД®

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru

ХХХХХХ
ХХ штук/упаковка



ХХХХ см
(±10%)

Пластырь медицинский фиксирующий Круопэд



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

КРУОПЭД®

XXXXXX

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX



ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru

размер
XXXXX см
(±10%)

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А

тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение
XXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Применение: для фиксации катетеров: дренажных
и периферических. Состав: основа - полимерная пленка,
адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.


Нетоксично. Стерильно.

Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.



STERILE EO



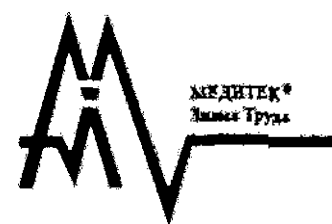

МЕДИТЕК®
Знамя Труда

Пластырь медицинский фиксирующий Круопэд



МЕДИТЕК®
Знамя Труда



Пластырь медицинский фиксирующий Круопэд



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

КРУОПЭД®

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XXXXXXXX
Годен до: XXXXXXXX



Применение: для фиксации катетеров, дренажных
аппаратов, составных частей полимерных пленок,
аппаратов - безредных для кожи, гипсов, пластырей.
Натягивать. Стерильно.
Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.

КРУОПЭД®

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка



КРУОПЭД®

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.
Производитель: "ВАЙСОН Медицинс Ко, Лтд",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., B1,
Jun Fang Road, Huang Pu, Guangzhou, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",
195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул. 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Петензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение
X000000000 от XX.XX.X00000.



КРУОПЭД®

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка



Пластырь медицинский фиксирующий Круопэд



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

КРУОПЭД®

XXXXXX

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX



ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru



STERILE EO



размер
XXxXX см
(±10%)

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение
XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Применение: для фиксации катетеров: дренажных и периферических.

Нетоксично. Стерильно.

Состав: основа - комбинированная
трехкомпонентная повязка, адгезив - безвредный
для кожи полиакрилат.

Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

Пластырь медицинский фиксирующий Крнопэд



МЕДИТЕК®
Знамя Труда



КРУОПЭД®

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XXXXXXXX
Годен до: XXXXXXXX



CE —

Применение: для фиксации катетеров: дренажных и периферических. Состав: основа - комбинированная трехкомпонентная повязка, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.
Неотоксично. Стерильно.

Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.

КРУОПЭД®

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.

www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка

XXXX см
(±10%)



КРУОПЭД®

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.
Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко, Лтд",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81,
Jin Fang Road, Huang Pu, Guangzhou, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",
195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение
XXXXXXX от XXXXXXXX г.



КРУОПЭД®

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка


XXXX см
(±10%)



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

Пластырь медицинский фиксирующий Крнопэд



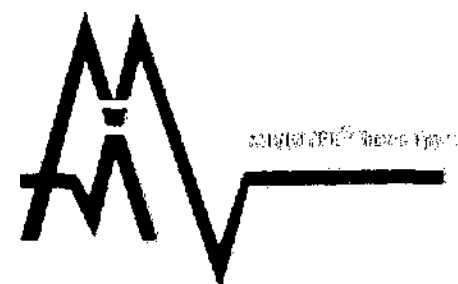

КРУОПЭД®

COUNTRIES: XXXXXXXX
 PRESIDENT: XXXXXX
 NAME: XXXXXXXX

6-2

[illegible]

Пластирь медицинский фиксирующий Кружезд

КРУОПЭД®

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditec21.ru

XXXXXX

XX штук



Пластырь медицинский фиксирующий Круопэд®



МЕДИТЕК®
Знамя Труда



КРУОПЭД®

XXXXXX

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX

размер
XXxXX см
(±10%)

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru



STERILE EO



Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А

тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение
XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Применение: для фиксации катетеров: дренажных
и периферических.

Нетоксично. Стерильно.

Состав: основа - нетканый

материал, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат

Способ наложения - вскрыть упаковку,

достать пластырь, наложить пластырь, менять

по рекомендации врача или по мере необходимости.



Пластырь медицинский фиксирующий Крюпад



Пластырь медицинский фиксирующий Крюпад



КРУОПЭД®



Серия номер: XXXXXXXX
Промоведено: XXXXXXXX
Годен до: XXXXXXXX



Применение: для фиксации повязок, дренажей и периферических. Система основы - нетканый материал, адгезив - безрезиновый для кожи полимеризованный. Нетоксичен. Стерильно.
Способ применения: вскрыть упаковку, достать пластырь, удалить защитную пленку, наклеить по инструкции. Пластырь не имеет необходимости.

КРУОПЭД®

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка



КРУОПЭД®



Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.
Производитель: "WATSON Medical Co., Ltd.",
Huang Pu, Guangzhou, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",
195027, Санкт-Петербург,
Матвеевская ул., 11 лит. А
Тел: (812) 622 10 15, факс (812) 334 79 72
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.
Упаковка хранения в сухом месте,
при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение
XXXXXXXX от XXXX.XXXX.XX.

КРУОПЭД®

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка



Пластырь медицинский фиксирующий Холмекс

Стерильное разрезаемое операционное покрытие

ХОЛМЕКС

XXXXXX

Серия номер: XXXXXXXX

Произведено: XX/XXXX

Годен до: XX/XXXX

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru

Способ наложения - вскрыть,
достать, наложить, менять
по рекомендации врача
или по мере необходимости.



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

размер
XXxXX см
(±10%)



Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.", Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81,
Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11-лит. А, тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение XXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Состав: основа - особо тонкий полимер с антибликовым покрытием, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Применение: для закрытия поверхности операционного поля после обычной предоперационной подготовки.

Нетоксично. Стерильно.



Пластырь медицинский фиксирующий Холмекс

Стерильное разрезаемое операционное покрытие

ХОЛМЕКС

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.
Производитель: "WATSON Medical Co., Ltd.", Китай, WATSON Medical Co., Ltd., 61,
Xinling Road, Nanchang, China.
Уполномоченный представитель:
ООО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 190000, Санкт-Петербург,
Малышевская ул., 11, лит. А, телефон 812 452 18 15, факс: 812 358 79 73.
Применение: для фиксации операционного поля после обычной предоперационной подготовки.
Условия хранения: в сухом месте при температуре не выше 30°C.
Регистрационный номер: XXXXXXX от 12.06.2008 г.




ХОЛМЕКС
Серия номер: XXXXXXX
Произведено: XXXXXX
Годен до: XXXXXX
CE EN ISO 13485

Пластырь медицинский фиксирующий Холмекс

Стерильное разрезаемое операционное покрытие

ХОЛМЕКС

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.
Производитель: "WATSON Medical Co., Ltd.", Китай, WATSON Medical Co., Ltd., 61,
Xinling Road, Nanchang, China.
Уполномоченный представитель:
ООО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 190000, Санкт-Петербург,
Малышевская ул., 11, лит. А, телефон 812 452 18 15, факс: 812 358 79 73.
Применение: для фиксации операционного поля после обычной предоперационной подготовки.
Условия хранения: в сухом месте при температуре не выше 30°C.
Регистрационный номер: XXXXXXX от 12.06.2008 г.



Пластырь медицинский фиксирующий Холмекс

Стерильное разрезаемое операционное покрытие

ХОЛМЕКС

ООО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
191007, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditek.ru

XXXXXX
XX рулонов/упаковка

Состав: основа - особа тонкий полимер с антибактериальным покрытием, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.
Применение: для закрытия поверхности операционного поля после обычной предоперационной подготовки.
Негтоксично. Стерильно.



ХОЛМЕКС
Серия номер: XXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX

CE EN ISO 13485



Пластырь медицинский фиксирующий Холмекс

Стерильное разрезаемое операционное покрытие

ХОЛМЕКС

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.", Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., B1, Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., 11 лит. А, тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.



ХОЛМЕКС

Способ наложения - вскрыть, достать, наложить, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.



Крупофикс Серия номер: XXXXXXXX Производитель: XXXXXXXX Год выпуска: XXXXXXXX Крупофикс			
Крупофикс Серия номер: XXXXXXXX Производитель: XXXXXXXX Год выпуска: XXXXXXXX Крупофикс			
КРУПОФИКС Серия номер: XXXXXXXX Производитель: XXXXXXXX Год выпуска: XXXXXXXX Крупофикс Гипоаллергенный перфорированный фиксирующий на нетканой основе КРУПОФИКС 340 "МЕДИТЕК" "Зимин Труд" 195007, Россия, Омская область www.meditek.ru XXXXXX XX штук/упаковка	Пластырь медицинский фиксирующий Крупофикс Крупофикс Гипоаллергенный перфорированный фиксирующий на нетканой основе КРУПОФИКС 340 "МЕДИТЕК" "Зимин Труд" 195007, Россия, Омская область www.meditek.ru XXXXXX XX штук/упаковка	КРУПОФИКС Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Прокладывать: "МЕДИТЕК" Медицинский Ко., Ltd., 340, Jun Feng Road, Nizhny Novgorod, China Уполномоченный представитель: 340 "МЕДИТЕК" "Зимин Труд", 195007, Санкт-Петербург, Мельничковская ул., 11 лит. А тел: (812) 633 10 19, факс: (812) 334 79 73 Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем. Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C Регистрационный номер: XXXXXX от XXXXXXXX г. Крупофикс Гипоаллергенный перфорированный фиксирующий на нетканой основе КРУПОФИКС 340 "МЕДИТЕК" "Зимин Труд" 195007, Россия, Омская область www.meditek.ru XXXXXX XX штук/упаковка	Пластырь медицинский фиксирующий Крупофикс Крупофикс Гипоаллергенный перфорированный фиксирующий на нетканой основе КРУПОФИКС 340 "МЕДИТЕК" "Зимин Труд" 195007, Россия, Омская область www.meditek.ru XXXXXX XX штук/упаковка

Пластырь медицинский фиксирующий Крупофикс

МЕДИТЕК®
Знамя Труда



КРУПОФИКС

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX



Применение: для сплошной фиксации раневых, послеоперационных повязок, в особенности на подвижных частях тела, для фиксации прибора, катетера, канюль. Рекомендуется пациентам с чувствительной кожей.
Состав: основа - нетканый материал, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.
Нетоксично.

Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.


Гипоаллергенный перфорированный фиксирующий на нетканой основе

КРУПОФИКС

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка

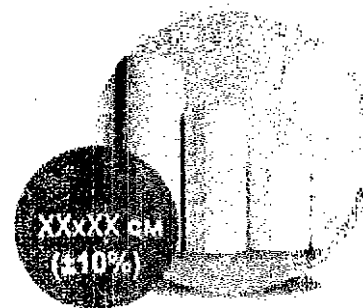

КРУПОФИКС

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.
Производитель: "ВАЙСИНЬ Медицин Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81,
Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",
195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение
XXXXXXX от XX.XX.XXXX г.



Пластырь медицинский фиксирующий Крупофикс

МЕДИТЕК®
Знамя Труда




Гипоаллергенный перфорированный фиксирующий на нетканой основе

КРУПОФИКС

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XXXXXX


XX штук/упаковка

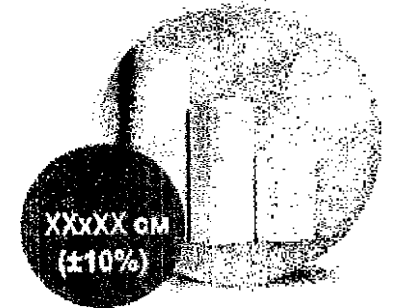

		
		КРУПОФИКС XXXXXX XX рулонов/упаковка CE   
		КРУПОФИКС Серия номер: XXXXXXXX Произведено: XXXXXXXX Годен до: XXXXXXXX CE   

 Гипоаллергенный фиксирующий на текстильной основе с оксидом цинка КРЮЦИНК XXXXXX XX штук/упаковка Медитек "Знамя Труда"	Пластырь медицинский фиксирующий Крюцинк Гипоаллергенный фиксирующий на текстильной основе с оксидом цинка КРЮЦИНК XXXXXX XX штук/упаковка Медитек "Знамя Труда"	Пластырь медицинский фиксирующий Крюцинк Гипоаллергенный фиксирующий на текстильной основе с оксидом цинка КРЮЦИНК XXXXXX XX штук/упаковка Медитек "Знамя Труда"	Пластырь медицинский фиксирующий Крюцинк Гипоаллергенный фиксирующий на текстильной основе с оксидом цинка КРЮЦИНК XXXXXX XX штук/упаковка Медитек "Знамя Труда"
Пластырь медицинский фиксирующий Крюцинк Гипоаллергенный фиксирующий на текстильной основе с оксидом цинка КРЮЦИНК XXXXXX XX штук/упаковка Медитек "Знамя Труда"	Пластырь медицинский фиксирующий Крюцинк Гипоаллергенный фиксирующий на текстильной основе с оксидом цинка КРЮЦИНК XXXXXX XX штук/упаковка Медитек "Знамя Труда"	Пластырь медицинский фиксирующий Крюцинк Гипоаллергенный фиксирующий на текстильной основе с оксидом цинка КРЮЦИНК XXXXXX XX штук/упаковка Медитек "Знамя Труда"	Пластырь медицинский фиксирующий Крюцинк Гипоаллергенный фиксирующий на текстильной основе с оксидом цинка КРЮЦИНК XXXXXX XX штук/упаковка Медитек "Знамя Труда"

Пластырь медицинский фиксирующий Крюцинк Гипоаллергенный фиксирующий на текстильной основе с оксидом цинка ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда" 195027, Россия, Санкт-Петербург. www.meditecz.ru КРЮЦИНК XXXXXX XX штук/упаковка Медитек "Знамя Труда"	КРЮЦИНК Серия номер: XXXXXXXX Произведено: XX/XXXX Годен до: XX/XXXX Применение: для фиксации повязок, трубок, зондов, дренажей, катетеров, канюль, для иммобилизации пациентов. Состав: основа - тканевая (хлопок), адгезив - акрилатный цинкоксид. Нетоксично.
---	--

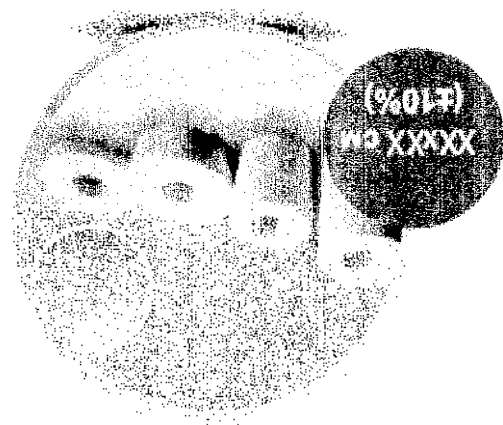

XXXXXX см
(±10%)



XXXXXX

XX штук/упаковка

www.mediatek.ru

196027, Россия, Санкт-Петербург.

ЗАО "МЕДИТЕК "Знания Трудом"

КРУОЦИНК

основе с оксидом цинка

Гипоаллергенный фиксирующий на текстильной

МЕДИТЕК®
Знания Трудом

Пластырь медицинский фиксирующий Круоцинк

Пластырь медицинский фиксирующий Круоцинк

Гипоаллергенный фиксирующий на текстильной основе с оксидом цинка

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость.

Противопоказано: "WATSON Medical Co., Ltd., 88, Jun Feng Road,

Guang Pu, Guangdong, P.R.China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знания Трудом", 196027, Санкт-Петербург.


Балтийский проспект, 11 этаж А

тел: (812) 322 10 15, факс: (812) 344 19 23

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C.

Регистрационный удостоверение XXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.



КРУОЦИНК

XXXXXX XX штук/упаковка



КРУОЦИНК

Серия номер: XXXXXXXX

Произведена: XXXXXXXX

Годен до: XXXXXXXX



Способ наложения – вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.

Пластырь медицинский фиксирующий Круокид



КРУОКИД
XXXXXX



Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XXXXXXXX
Годен до: XX/XXXX

размер
XXxXX

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru



STERILE EO



Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А

тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Применение: для закрытия поверхности на небольших
операционных ранах и прочих повреждениях кожи,
для защиты участков введения внутривенных катетеров
и мест венепункций, для фиксации катетеров.

Нетоксично. Стерильно.

Состав: основа - нетканый материал, адгезив -
гипоаллергенный, безвредный для кожи медицинский клей.

Способ наложения: вскрыть упаковку, достать пластырь,
наложить пластырь, менять по рекомендации врача
или по мере необходимости.



Пластырь медицинский фиксирующий Круокид



Пластырь медицинский фиксирующий Круокид



КРУОКИД

Серия номер: XXXXXXXX
Произведен: XXXXXXXX
Годен до: XXXXXXXX



Применение: для стерильного ухода за небольшими и операционными ранами и прочими повреждениями кожи, для защиты участков введения внутривенных катетров и мест венепункций, для фиксации катетеров, нетоксичен. Стерильно.
Состав: основа - нетканый материал, адгезив - гипоаллергенный, безрецептурный для кожи медицинский клей.
Способ применения: вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.



КРУОКИД

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка



КРУОКИД

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.
Производитель: "ВАЙСОН" Медицин Ко, Лтд.
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jin Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Манинаторская ул., 11 лит. А
тел: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C.
Годен до: см. на упаковке.
Рег. Уд. ФСЗ № 20.10.107986 от 04.06.2013 г.



КРУОКИД

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка



14. Пластырь медицинский фиксирующий Холмосорб:
Для пластыря кат. № 810015
Индивидуальная упаковка

Пластырь медицинский фиксирующий Холмосорб

Карман для катетеров

ХОЛМОСОРБ

XXXXXX

Серия номер: XXXXXXXX

Произведено: XX/XXXX

Годен до: XX/XXXX

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.


www.meditecz.ru

Применение: для надежной фиксации катетеров и защиты от инфекции

Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь,
менять по рекомендации врача или по мере необходимости.

Нетоксично. Стерильно.

Состав: 100% полиэстер

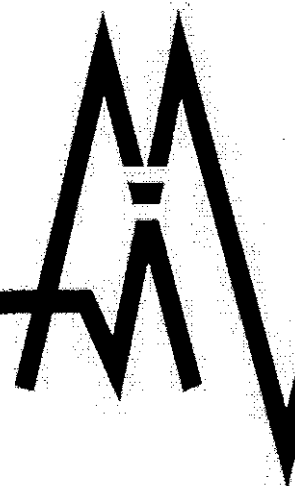

МЕДИТЕК®
Знамя Труда



Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.

Производитель:

"БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co.,
Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu,
Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:


ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",
195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение
XXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

размер
XXxXX см
(±10%)





МЕДИТЕК®
Знамя Труда



ХОЛМОСОРБ

Серия номер: XXXXXXXX
Применение: XXXXXXXX
Годен до: XXXXXXXX



Пластырь медицинский фиксирующий Холмосорб

Карман для катетеров

ХОЛМОСОРБ

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Санкт-Петербург,
www.meditex.ru

XXXXXX XX штук/упаковка

Состав: 100% полиэстер
Применение: для фиксации цимометрии
катетеров и защиты от инфекции
Натяжка, Стерильная



МЕДИТЕК®
Знамя Труда



Противопоказания:
и индивидуальная непереносимость
Противопоказания: БАЙСИИ Медицинский Ко., Лтд.,
China, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем
Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение
XXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Способ наложения: вскрыть упаковку, достать пластырь,
наложить пластырь, менять по рекомендации врача
или по мере необходимости.

Пластырь медицинский фиксирующий Холмосорб

Карман для катетеров

ХОЛМОСОРБ

XXXXXX XX штук/упаковка



МЕДИТЕК®
Знамя Труда




Пластырь медицинский фиксирующий Холмосорб

Карман для катетеров

ХОЛМОСОРБ


XXXXXX XX штук/упаковка

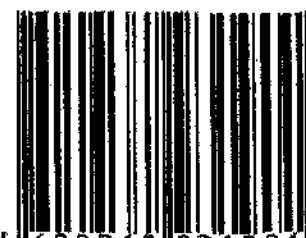

4 620768 931901



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

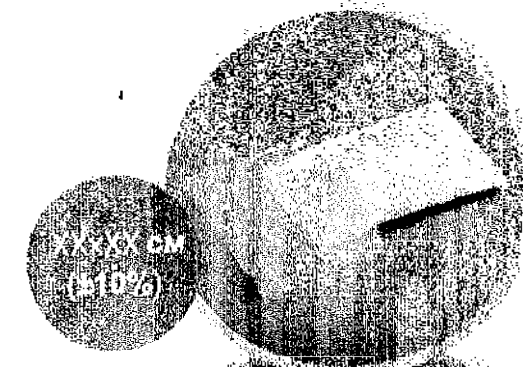

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИИ Медицинский Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение
XXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь,
наложить пластырь, менять по рекомендации врача
или по мере необходимости.




МЕДИТЕК®
Знамя Труда



ХОЛМОСОРБ

Серия изделий ХОЛМОСОРБ
Производство ХОЛМОСОРБ
Подразделение ХОЛМОСОРБ



Пластырь медицинский фиксирующий Холмосорб

Карман для катетеров

ХОЛМОСОРБ


ОАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
142002, Россия, Санкт-Петербург
www.medtec.ru

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

Состав: 100% полиакрилат
Применение: для надежной фиксации
катетеров и защиты от инфекции
Неоткалываемый. Стерильный.



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

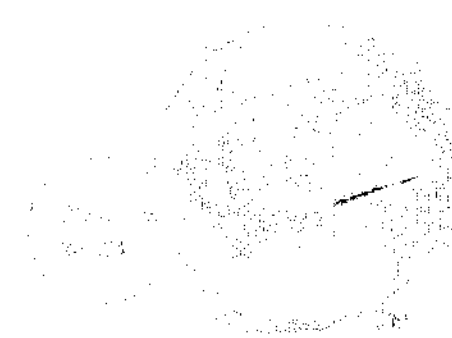

Пластырь медицинский
фиксирующий Холмосорб



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

Гипоаллергенная стерильная повязка
с высокой адсорбирующей способностью

ХОЛМОСОРБ
XXXXXX

Серия номер: XXXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX

размер
XXxXX см
(±10%)



ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru

Способ наложения - вскрыть, достать, наложить, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.



STERILE EO



Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.

Производитель:
"БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co.,
Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu,
Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",

195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C


Регистрационное удостоверение
XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Применение: для закрытия поверхности
трофических язв, пролежней и других ран
с высокой и средней степенью экссудации.
Повязки меняются по мере пропитывания.



ХОЛМОСОРБ

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX



Пластырь медицинский
фиксирующий Холмосорб

Плассмолоринг с трициклол пропаном
с высокой адсорбирующей способностью

ХОЛМОСОРБ

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditek.ru
XXXXXX
XX рулонов/упаковки

Способ применения - вскрыть,
достать, наложить, удалить
по рекомендации врача
или по мере необходимости.



Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.
Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение
XXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Пластырь медицинский
фиксирующий Холмосорб

Виполтергитал с трициклол пропаном
с высокой адсорбирующей способностью

ХОЛМОСОРБ

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditek.ru
XXXXXX

XX рулонов/упаковки
Назначение: для закрытия повреждений
травматического, лез, проколов и других ран
с высокой и средней степенью экссудации.
Полная непереносимость: гиперчувствительность,
непереносимость, аллергия.
Состав: 85% крахмального волокна,
15% стиропен (полипропилен)





Пластырь медицинский фиксирующий Назофикс



Пластырь медицинский фиксирующий Назофикс




НАЗОФИКС

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XXXXXXXX
Годен до: XXXXXXXX



Способ нанесения - поддеть, ухватить, двинуть вперед, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.



НАЗОФИКС

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditex.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка

Применение: для фиксации назальных катетеров.
Натяжно-стерильно.
Состав: основа - нетканый материал, адгезив -
базисный для кожи полиакрилат.



Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.
Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение
XXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

НАЗОФИКС

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditex.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка

Применение: для фиксации назальных катетеров.
Натяжно-стерильно.
Состав: основа - нетканый материал, адгезив -
базисный для кожи полиакрилат.



Пластырь медицинский фиксирующий Назофикс



НАЗОФИКС

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditex.ru


XXXXXX

XX штук/упаковка

Применение: для фиксации назальных катетеров.
Натяжно-стерильно.
Состав: основа - нетканый материал, адгезив -
базисный для кожи полиакрилат.



Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.
Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81, Jun Feng Road,
Huang Pu, Guangzhou, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение
XXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

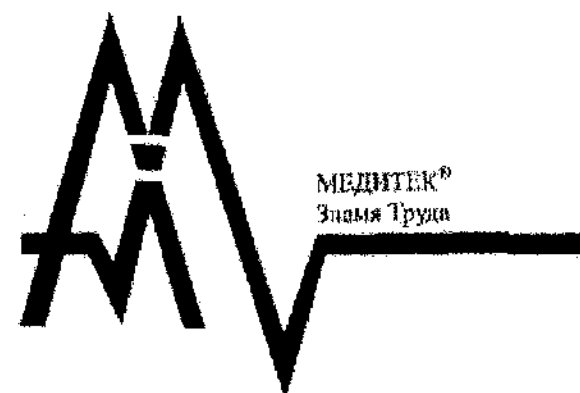

МЕДИТЕК®
Знамя Труда

Пластырь медицинский фиксирующий Назофикс



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

НАЗОФИКС

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX



Способ наложения – вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.



НАЗОФИКС

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditek.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка

Применение: для фиксации назальных катетеров.
Нетоксично, Стерильно.
Состав: основа – нетканый материал, адгезив –
безвредный для кожи полиакрилат.



XX±XX см
(±10%)

Пластырь медицинский фиксирующий Офталофикс



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

Гипоаллергенная стерильная повязка на глаз

ОФТАЛОФИКС

XXXXXX

цвет: бежевый


Серия номер: XXXXXXXX

Произведено: XX/XXXX

Годен до: XX/XXXX



ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru



Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81,
Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А

тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Применение: для закрытия поверхности амблиопии и закрытия
глаза после хирургического вмешательства.

Нетоксично. Стерильно.

Состав: основа - нетканый материал, адгезив - безвредный
для кожи полиакрилат.

Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь,
наложить пластырь, менять по рекомендации врача
или по мере необходимости.



XXXXXX
XX штук/упаковка
www.meditecz.ru
195027, Россия, Санкт-Петербург
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"

ОФТАЛОФИКС

(±10%)
XXXXXX см

Пластырь медицинский фиксирующий Офталлофикс

МЕДИТЕК®
Знамя Труда



Пластырь медицинский фиксирующий Офталлофикс

МЕДИТЕК®
Знамя Труда

ОФТАЛОФИКС

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург
www.meditecz.ru



Применение: для закрытия поверхности амблиопии и закрытия глаза после хирургического вмешательства.
Нетоксично. Стерильно.
Состав: основа - нетканый материал, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.
Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.

Гипоаллергенная стерильная
повязка на глаз

ОФТАЛОФИКС

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург
www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка

цвет: бежевый



ОФТАЛОФИКС

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.
Производитель: "ВАЙСОНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81,
Jin Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 70 73
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение
XXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Гипоаллергенная стерильная
повязка на глаз

ОФТАЛОФИКС

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург
www.meditecz.ru

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XXXXXXXX



Пластырь медицинский фиксирующий Офталофикс

МЕДИТЕК®
Знамя Труда

Гипоаллергенная стерильная повязка на глаз

ОФТАЛОФИКС

светонепроницаемая

XXXXXX

Серия номер: XXXXXXXX

Произведено: XX/XXXX

Годен до: XX/XXXX



ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru



Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель:

"БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co.,
Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",
195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение
XXXXXXX от XX.XX.XXXX г.


Применение: для закрытия поверхности амблиопии
и закрытия глаза после хирургического вмешательства.

Нетоксично. Стерильно.

Состав: основа - нетканый материал, адгезив - безвредный
для кожи полиакрилат.

Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь,
наложить пластырь, менять по рекомендации врача
или по мере необходимости.

размер
XXxXX см
(±10%)

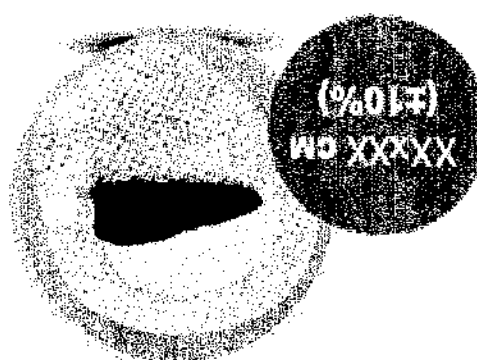

XXXXX см
(±10%)

CE 0147

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XXXXXX
Годен до: XXXXXX

195027, Россия, Санкт-Петербург
www.medileczt.ru

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"

ОФТАЛОФИКС

Пластырь медицинский фиксирующий Офталлофикс



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

ОФТАЛОФИКС

Гипоаллергенная стерильная повязка на глаз

XXXXXX

XX штук/упаковка

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург
www.medileczt.ru

цвят светонепроницаемая



XXXXX см
(±10%)

ОФТАЛОФИКС

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург
www.medileczt.ru

CE 0147

Применение: для закрытия поверхности амблиопии и закрытия глаза после хирургического вмешательства.
Источником. Стерильно.
Состав: основа - нетканый материал, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.
Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.

АЙПЭД XXXXXX

Пластырь медицинский фиксирующий Айпэд

Гипоаллергенная стерильная повязка на глаз

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.


Производитель:

"БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co.,
Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu,
Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",
195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение
XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.



Серия номер: XXXXXXXXX

Произведено: XX/XXXX

Годен до: XX/XXXX



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

размер
XXxXX см
(±10%)

Применение: для закрытия поверхности глаза, амблиопии
и закрытия глаза после хирургического вмешательства.

Нетоксично. Стерильно.

Состав: нетканый материал.

Способ наложения - вскрыть, достать, наложить,
менять по рекомендации врача
или по мере необходимости.

АЙПЭД

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург
www.mediteczl.ru



Состав: нетканый материал
Применение: для закрытия поверхности глаза, амблиопии и закрытия глаза после хирургического вмешательства.
Нетоксично. Стерильно.
Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь, наложить пластырь, менять по рекомендации врача или по мере необходимости.

АЙПЭД

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург
www.mediteczl.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка
Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX

XXxXX см
(±10%)



Пластырь медицинский фиксирующий Айпэд
Гипоаллергенная стерильная повязка на глаз



XX рулонов/упаковка

XXXXXX

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург
www.mediteczl.ru

АЙПЭД



АЙПЭД

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.
Производитель:
"ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSIN Medical Co.,
Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu,
Guangzhou, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение
XXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

АЙПЭД

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург
www.mediteczl.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка
Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX

XXxXX см
(±10%)



Пластырь медицинский фиксирующий Айпэд
Гипоаллергенная стерильная повязка на глаз

Пластырь медицинский фиксирующий Сейфофикс



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

Гипоаллергенная стерильная лечебная
компресс-повязка с подушечкой

СЕЙФОФИКС

XXXXXX

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург
www.mediteczf.ru

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель:

"БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co.,
Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu,
Guangzhou, China


Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",
195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение
XXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

размер
XXxXX см
(±10%)




Применение: для фиксации при наложении лечебных, холодных, горячих, согревающих компрессов.
Нетоксично. Стерильно.

Состав: состоит из трех компонентов: наружный слой - особо плотная гипоаллергенная адгезивная нетканая основа, средний слой - полимерная пленка и внутренняя часть - круглая подушечка.

Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь,
наложить пластырь, менять по рекомендации врача
или по мере необходимости.

Пластырь медицинский фиксирующий Артофикс



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

Гипоаллергенная стерильная лечебная компресс-повязка
с ограждающей рамкой

АРТОФИКС

XXXXXX

Серия номер: XXXXXXXX

Произведено: XX/XXXX

Годен до: XX/XXXX

размер
XXxXX см
(±10%)

ЗАО "МЕДИТЕК" "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург
www.mediteczf.ru

Состав: состоит из трех компонентов: наружный слой - особо плотная гипоаллергенная адгезивная нетканая основа, средний слой - полимерная пленка и внутренняя часть - квадратная нетканая ламинированная рамка.

Применение: для фиксации при наложении лечебных, холодных, горячих, согревающих компрессов. Нетоксично. Стерильно.

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.

Производитель:
"БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co.,
Ltd., 81, Jun Feng Road, Huang Pu,
Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК" "Знамя Труда",
195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте,
при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение
XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.



Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь,
наложить пластырь, менять по рекомендации врача
или по мере необходимости.





АРТОФИКС
 ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
 195027, Россия, Санкт-Петербург
 www.meditecz.ru

Пластырь медицинский фиксирующий Артофикс



МЕДИТЕК®
 Знамя Труда



Пластырь медицинский фиксирующий Артофикс



МЕДИТЕК®
 Знамя Труда

Гипоаллергенная стерильная лечебная компресс-повязка
 с ограждающей рамкой


АРТОФИКС

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
 195027, Россия, Санкт-Петербург
 www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка

Состав: состоит из трех компонентов: наружный слой - особо плотная гипоаллергенная адгезивная нетканая основа, средний слой - полимерная пленка и внутренняя часть - квадратная нетканая ламинированная рамка.

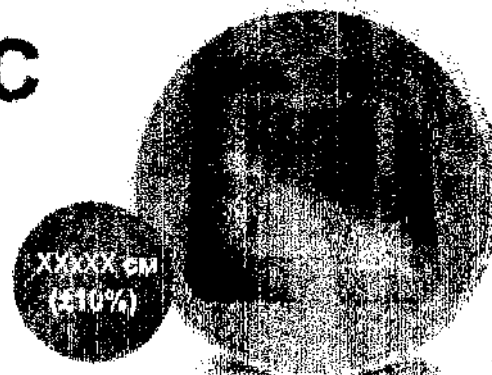

XXxXX см
 (±10%)

АРТОФИКС

Противопоказания:
 индивидуальная непереносимость.
 Производитель:
 "ВАКСИН" Medical Co., Ltd.,
 Китай, WAYSAN Medical Co.,
 Ltd., 81, Lin Feng Road, Huang Pu,
 Guangdong, China
 Уполномоченный представитель:
 ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда",
 195027, Санкт-Петербург,
 Маршала Голубовского ул. 11 лит. А
 Тел: (812) 672 10 15, факс: (812) 334 79 73
 Претензий потребителей принимают
 уполномоченным представителем.
 Условия хранения: в сухом месте,
 при температуре не выше 30°C
 Регистрационное удостоверение
 XXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Гипоаллергенная стерильная лечебная компресс-повязка
 с ограждающей рамкой


АРТОФИКС

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
 195027, Россия, Санкт-Петербург
 www.meditecz.ru

XXXXXX

XX штук/упаковка

Состав: состоит из трех компонентов: наружный слой - особо плотная гипоаллергенная адгезивная нетканая основа, средний слой - полимерная пленка и внутренняя часть - квадратная нетканая ламинированная рамка.

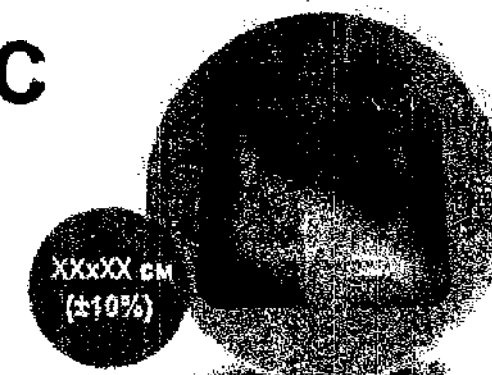

XXxXX см
 (±10%)

АРТОФИКС

Серия номер: XXXXXXXX
 Произведено: XXXXXX
 Годен до: XXXXXX



Применение: для фиксации при хронических заболеваниях,
 коллоидных, герпетических, сыпешных компрессов.
 Нетканый, Стерильный.
 Способ наложения - вскрыть упаковку,
 достать пластырь, наложить пластырь,
 снять по рекомендации врача
 или по мере необходимости.



Министерство
Здравоохранения
Республики Казахстан

NESTLE
Nestle Inc.



NOVITEX
Zurich, Switzerland

XXXXXX
©1974



XX-XX em
(±10%)

[illegible]

Пластырь медицинский фиксирующий Круострип



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

Гипоаллергенные стерильные полоски
для сведения краев ран

КРУОСТРИП
XXXXXX

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

Серия номер: XXXXXXXX

Произведено: XX/XXXX

Годен до: XX/XXXX



Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.



размер
XXxXX см
(±10%)

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.", Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81,
Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А, тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение XXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Применение: для закрытия поверхности раны и стабилизации
свежих послеоперационных рубцов.

Нетоксично. Стерильно.

Состав: основа - 100% нейлон, адгезив - безвредный
для кожи полиакрилат.

Пластырь медицинский фиксирующий КрУОСТРИП

Гипоаллергенные стерильные полоски для сведения краев ран



КРУОСТРИП

ЗАО "МЕДИТЕК "Знания Труда"
185027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditek.ru

XX штук/упаковка



Серия номер: XXXXXXXX
Промышленность: XXXXXXXX
Годен до: XXXXXXXX



КРУОСТРИП

XXXXXXXX

Применение: для закрытия поверхности раны
и стабилизации свежих послеоперационных рубцов.
Назначение: Стерильный.
Состав: основа - 100% нейлон, адгезив -
безводный для кожи полиакрилат.
Способ упаковки - вскрыть упаковку,
аккуратно отделить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.

Пластырь медицинский фиксирующий КрУОСТРИП


Гипоаллергенные стерильные полоски для сведения краев ран



КРУОСТРИП

ЗАО "МЕДИТЕК "Знания Труда"
185027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditek.ru

XX штук/упаковка

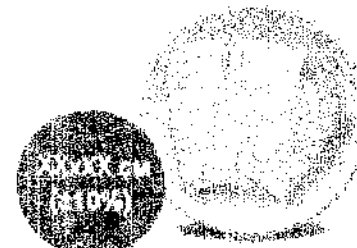

Серия номер: XXXXXXXX
Промышленность: XXXXXXXX
Годен до: XXXXXXXX



КРУОСТРИП

XXXXXXXX

Применение: для закрытия поверхности раны
и стабилизации свежих послеоперационных рубцов.
Назначение: Стерильный.
Состав: основа - 100% нейлон, адгезив -
безводный для кожи полиакрилат.
Способ упаковки - вскрыть упаковку,
аккуратно отделить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.

Пластырь медицинский фиксирующий Круострип

Гипоаллергенные стерильные полоски для сведения краев ран



КРУОСТРИП

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.mediteczt.ru

XX штук/упаковка



Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX



КРУОСТРИП

XXXXXX

Применение: для закрытия поверхности раны
и стабилизации свежих послеоперационных рубцов.
Нетоксично. Стерильно.
Состав: основа - 100% нейлон, адгезив -
безвредный для кожи полиакрилат.
Способ наложения - вскрыть упаковку,
достать пластырь, наложить пластырь, менять
по рекомендации врача или по мере необходимости.



Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XXXXXX
Годен до: XXXXXX



Пластырь медицинский фиксирующий Круострип


Гипоаллергенные стерильные полоски для сведения краев ран



КРУОСТРИП

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.mediteczt.ru

XX штук/упаковка

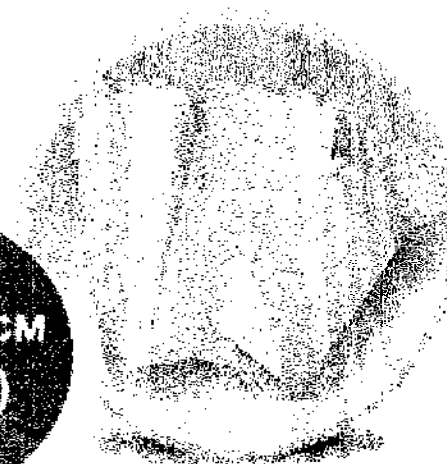

КРУОСТРИП

XXXXXX

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "WATSON Medical Co., Ltd.", Китай, WATSON Medical Co., Ltd., B1, Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,

Магнитогорская ул., 11 лит. А, тел: (812) 622 10 15, факс: (812) 314 79 73

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение: XXXXXXXX от XX.XXXXXX г.

Пластырь медицинский фиксирующий Круофин



МЕДИТЕК®
Знамя Труда

Стерильная мазевая повязка
из крупноячеистой хлопковой ткани

КРУОФИН




XXXXXX

размер
XXxXX см
(±10%)

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditecz.ru

Состав: основа – 100% обезжиренная
хлопковая ткань, мазевая масса
на основе парафина.



Противопоказания:

индивидуальная непереносимость.

Производитель: "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.",
Китай, WAYSON Medical Co., Ltd., 81,
Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China

Уполномоченный представитель:

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Регистрационное удостоверение XXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Применение: для закрытия поверхности трофических и диабетических язв,
пролежней, ссадин, при трансплантации кожи, для фиксирования кожных
трансплантов.

Нетоксично. Стерильно.

Способ наложения – вскрыть, достать, наложить,
менять по рекомендации врача или по мере необходимости.



Пластырь медицинский фиксирующий Круофин

Стерильная мазевая повязка
из крупноячеистой хлопковой ткани

КРУОФИН XXXXXX

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditecz.ru

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Производитель: "BAIYUIN Medical Co., Ltd.",
China, WAYSUN Medical Co., Ltd., 81,
Jun Feng Road, Huang Pu, Guangzhou, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел.: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение XXXXXXXXX от XXXXXXXX г.

XXxXX см
(±10%)

XX штук/упаковка



КРУОФИН

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX



Применение: для закрытия поверхности
трофических и диабетических язв, пролежней,
ссадин, при трансплантации кожи, для фиксирования кожных трансплантов.

Нейлоново, Стерильно.

Пластырь медицинский фиксирующий Круофин

Стерильная мазевая повязка
из крупноячеистой хлопковой ткани

КРУОФИН

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
195027, Россия, Санкт-Петербург,
www.meditecz.ru

XXXXXX


XX штук/упаковка

Состав: основа – 100% обезжиренная хлопковая ткань,
мазевая масса на основе парафина.

Способ наложения – вскрыть, достать, наложить,
менять по рекомендации врача или по мере необходимости.

XXxXX см
(±10%)



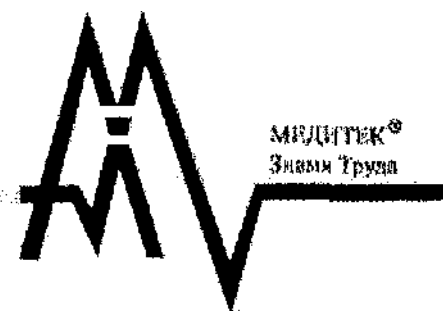


Пластырь медицинский фиксирующий Крюофин

Стерильная марлевая повязка
из крупноячеистой хлопковой ткани

КРЮОФИН XXXXXXXX

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"
185027, Россия, Санкт-Петербург.
www.meditec21.ru

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Производитель: "WAYSON Medical Co., Ltd.",
Kipin, WAYSON Medical Co., Ltd., #1,
Jun Fang Road, Huang Pu, Guangzhou, China
Уполномоченный представитель:
ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", 185027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., 11 лит. А
тел: (812) 622 10 15, факс: (812) 334 79 73
Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.
Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C
Регистрационное удостоверение XXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

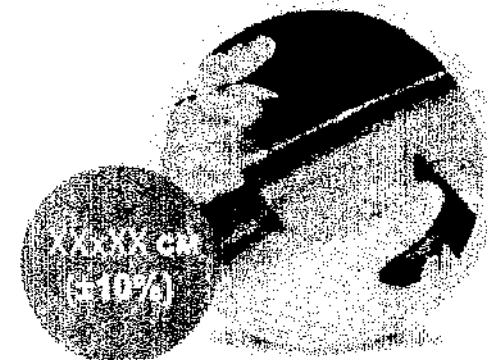

XX штук/упаковка



КРЮОФИН

Серия номер: XXXXXXXX
Произведено: XX/XXXX
Годен до: XX/XXXX



Применяется для лечения ожогов,
трофических и диабетических язв,
пролежней, осадков при трансплантации
кожи, для фиксации кожных
трансплантатов.
Нетекстиль, Стерильно.




КРУОФИН

Серия номер: XXXXXXXX

Произведено: XX/XXXX

Годен до: XX/XXXX



Применение: для закрытия поверхности трофических и диабетических язв, пролежней, ран при трансплантации кожи, для фиксации кожных трансплантатов.

Нетоксично. Стерильно.

Пластырь медицинский фиксирующий Круофин

Стерильная мазевая повязка
из крупноячеистой хлопковой ткани

КРУОФИН

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда"

196027, Россия, Санкт-Петербург.

www.mediatek.ru


XXXXXX

XX штук/упаковка

Состав: основа — 100% обезжиренная хлопковая ткань,
мазевая масса на основе парафина.

Способ наложения - вскрыть, достать, наложить,
менять по рекомендации врача или по мере необходимости.



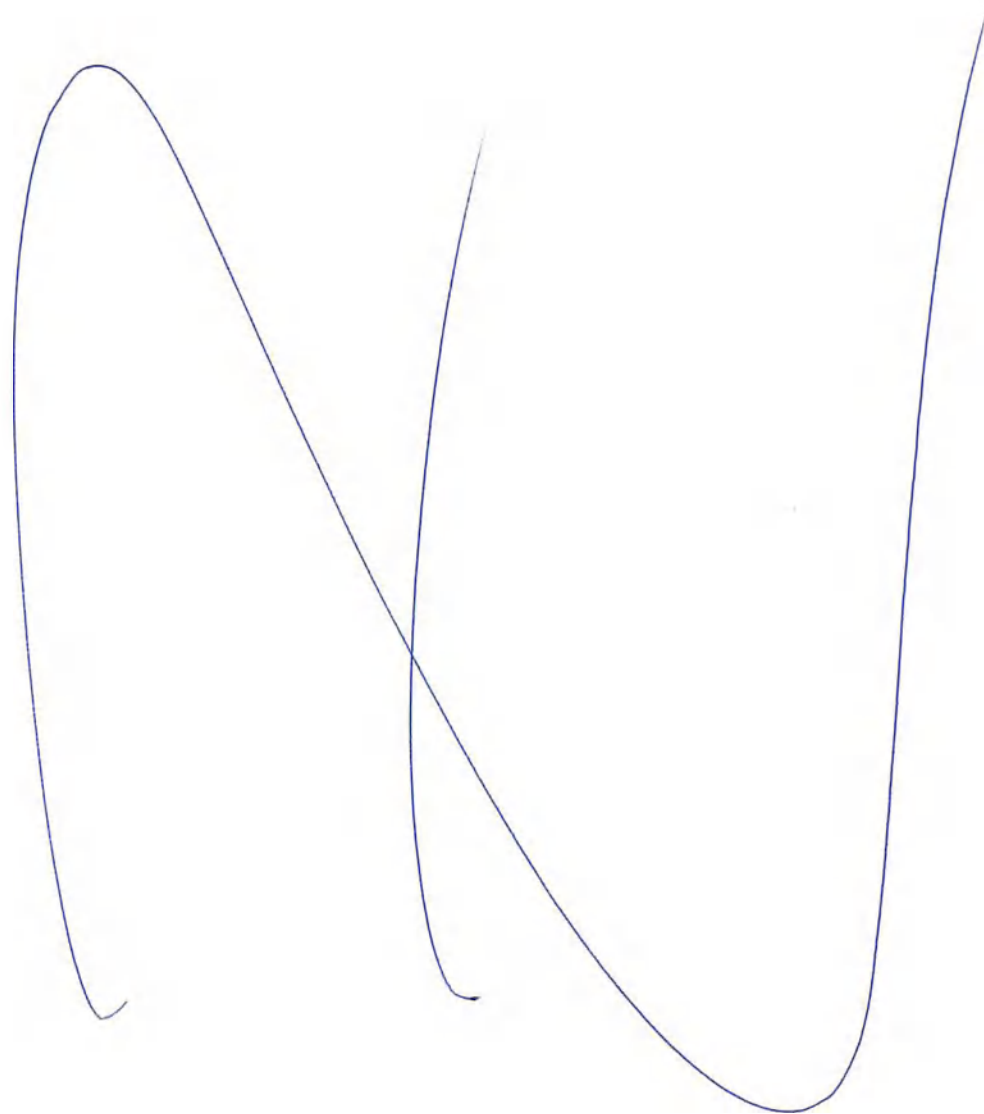

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью:

Всего 75 листов



Общество с ограниченной ответственностью
«МЕДИТЕК «Здоровье Труда»

Крутицкий Д. В.

года