



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ”
 серия 3

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “30” 06/2021 г.

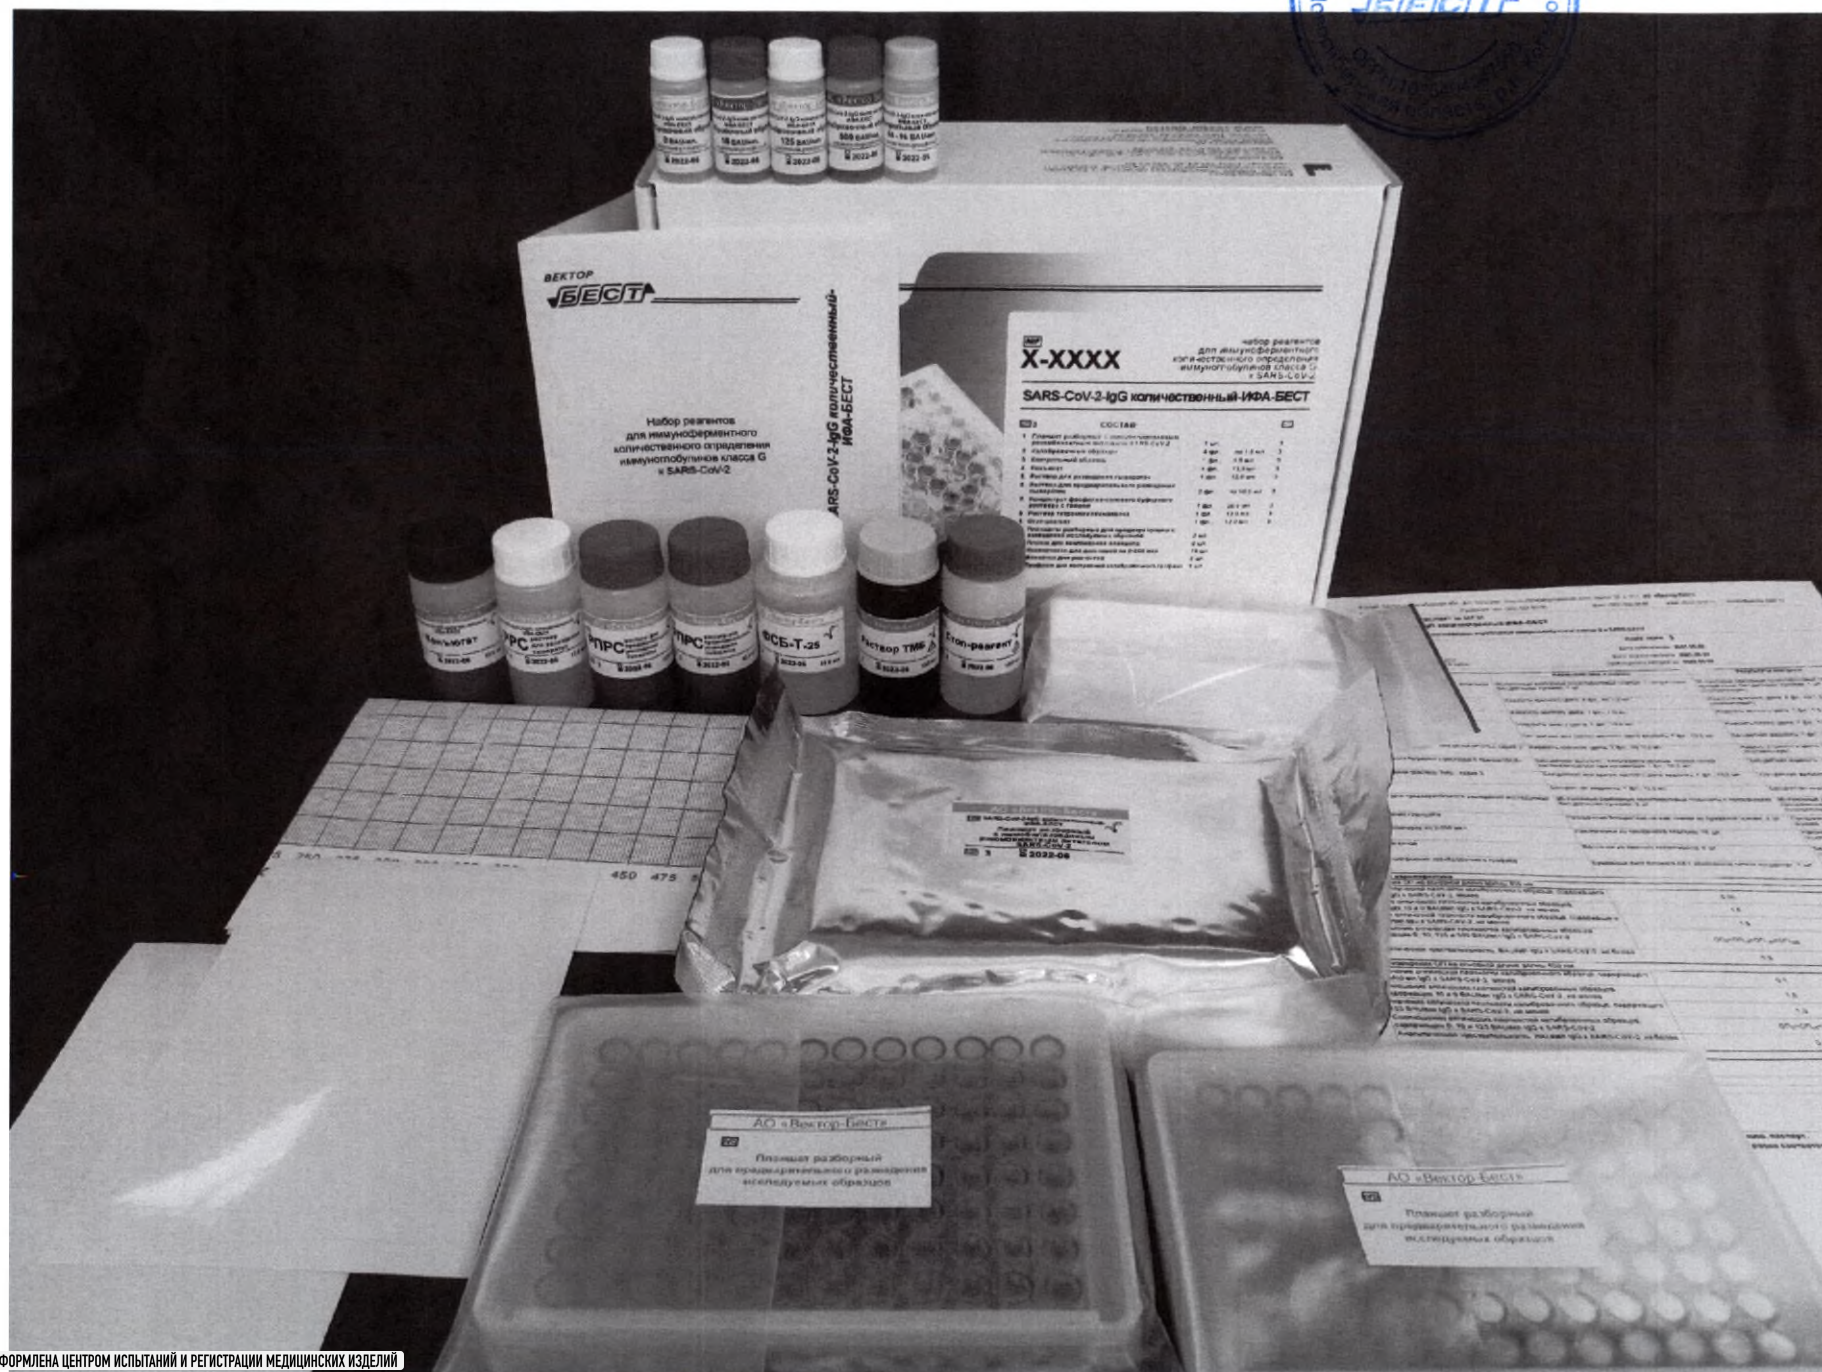

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 1
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“30” 06 2021 г.

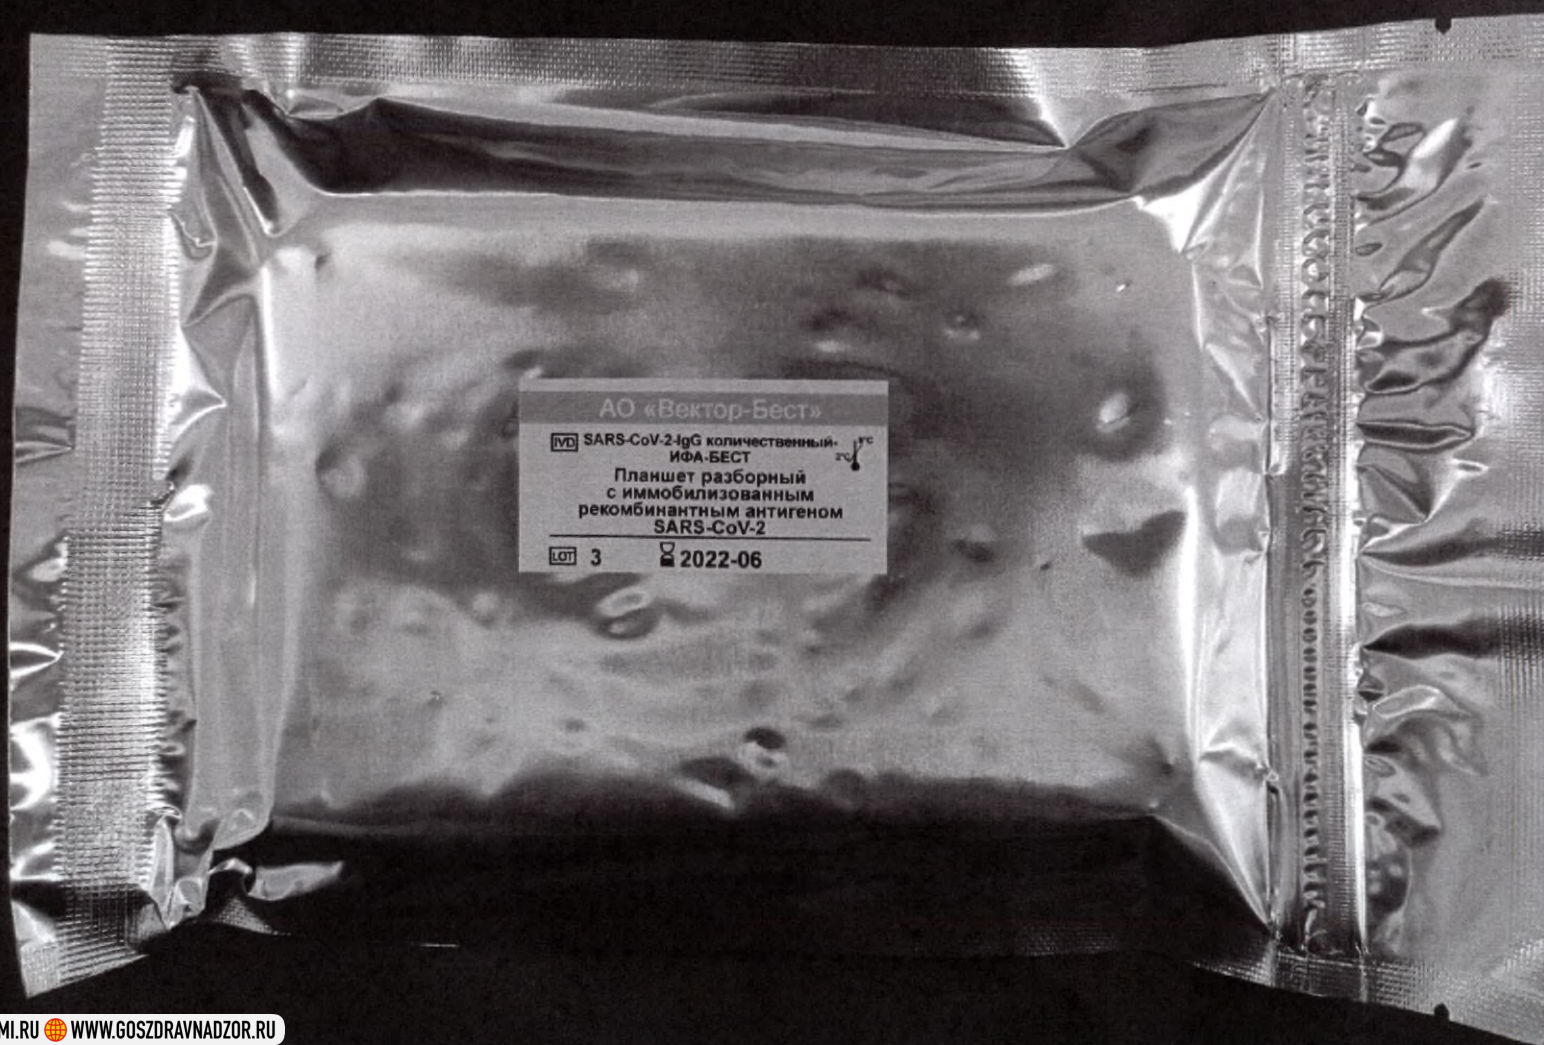

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 2
серия 3


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов
2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 3
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"30" 06/ 2021 г.

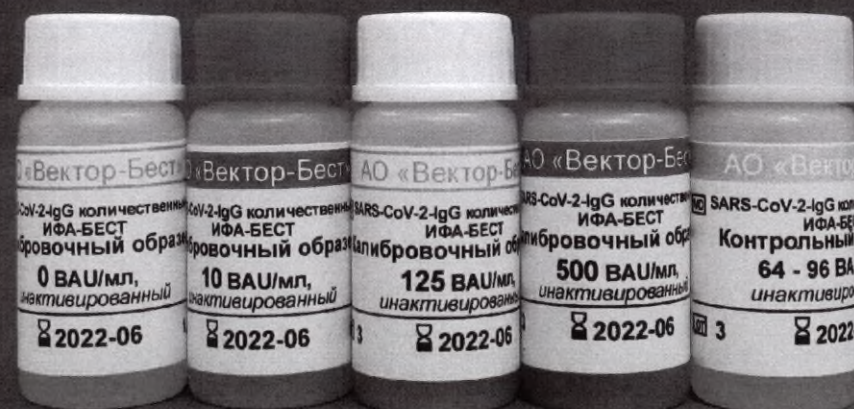


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 4
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“30” 09 2021 г.

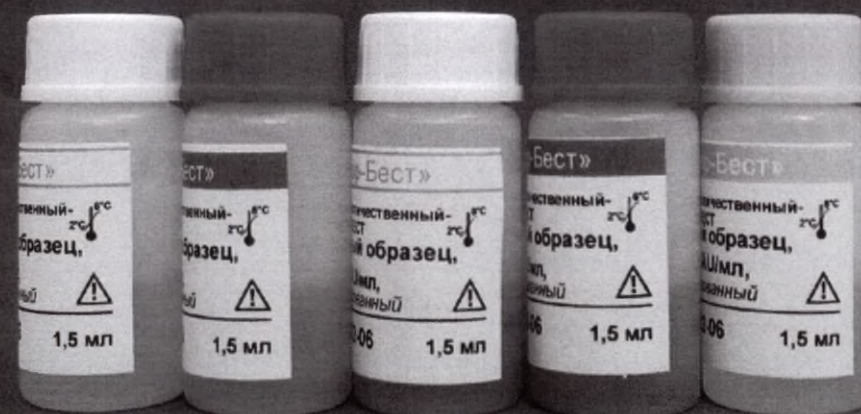



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 5
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусанов
"30" 06/ 2021 г.

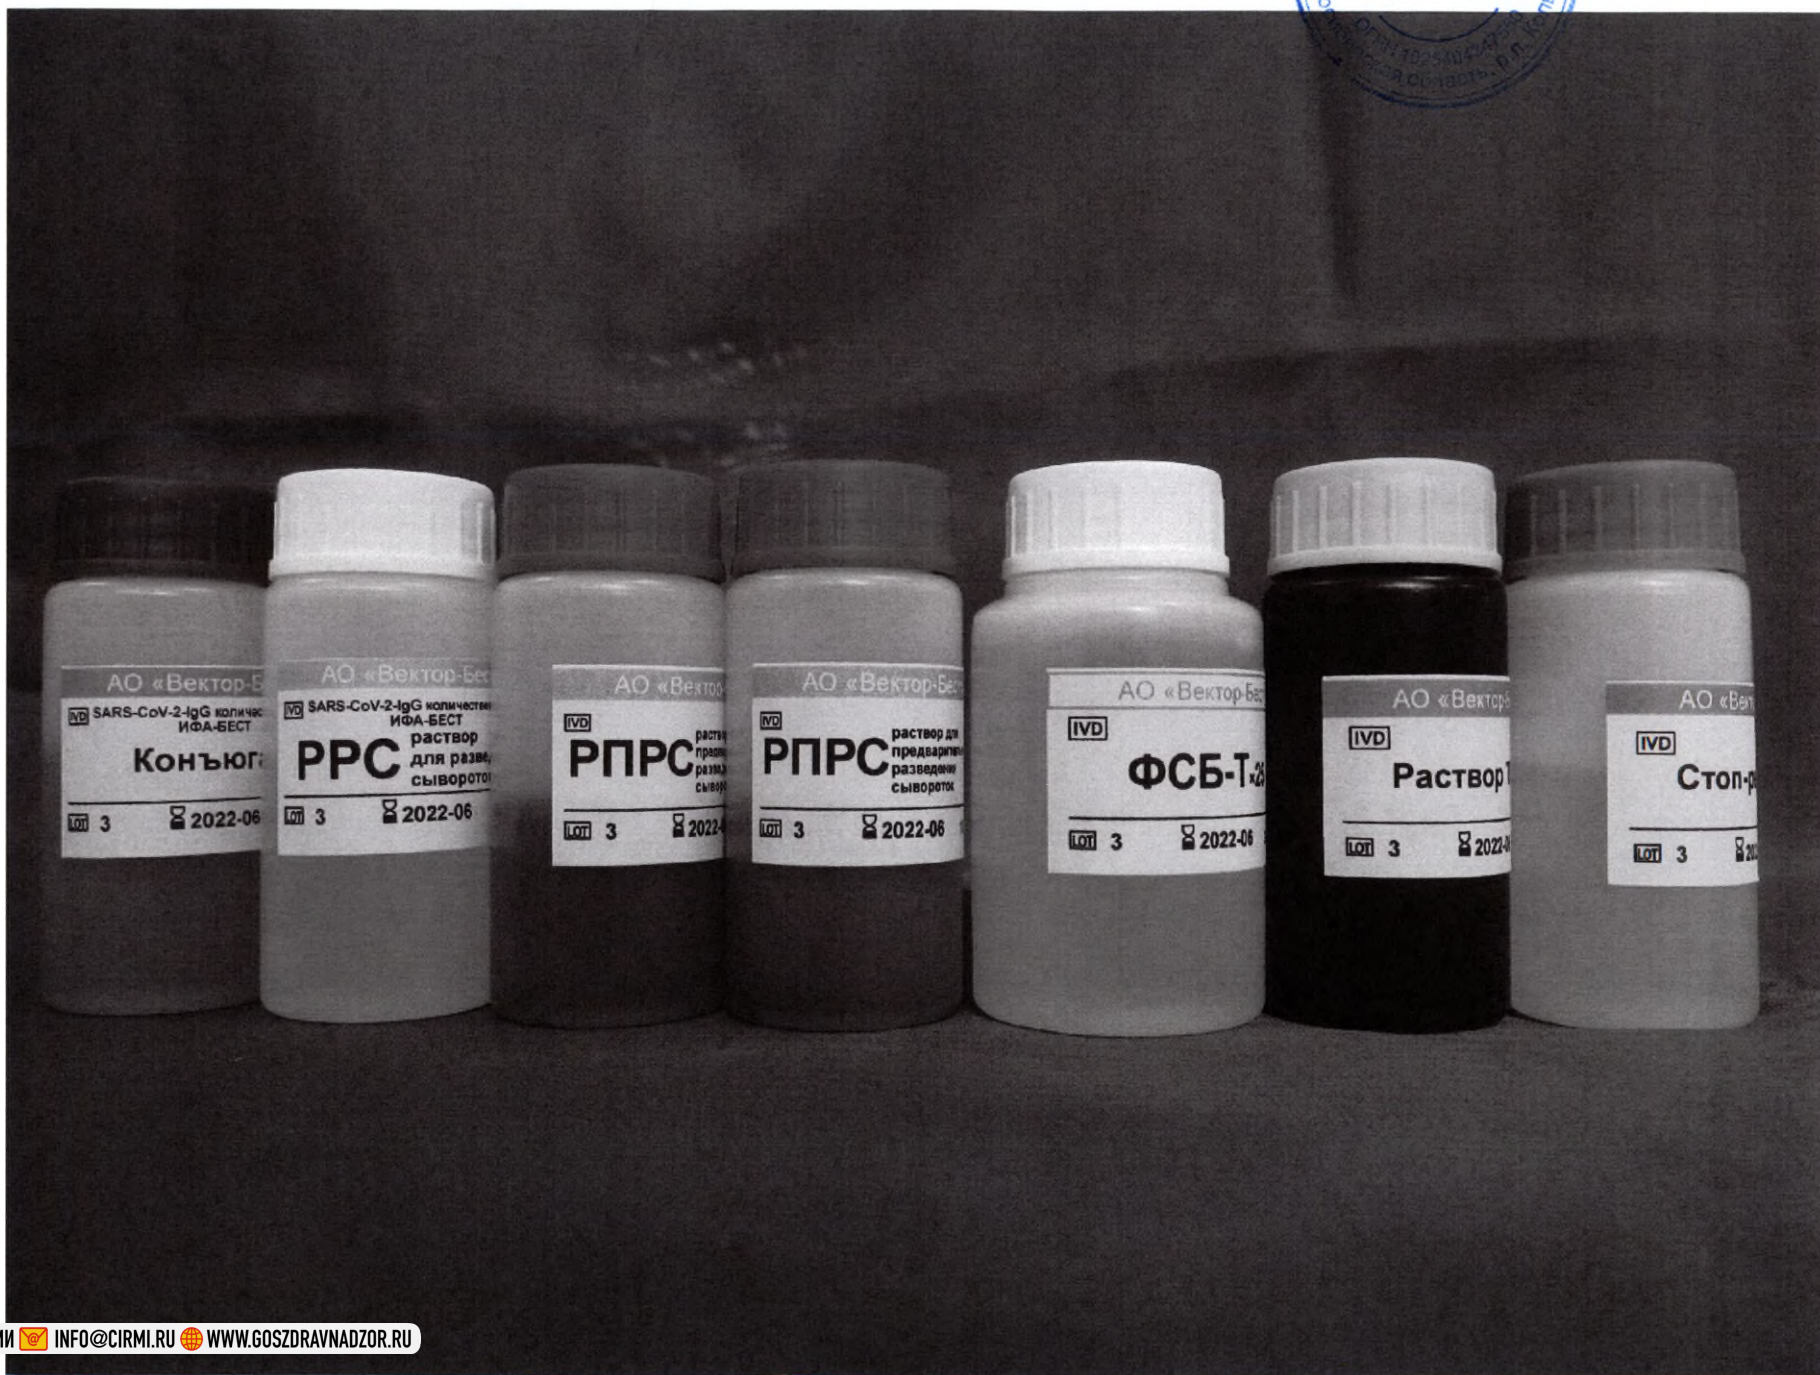


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 6
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»  М.Д. Хусаинов
“30” 06/2021 г.
М.П. 

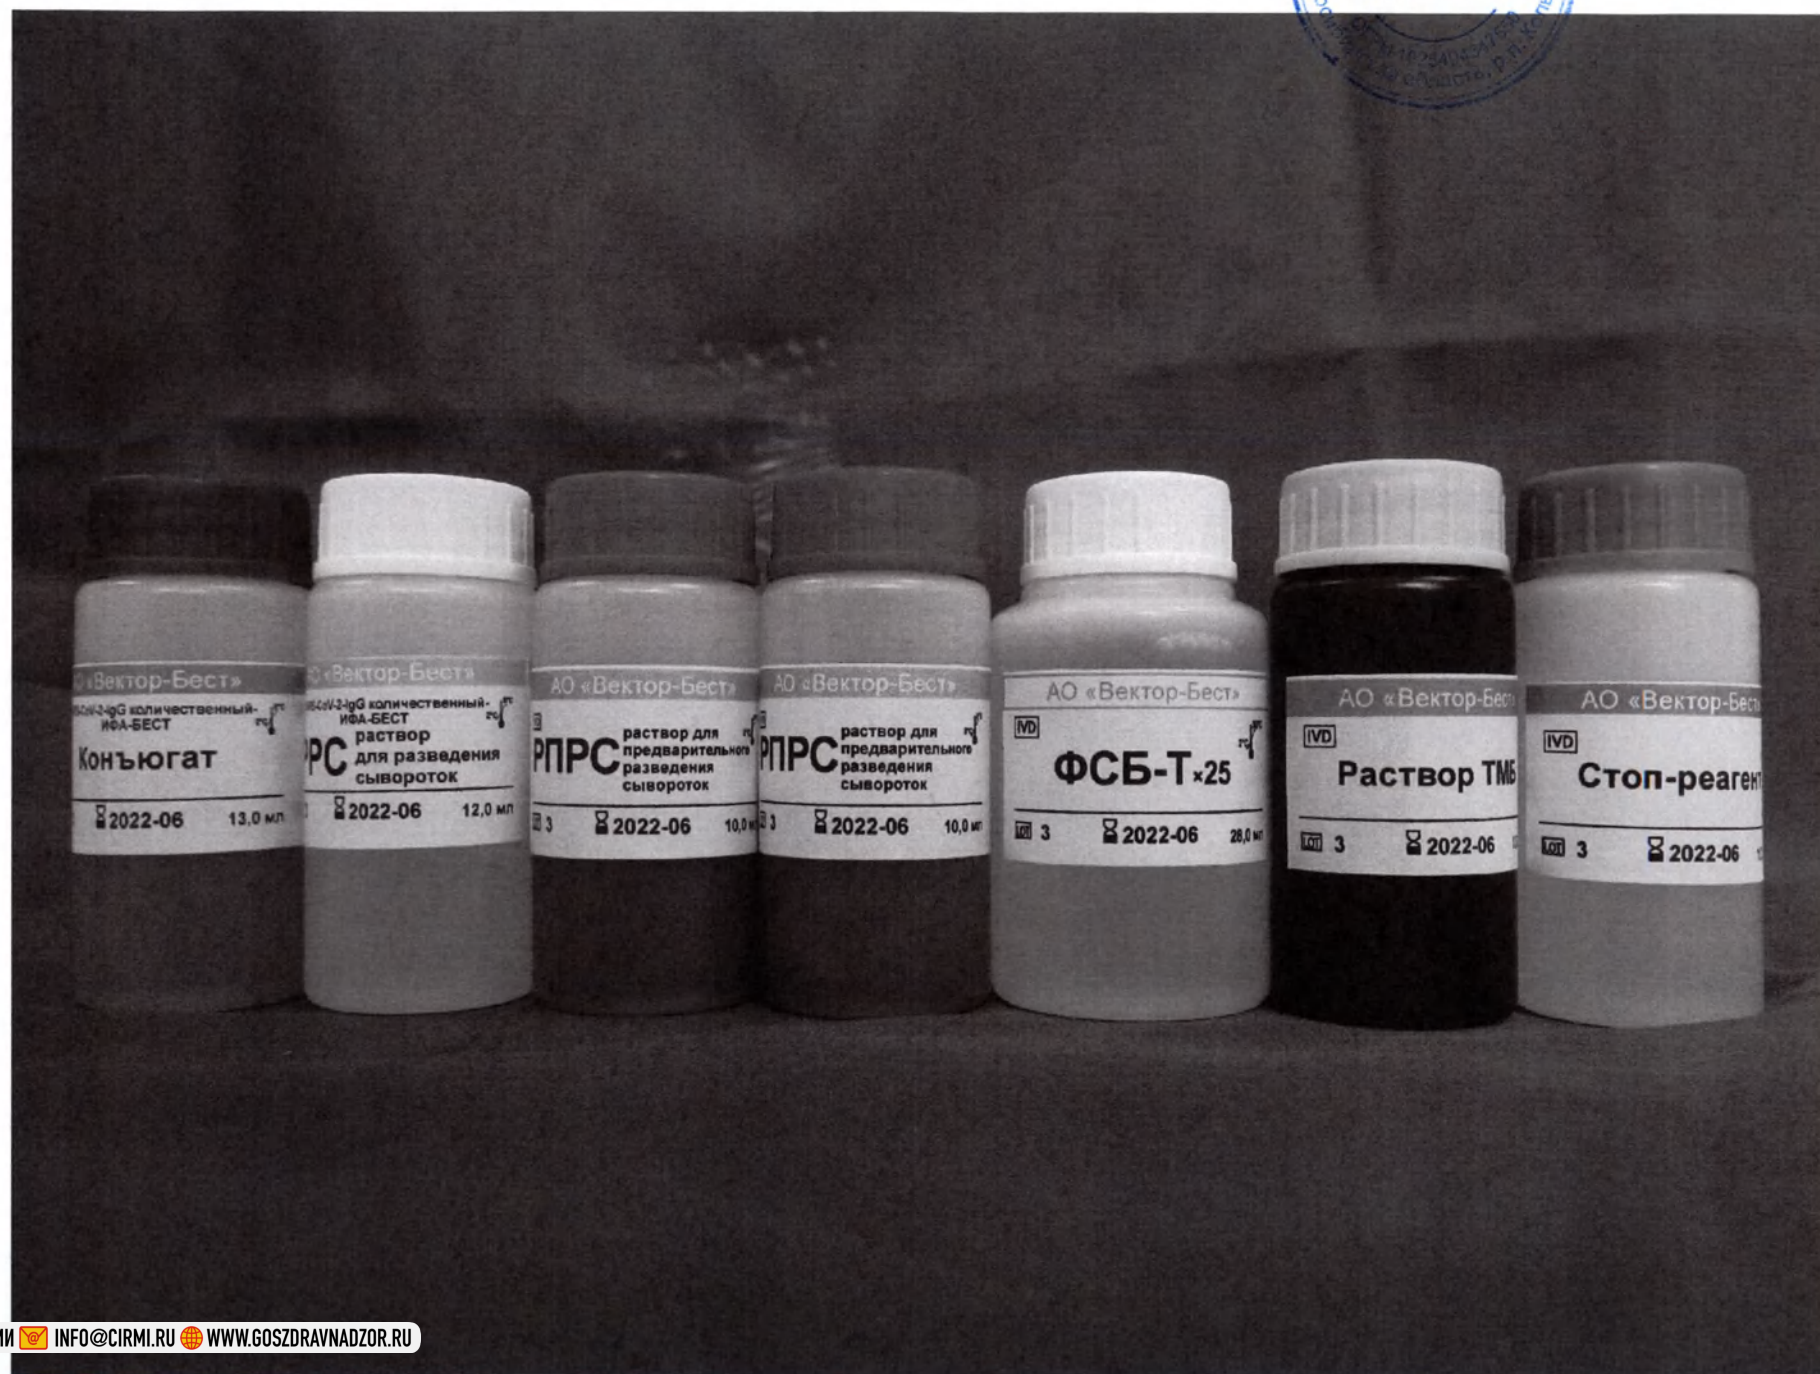


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 7
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“30” 2021 г.

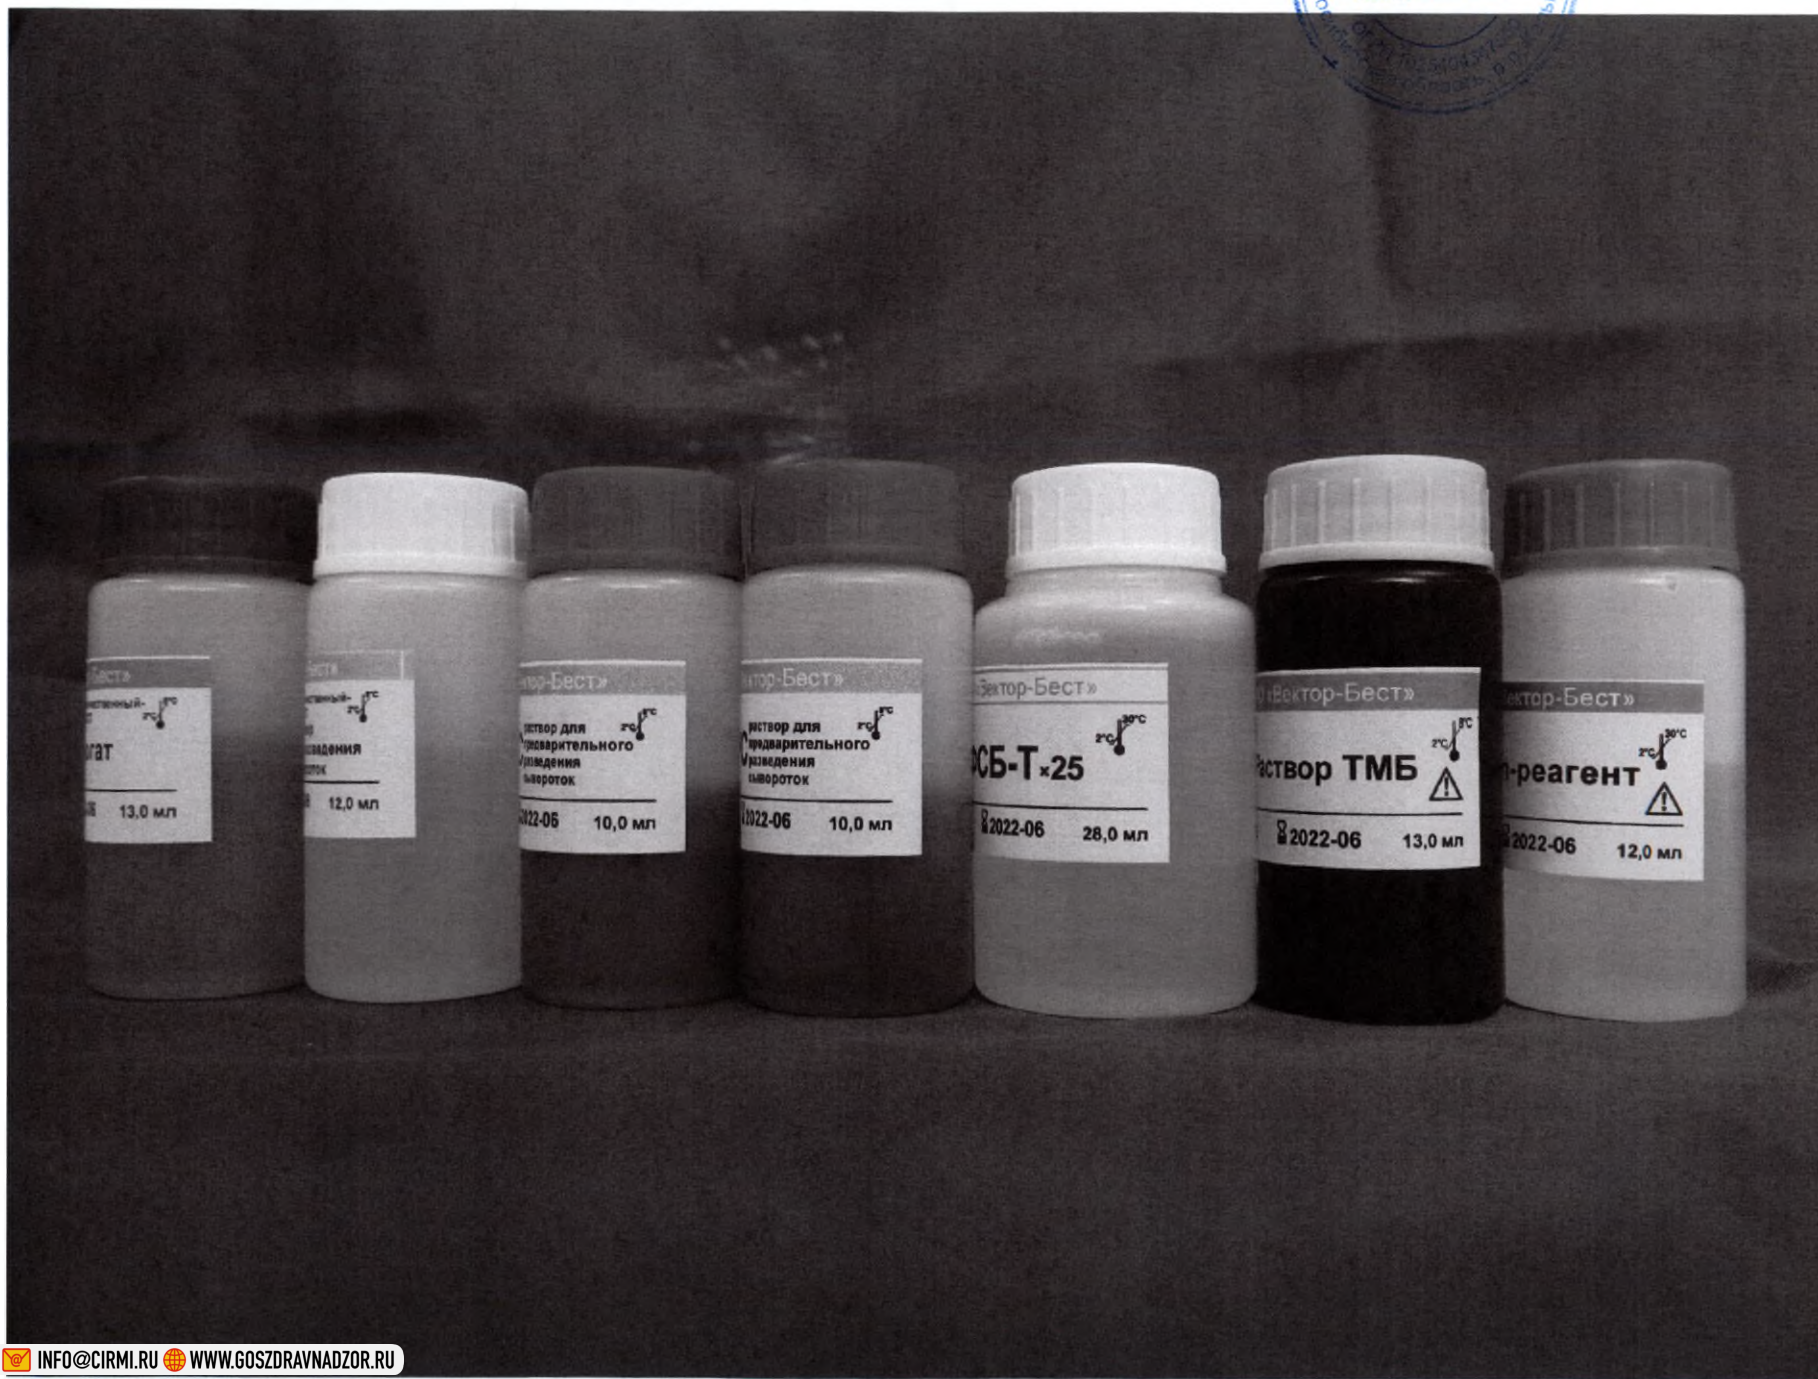

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 8
серия 3


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.

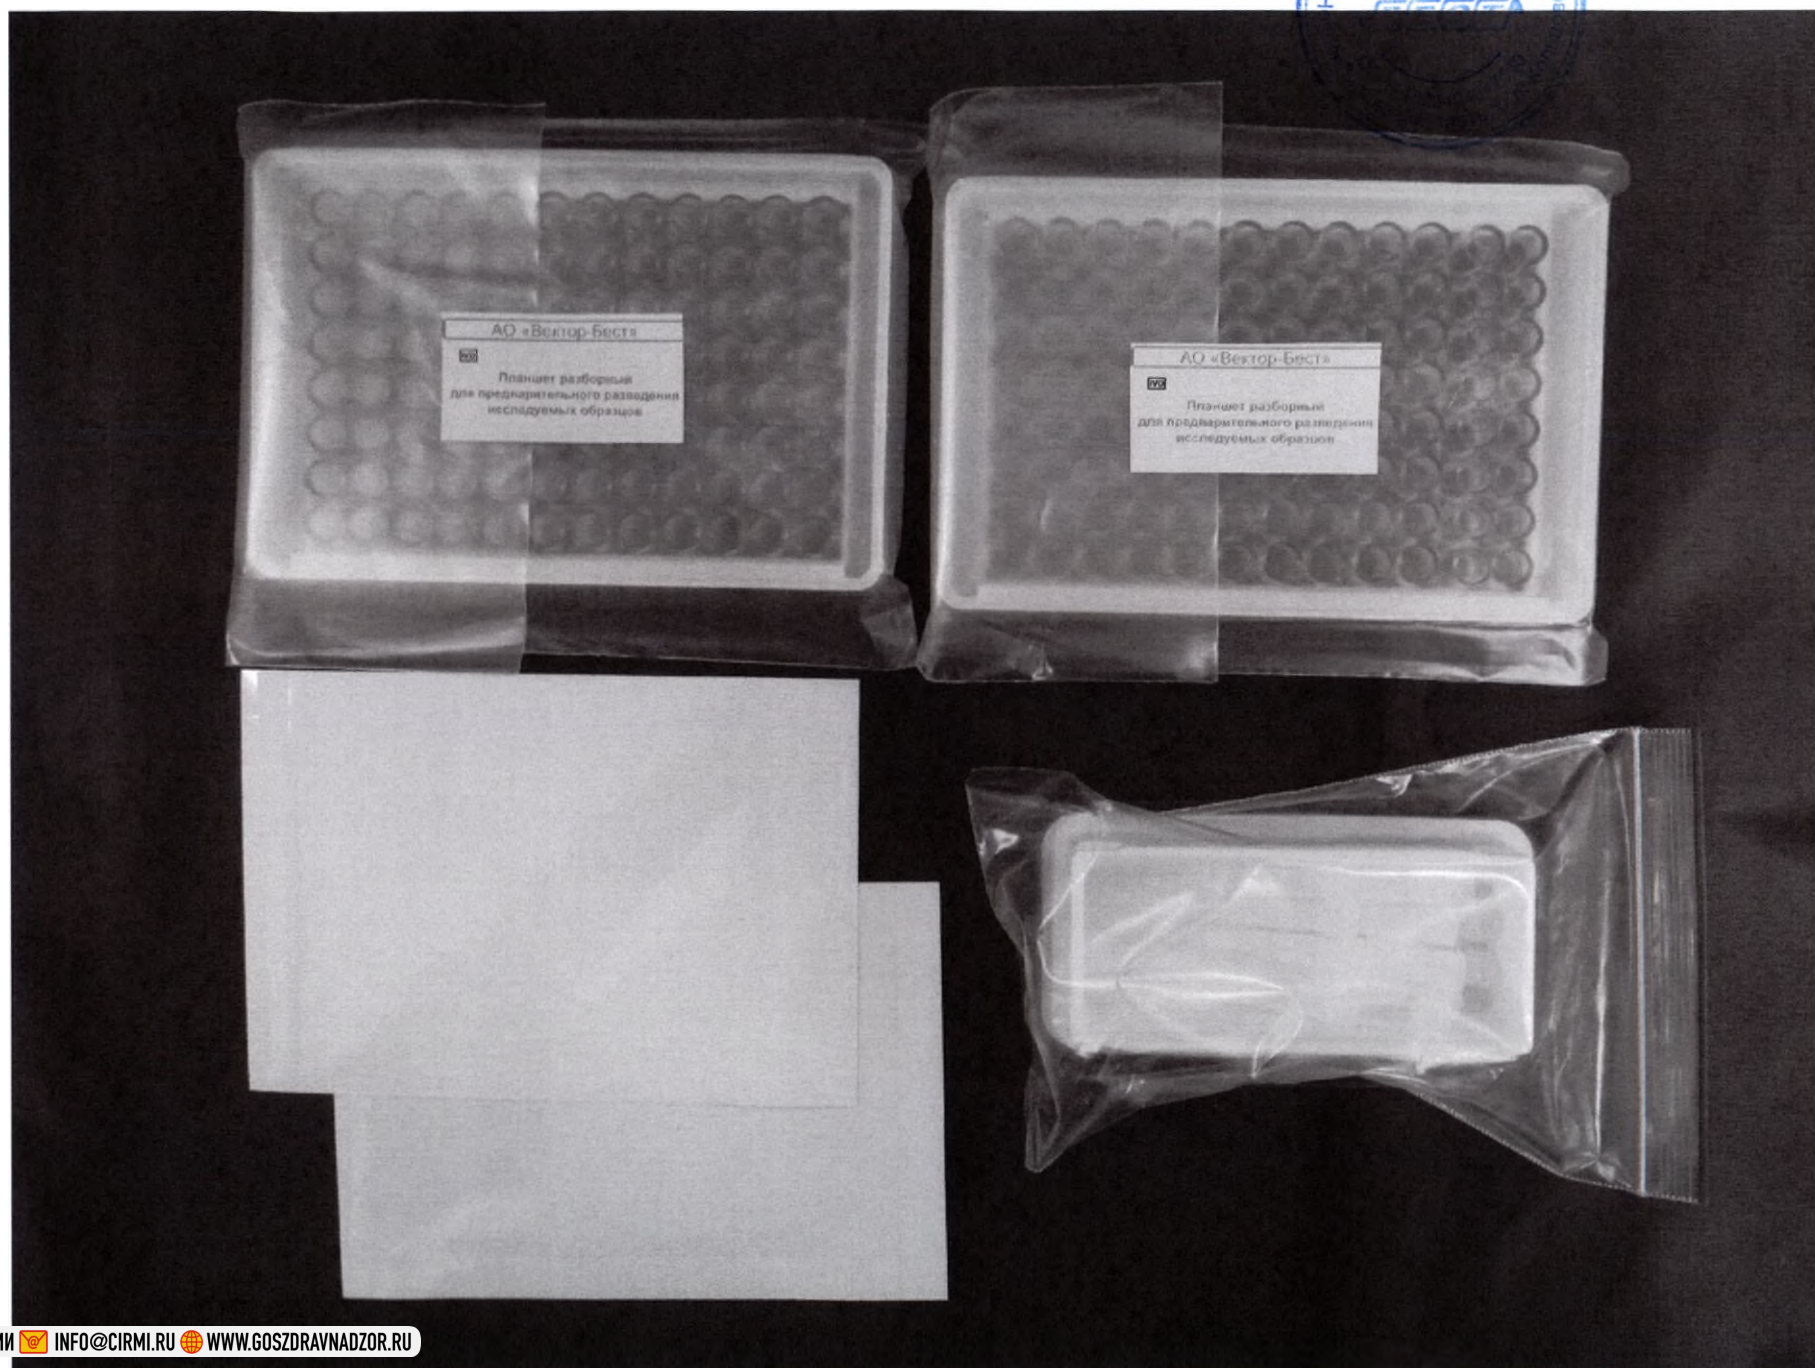



ВЕКТОР

БЕСТ

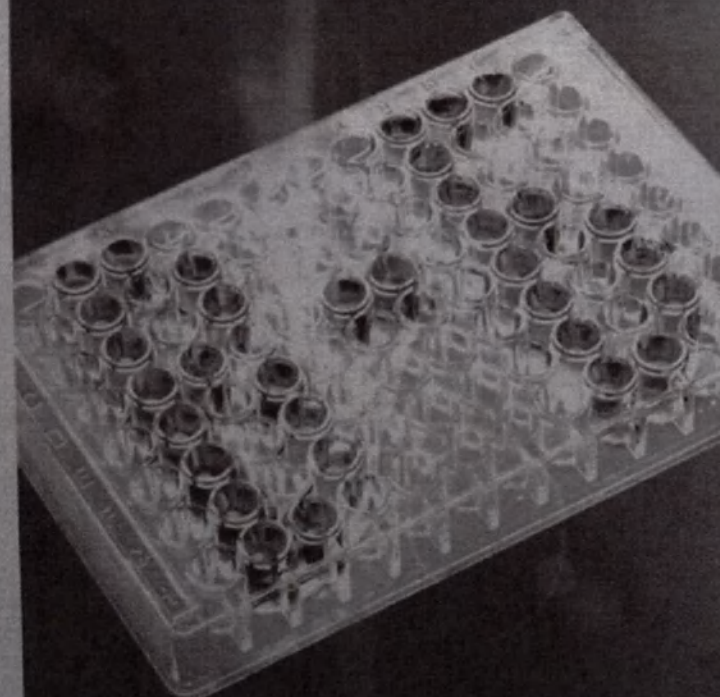

REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного
количественного определения
иммуноглобулинов класса G
к SARS-CoV-2

SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ

ЛОТ 3


СОСТАВ:

ЛОТ


1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2	1 шт.		3
2. Калибровочные образцы	4 фл.	по 1,5 мл	3
3. Контрольный образец	1 фл.	1,5 мл	3
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл	3
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	3
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	2 фл.	по 10,0 мл	3
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.	28,0 мл	3
8. Раствор тетраметилбензида	1 фл.	13,0 мл	3
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	3
10. Планшеты разборные для предварительного разведения исследуемых образцов	2 шт.		
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.		
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.		
13. Ванночки для реагентов	2 шт.		
14. Трафарет для построения калибровочного графика	1 шт.		

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 2
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"30" 2021 г.
М.П.

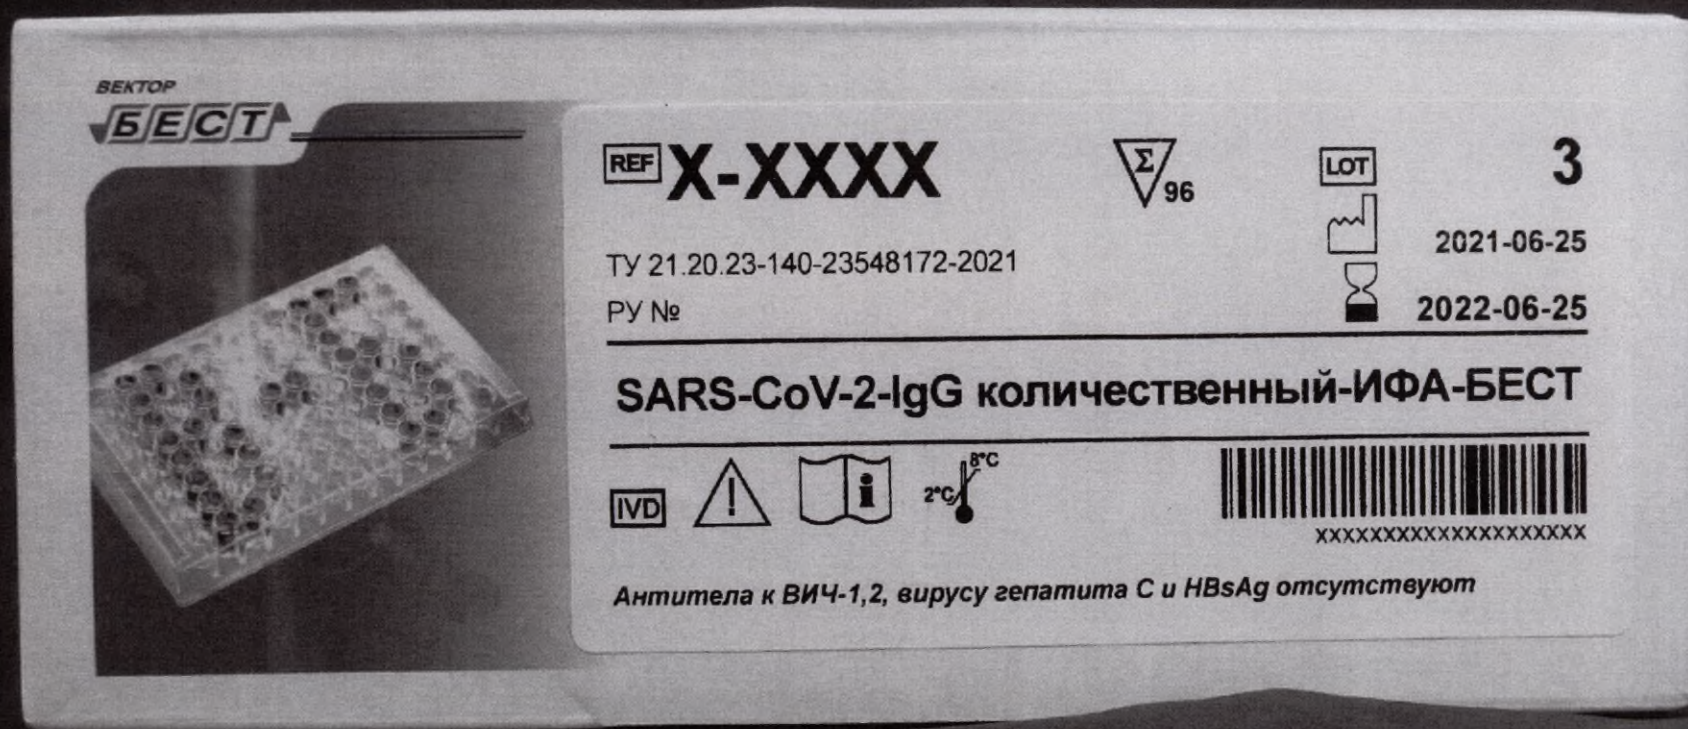

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 3
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»  М.Д. Хусаинов
М.П.  "30" 06/ 2021 г.




АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ”
 серия 4

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “30” 2021 г.
 М.П. **БЕСТ**

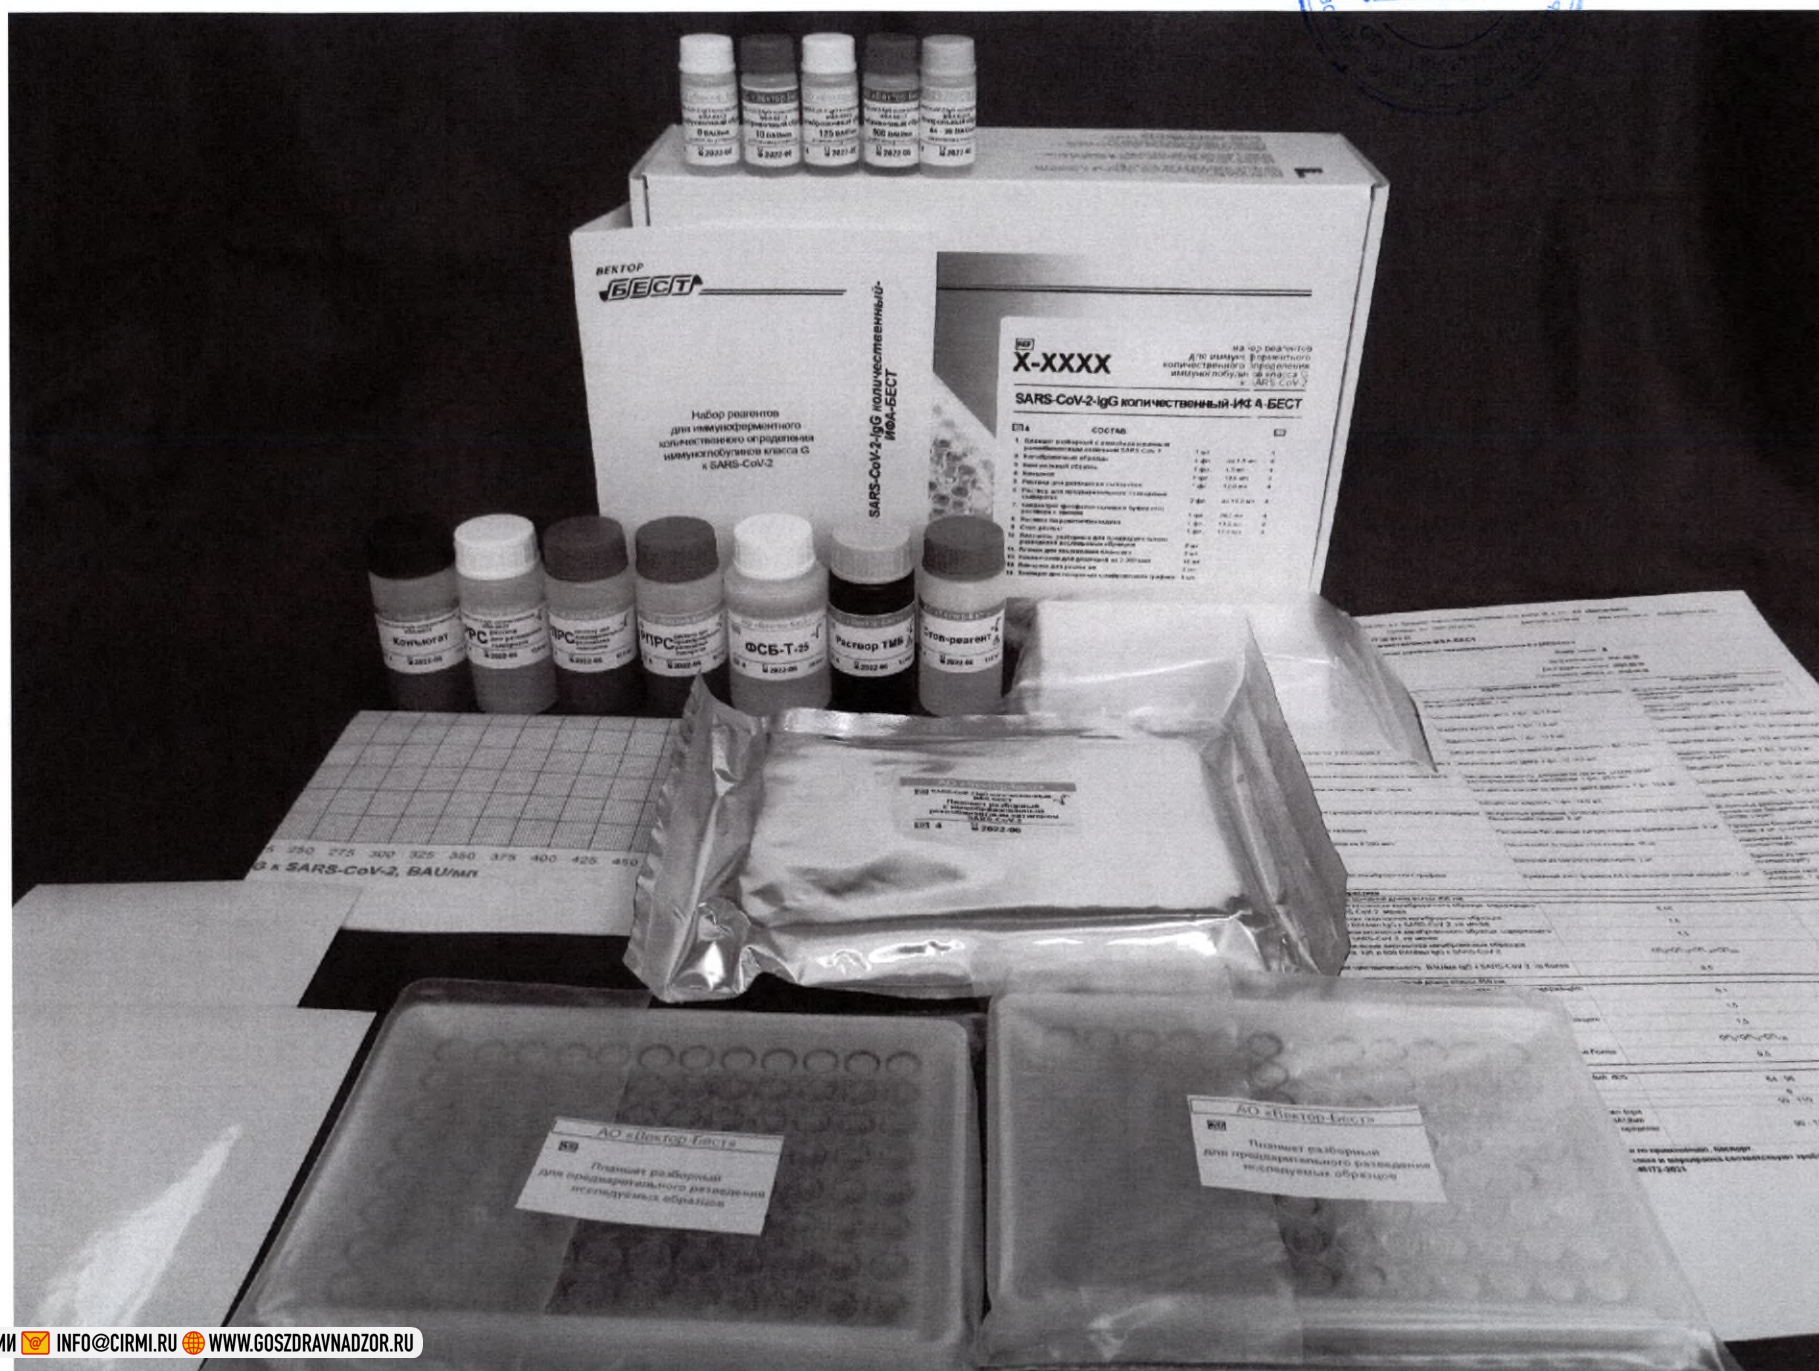

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 1
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"20" 06/ 2021 г.

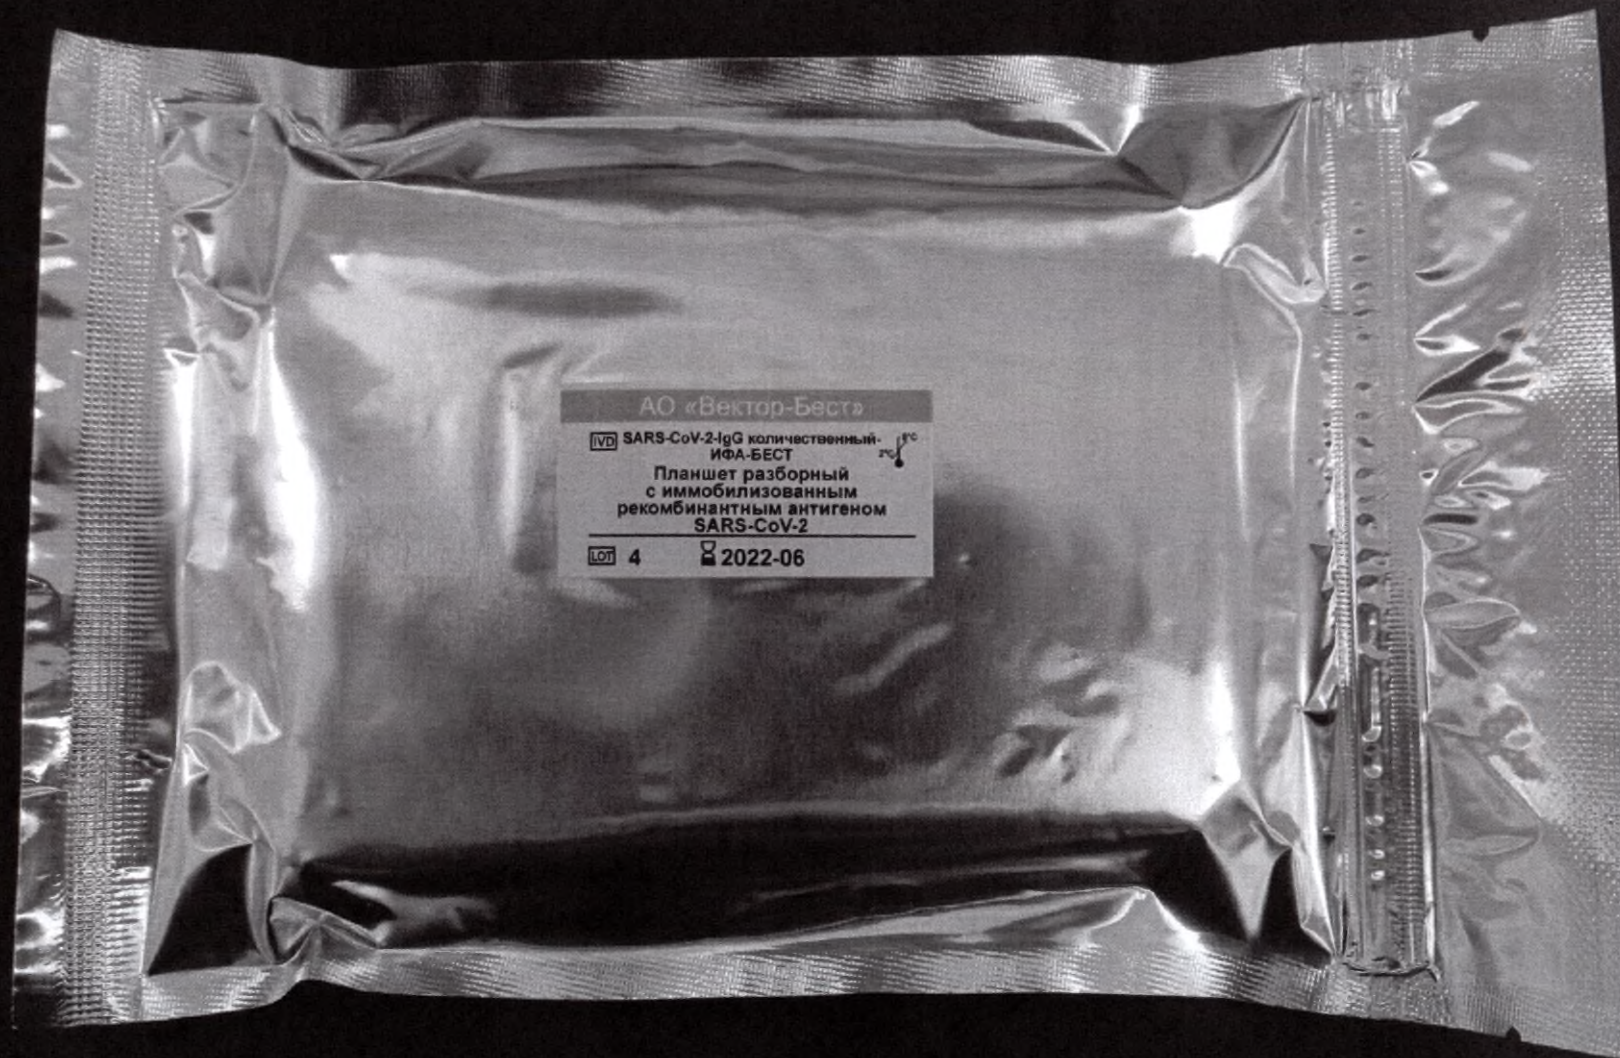

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 2
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"30" 08 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 3
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусанов
2021 г.





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 4
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“20” _____ 2021 г.
М.П. _____

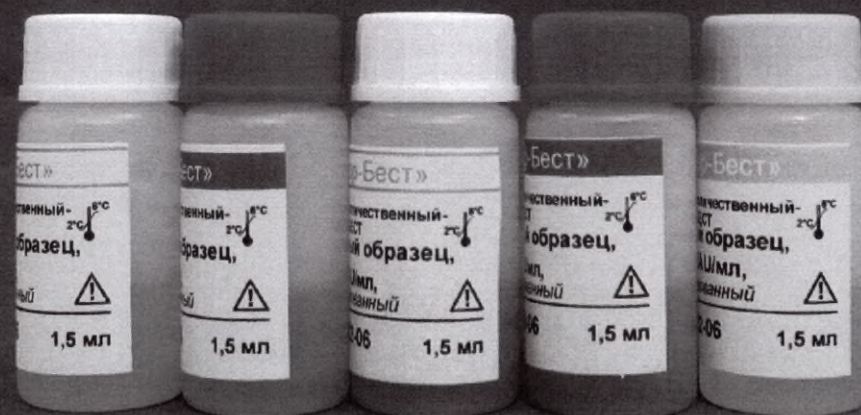


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 5
серия 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»  М.Д. Хусаинов
“30” 06 2021 г.

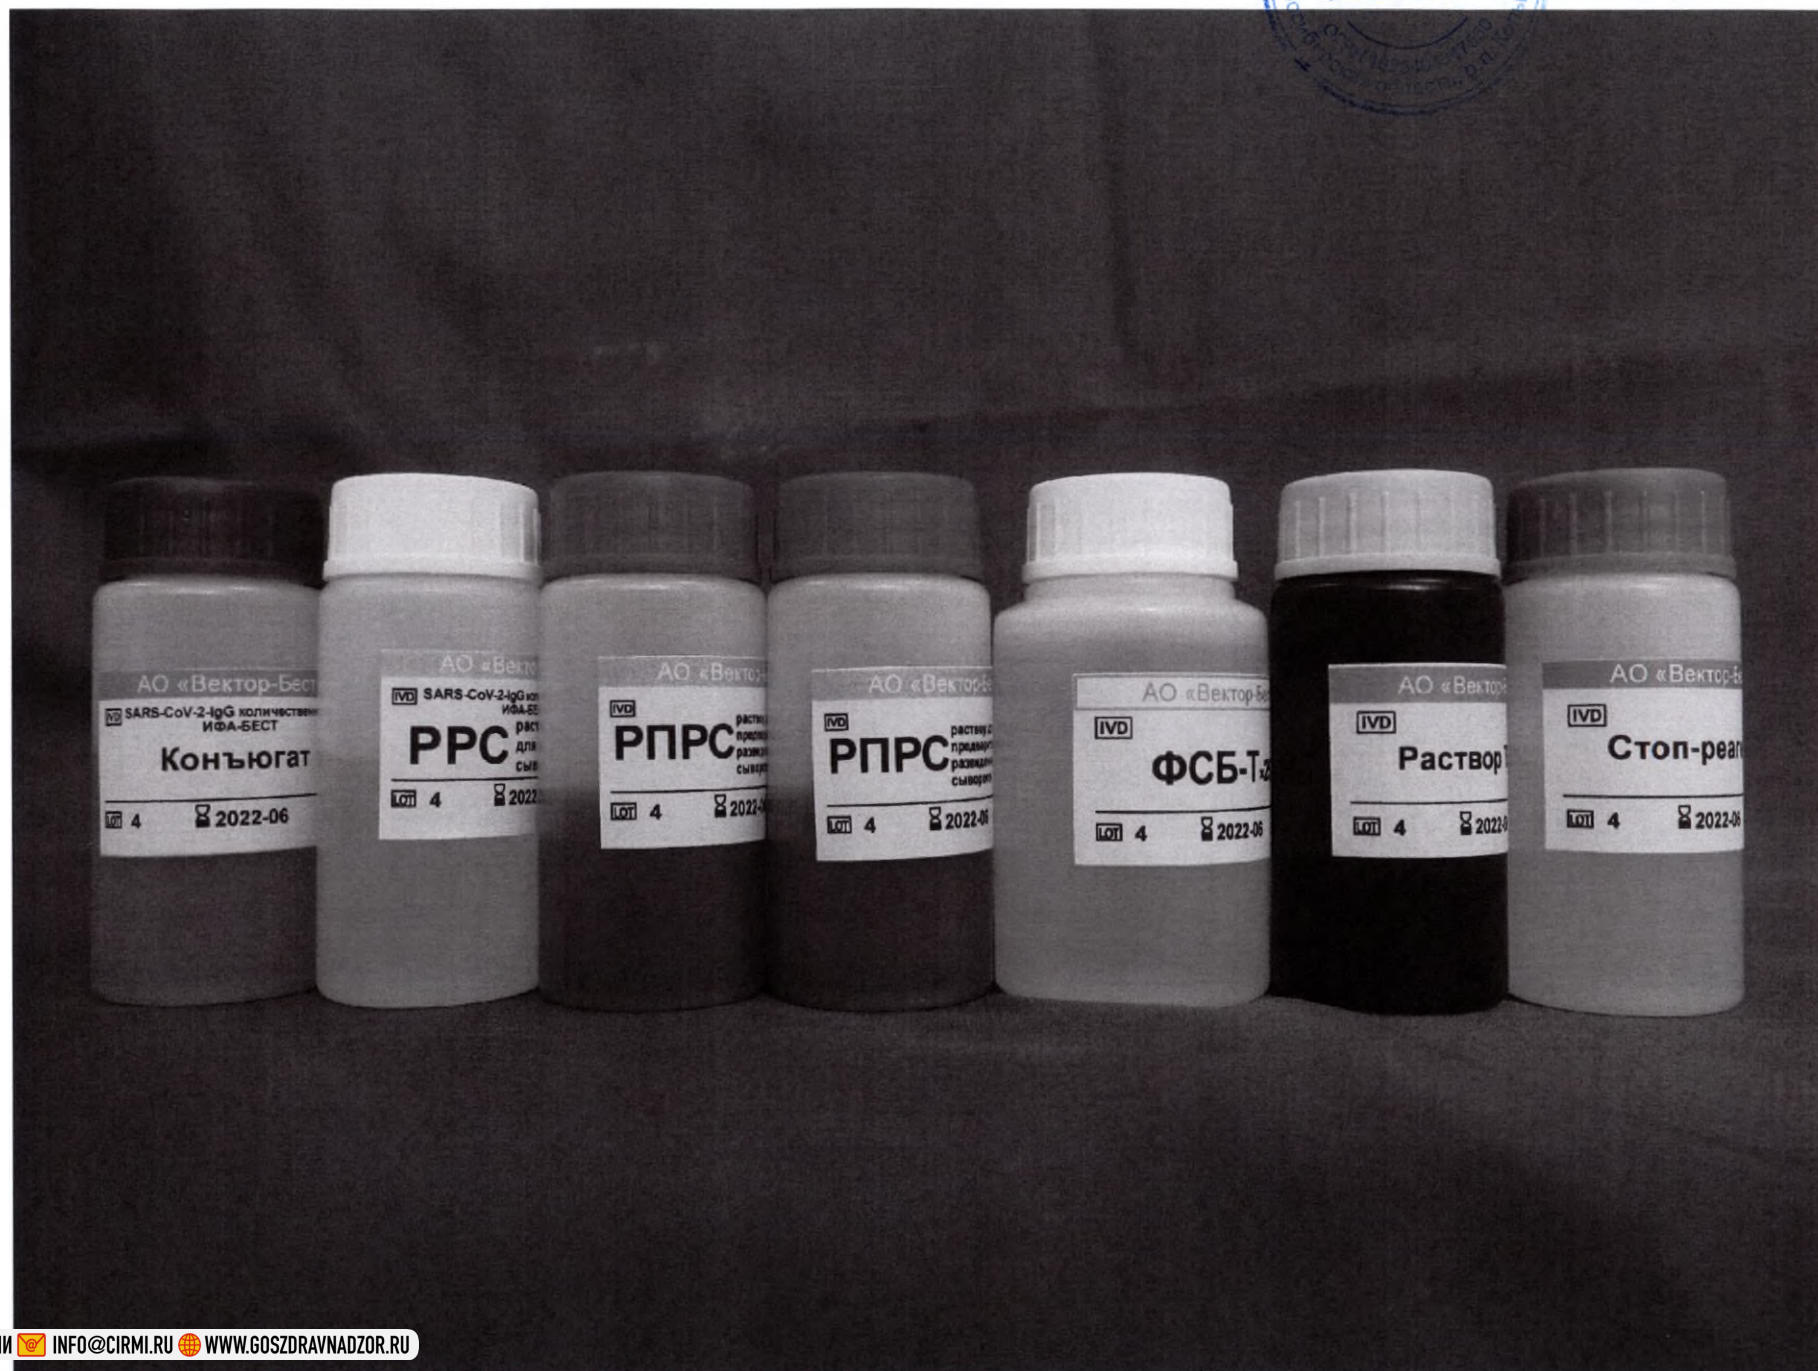


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 6
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“30” 06/ 2021 г.
М.П. 

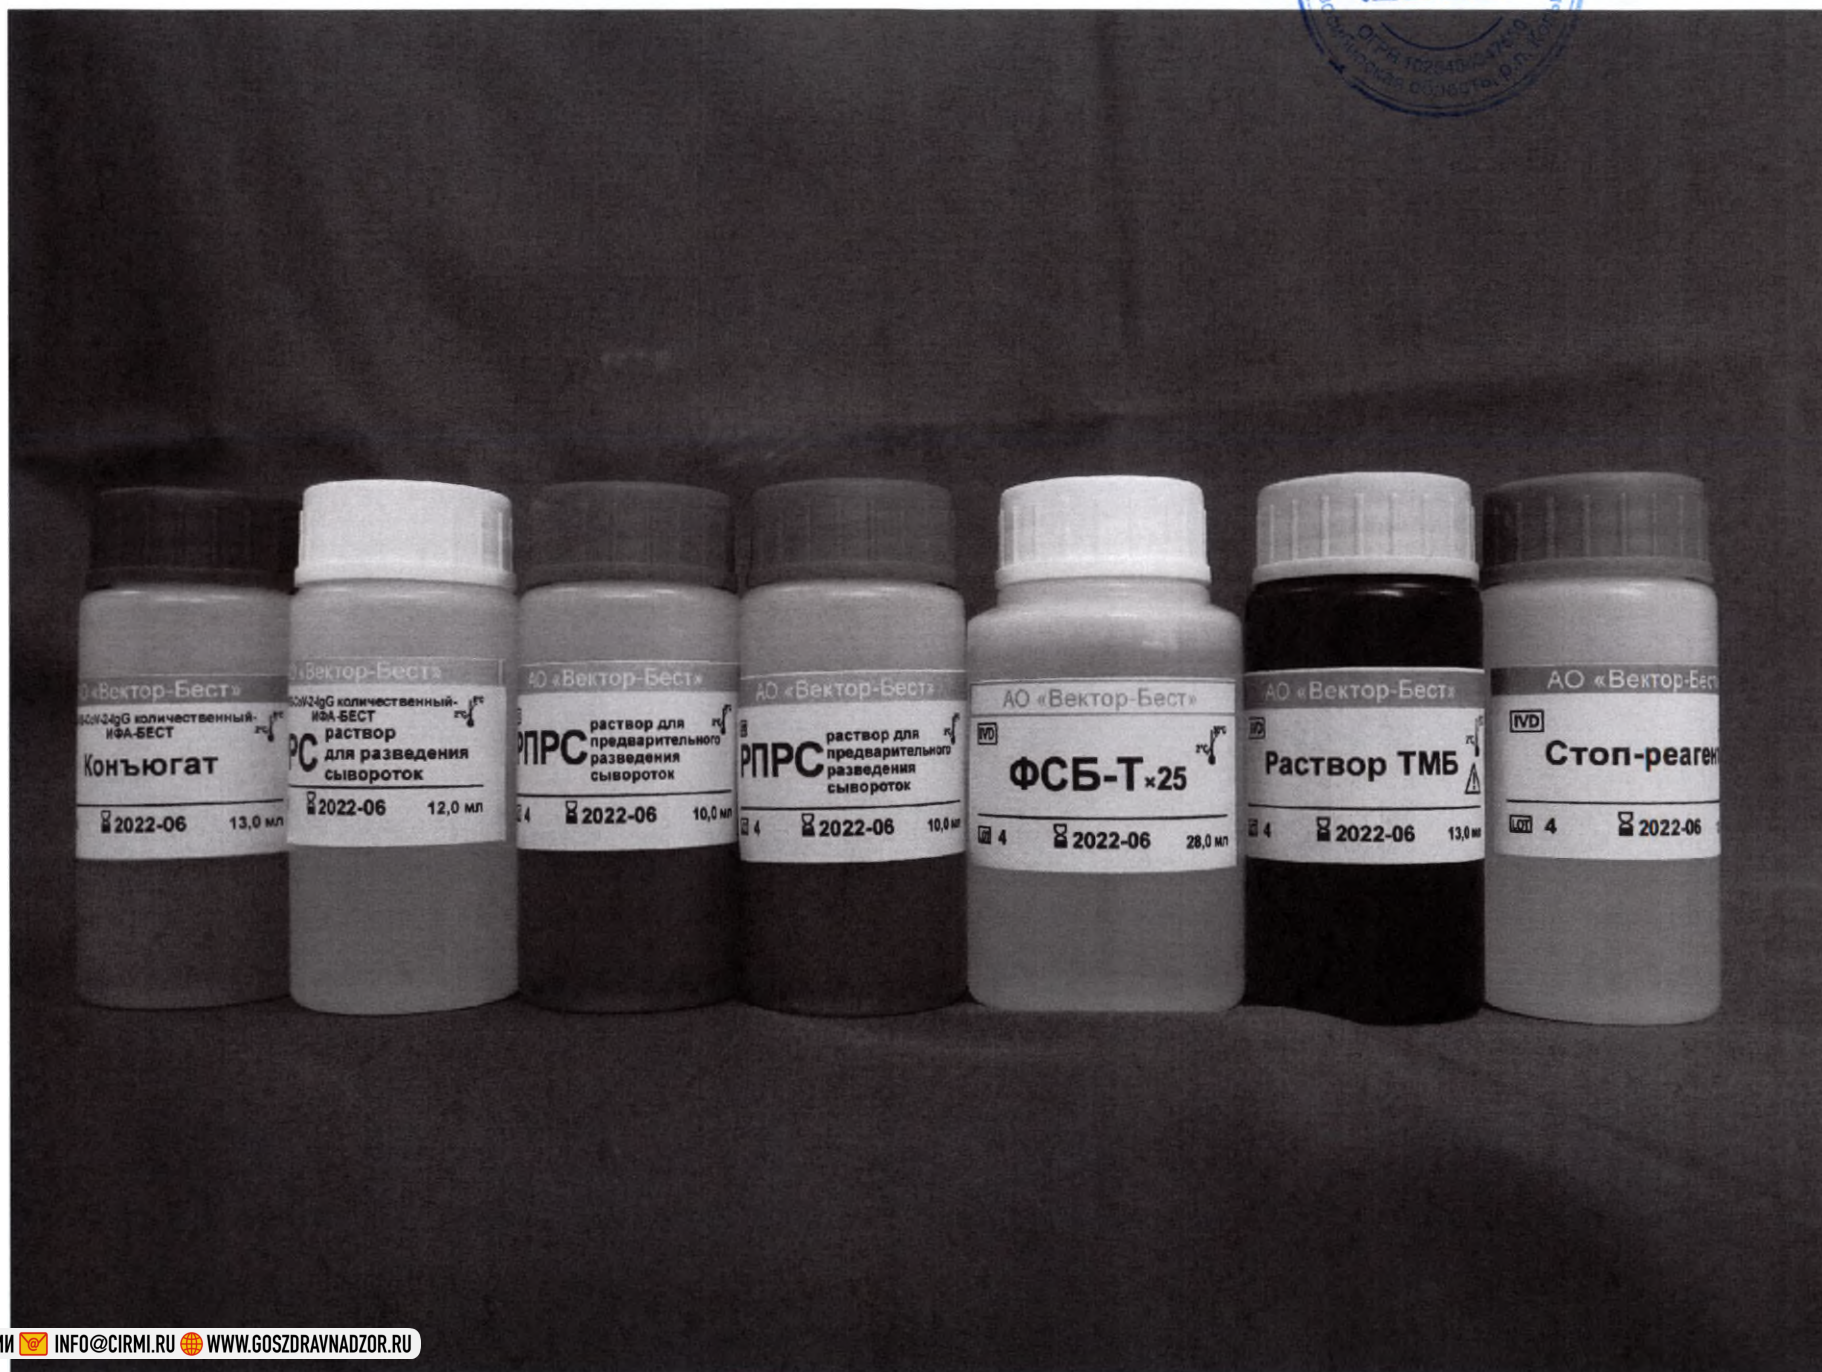


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 7
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“30” _____ 2021 г.

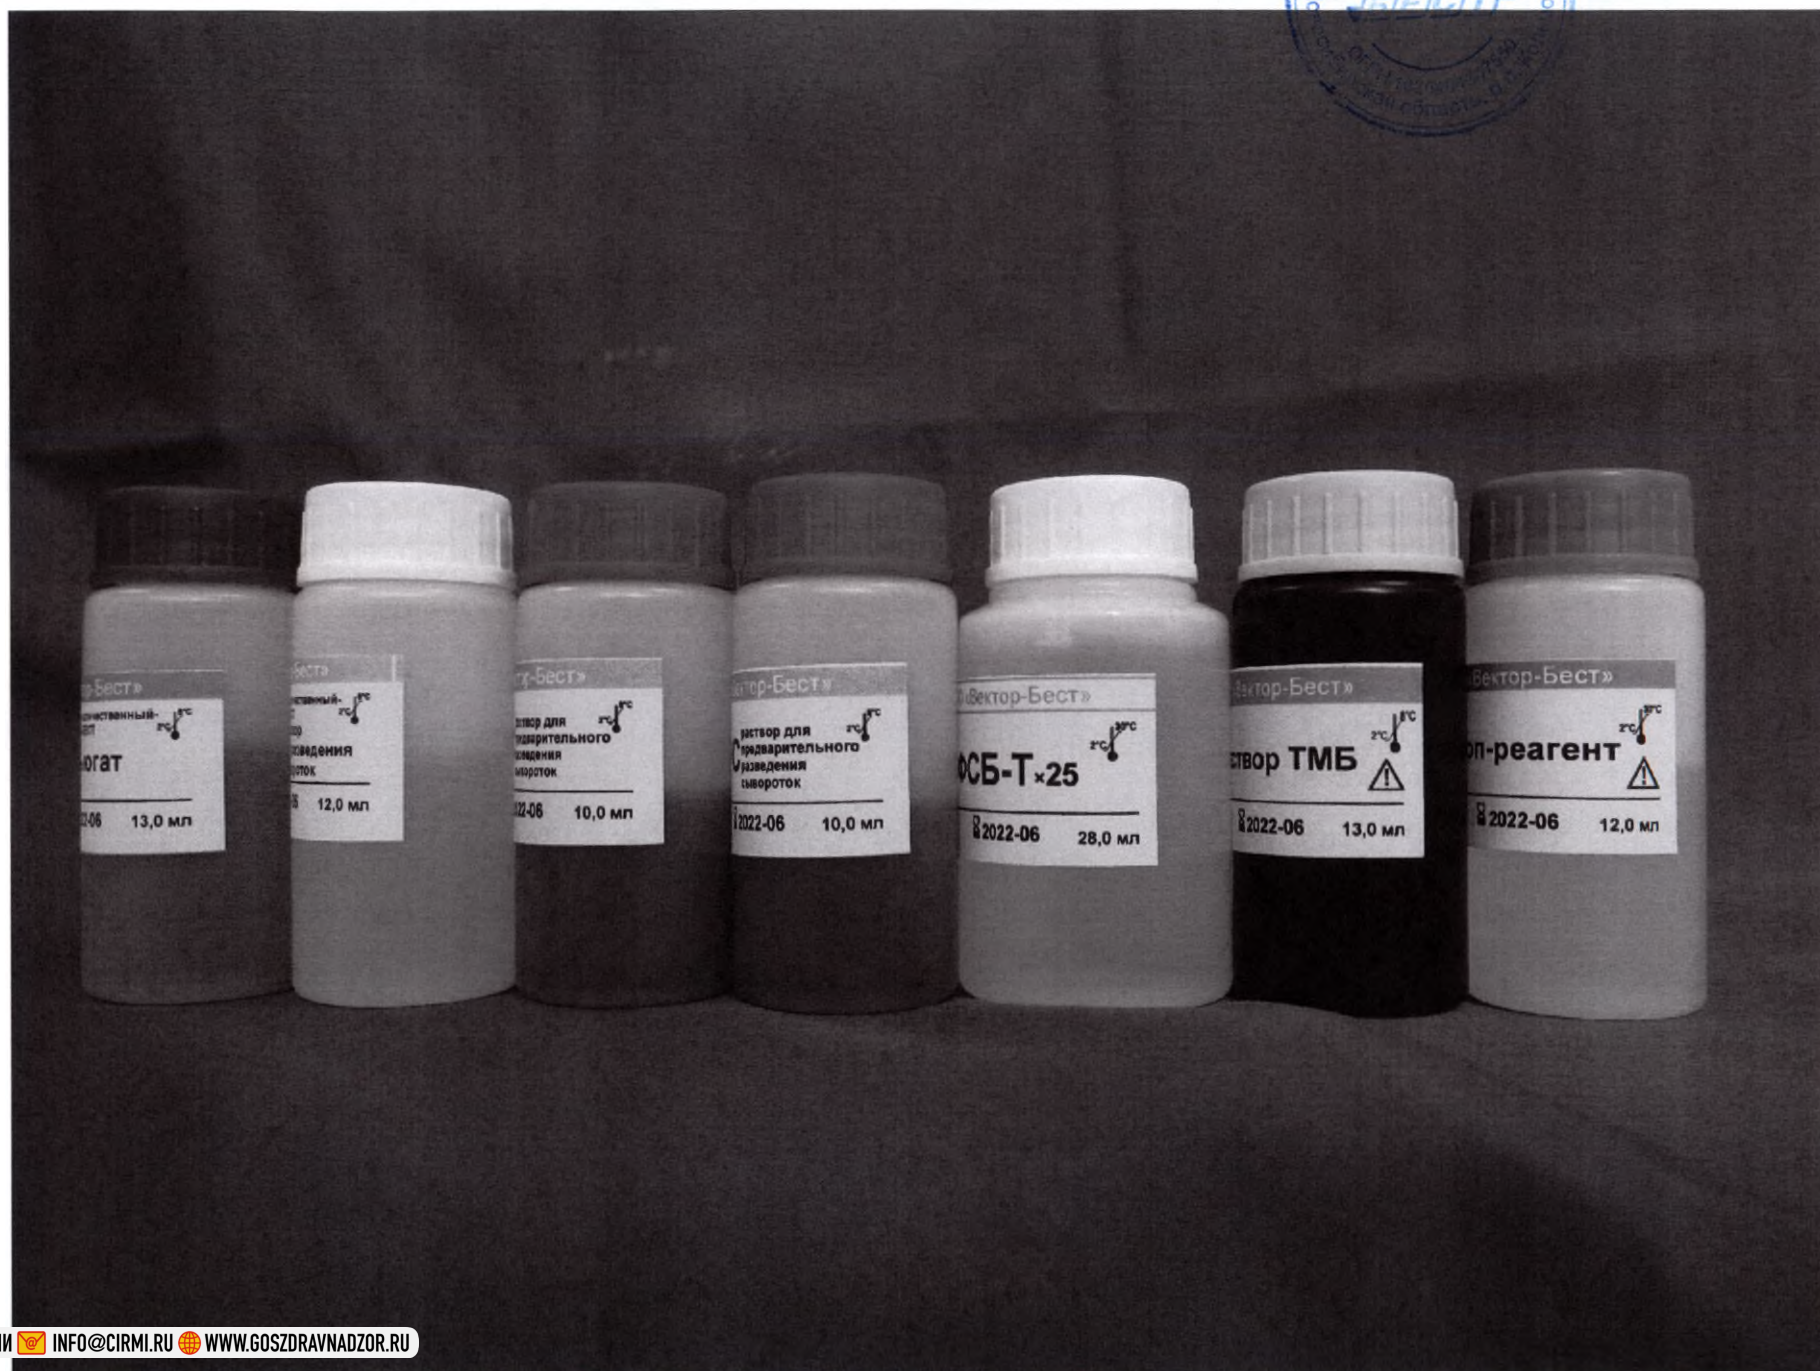


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 8
серия 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
“30” 08/ 2021 г.
М.П. ВЕКТОР-БЕСТ

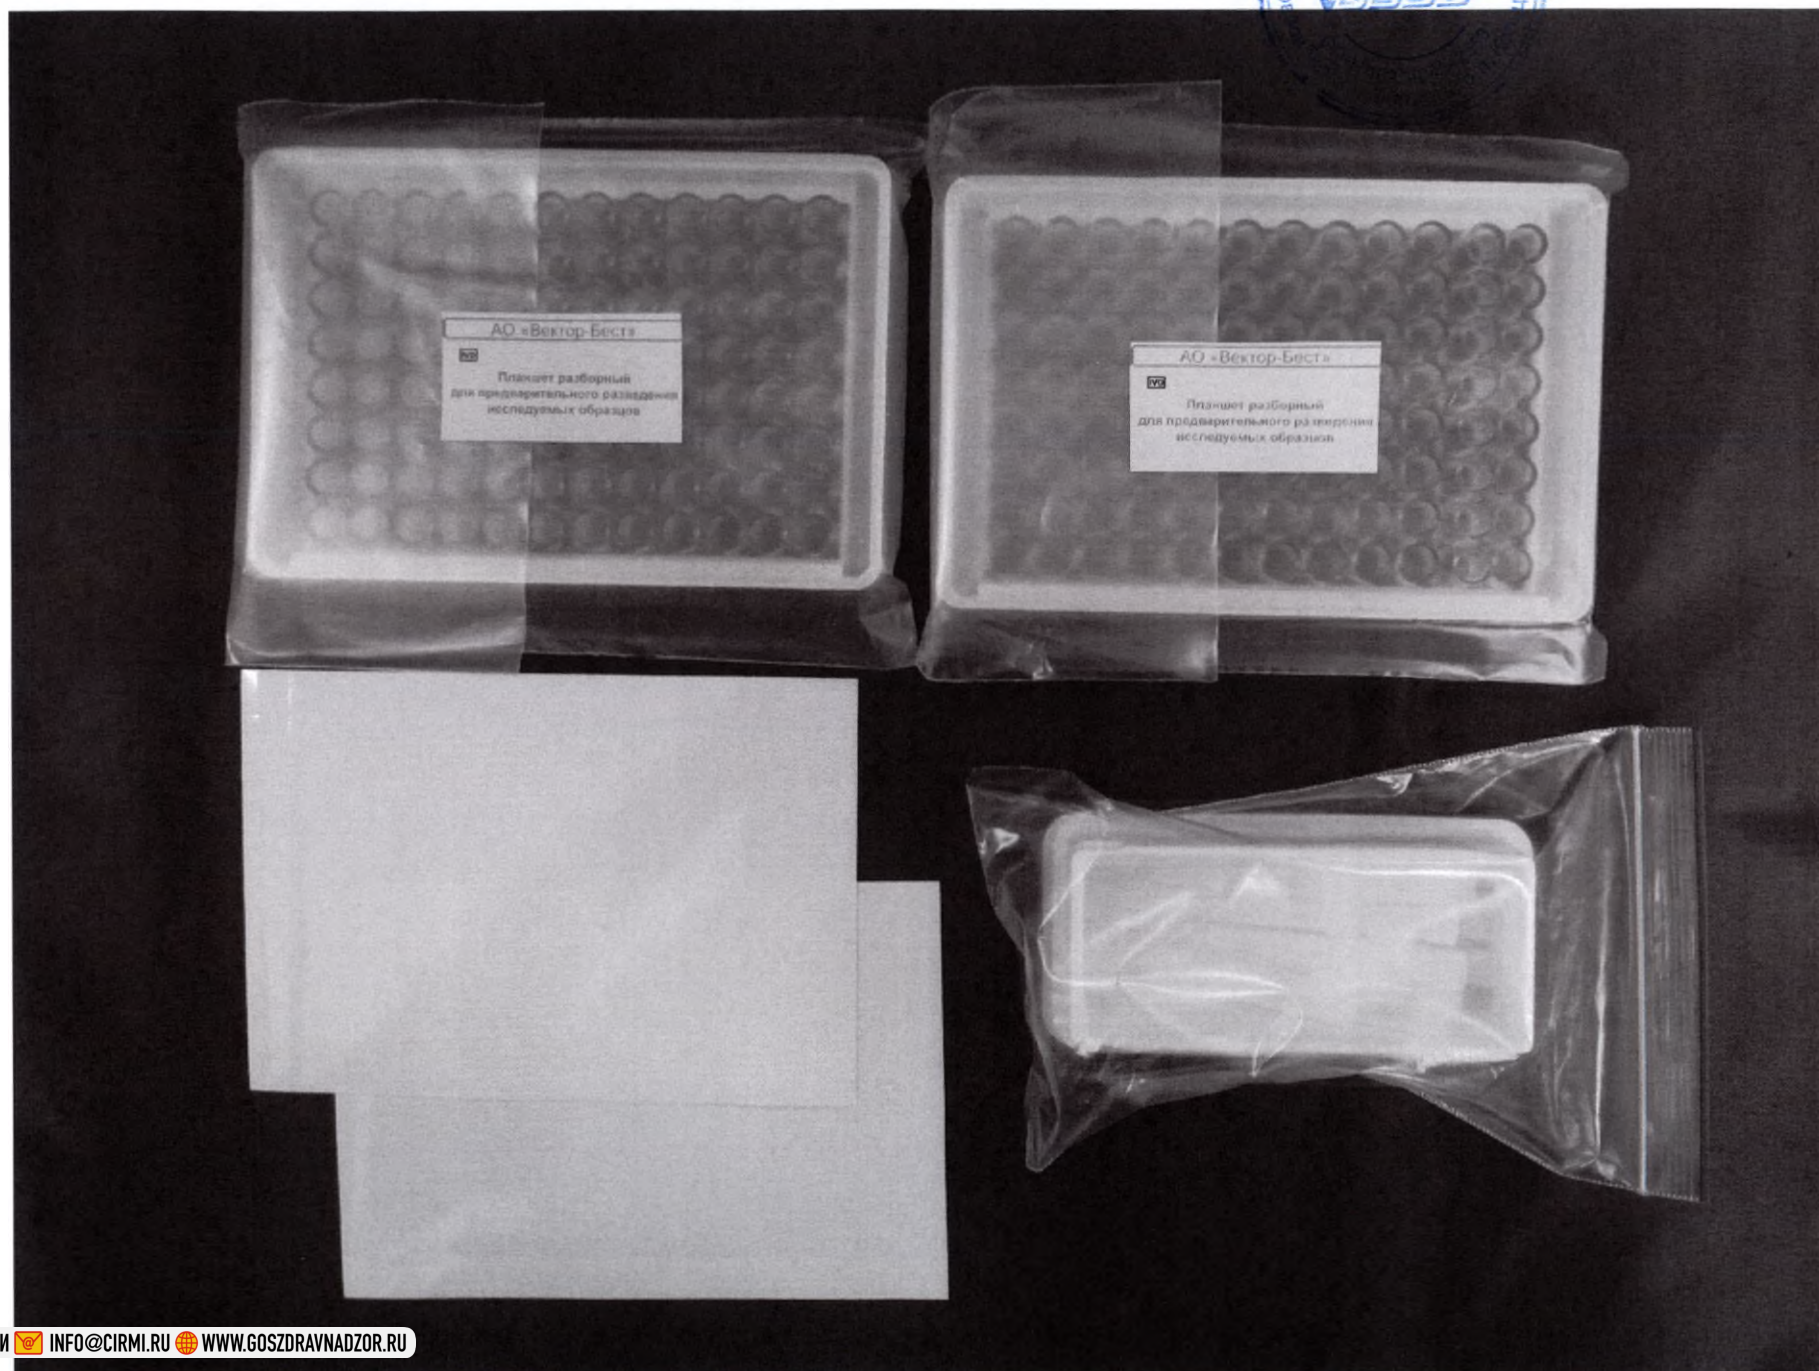

ВЕКТОР

БЕСТ

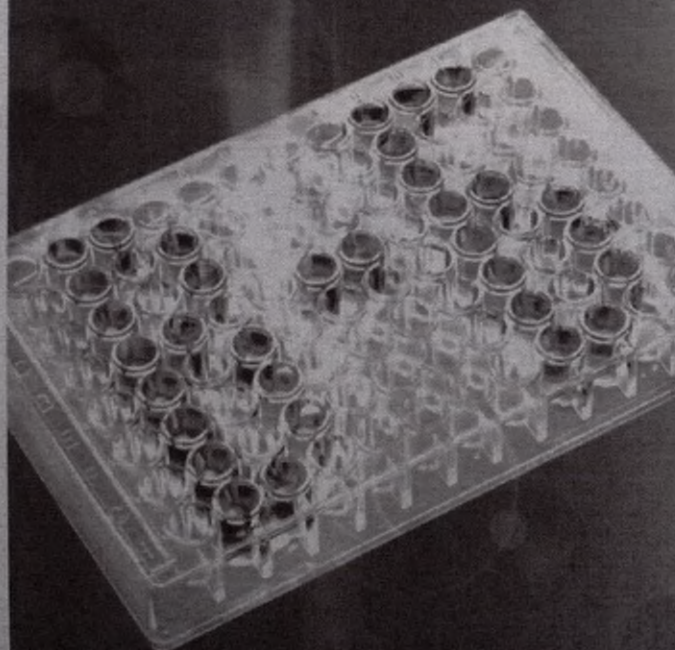

REF
X-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного
количественного определения
иммуноглобулинов класса G
к SARS-CoV-2

SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ

ЛОТ 4


СОСТАВ:

ЛОТ

1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2	1 шт.		4
2. Калибровочные образцы	4 фл.	по 1,5 мл	4
3. Контрольный образец	1 фл.	1,5 мл	4
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл	4
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	4
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	2 фл.	по 10,0 мл	4
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твиним	1 фл.	28,0 мл	4
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл	4
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	4
10. Планшеты разборные для предварительного разведения исследуемых образцов	2 шт.		
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.		
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.		
13. Ванночки для реагентов	2 шт.		
14. Трафарет для построения калибровочного графика	1 шт.		

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 2
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"30" 04 2021 г.

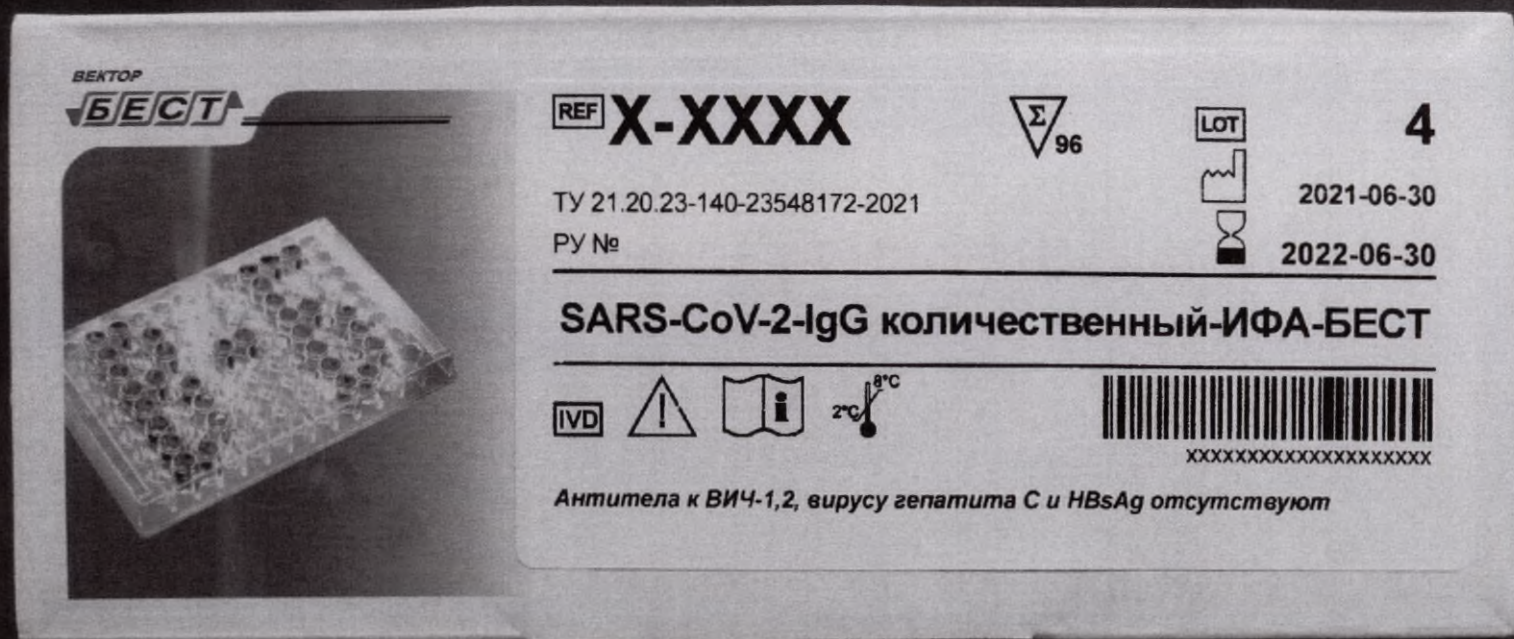

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“30” 06/ 2021 г.
М.П.



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru