

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Мой Дом»


А.А. Полькин



«11» сентября 20 17 г.

**Фотографические изображения
на медицинское изделие**


**Бумага (лента) регистрирующая для ЭКГ, ЭЭГ, анализаторов,
фетальных мониторов, видеопринтеров и других медицинских приборов
по ТУ 21.20.20-002-34330789-2017**

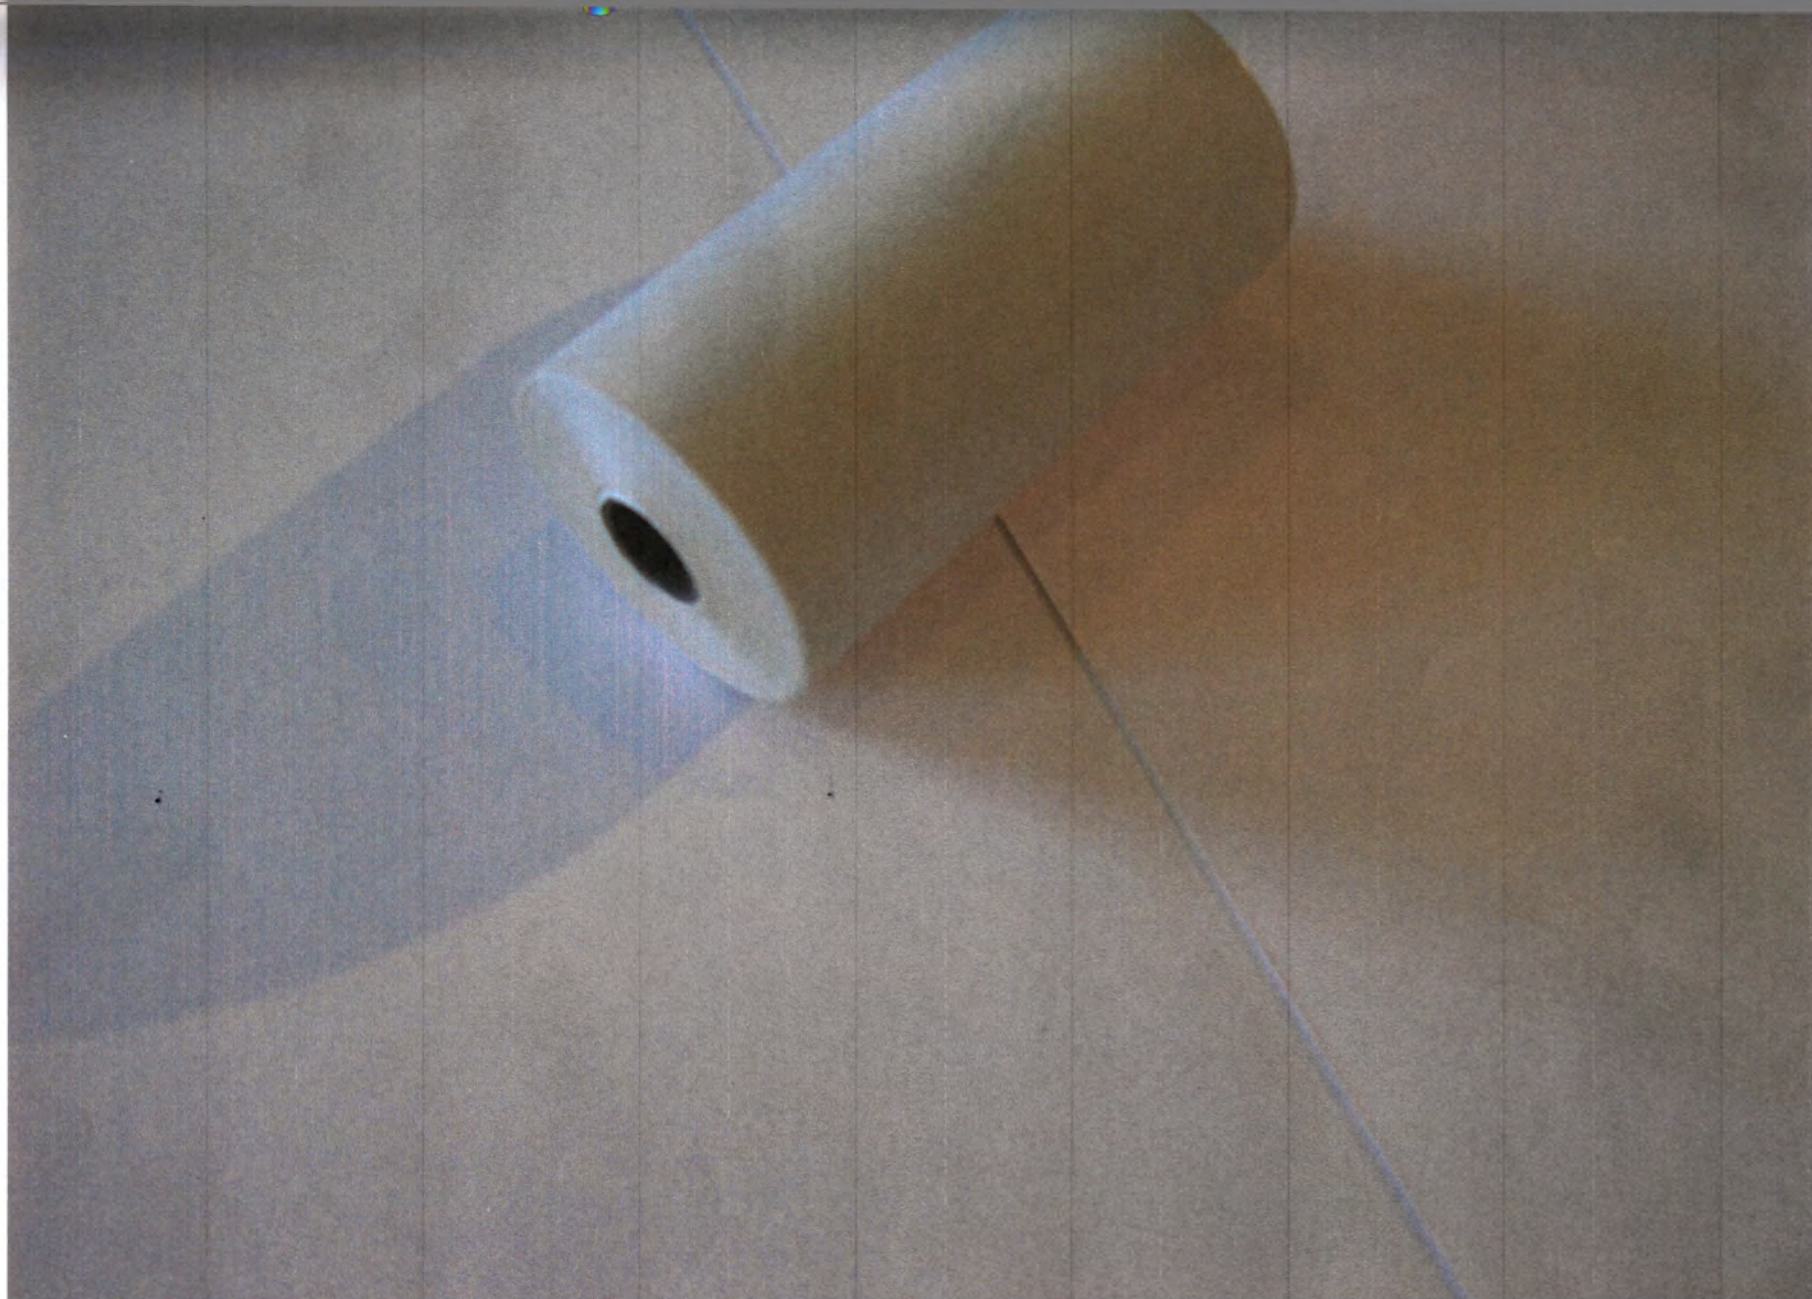

Бумага (лента) регистрирующая для ЭКГ, ЭЭГ, анализаторов, фетальных мониторов, видеопринтеров и других медицинских приборов
по ТУ 21.20.20-002-34330789-2017 в рулонах без диаграммной сетки без фотометрической метки без перфорации

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru


БД БФ Р БП шириной 80 мм длиной 30 м плотностью 55 ± 4 г/м²

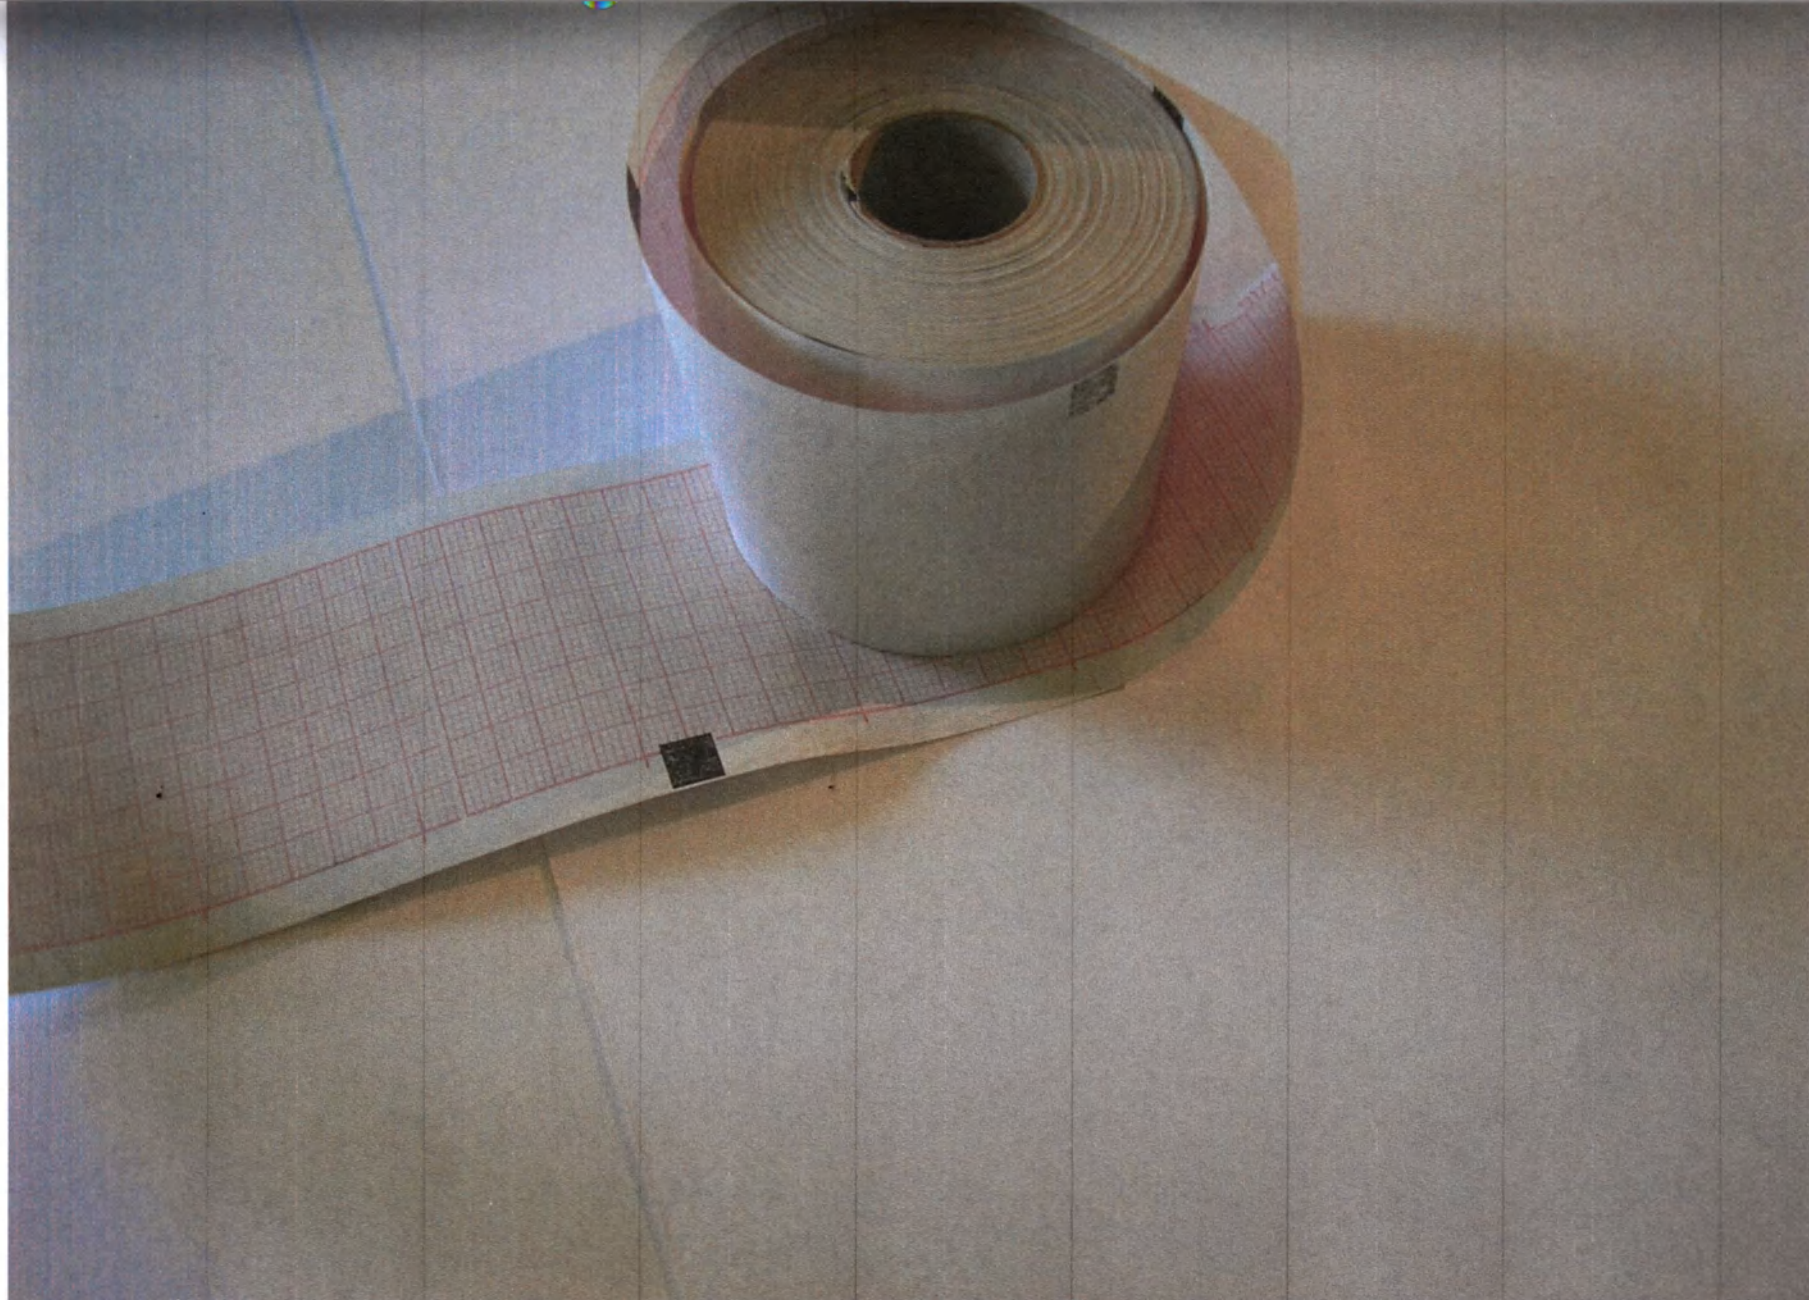

Бумага (лента) регистрирующая для ЭКГ, ЭЭГ, анализаторов, фетальных мониторов, видеопринтеров и других медицинских приборов
по ТУ 21.20.20-002-34330789-2017 в рулонах с фотометрической меткой с нанесением диаграммной сетки без перфорации
СД СФ Р БП шириной 50 мм длиной 30 м плотностью 55 ± 4 г/м²



Бумага (лента) регистрирующая для ЭКГ, ЭЭГ, анализаторов, фетальных мониторов, видеопринтеров и других медицинских приборов
по TV 21 20 20-002-34330789-2017 в пачках с нанесением диаграммной сетки без фотометрической метки с перфорацией
СД БФ П К101 шириной 150 мм длиной 20 м плотностью 55 ± 4 г/м²

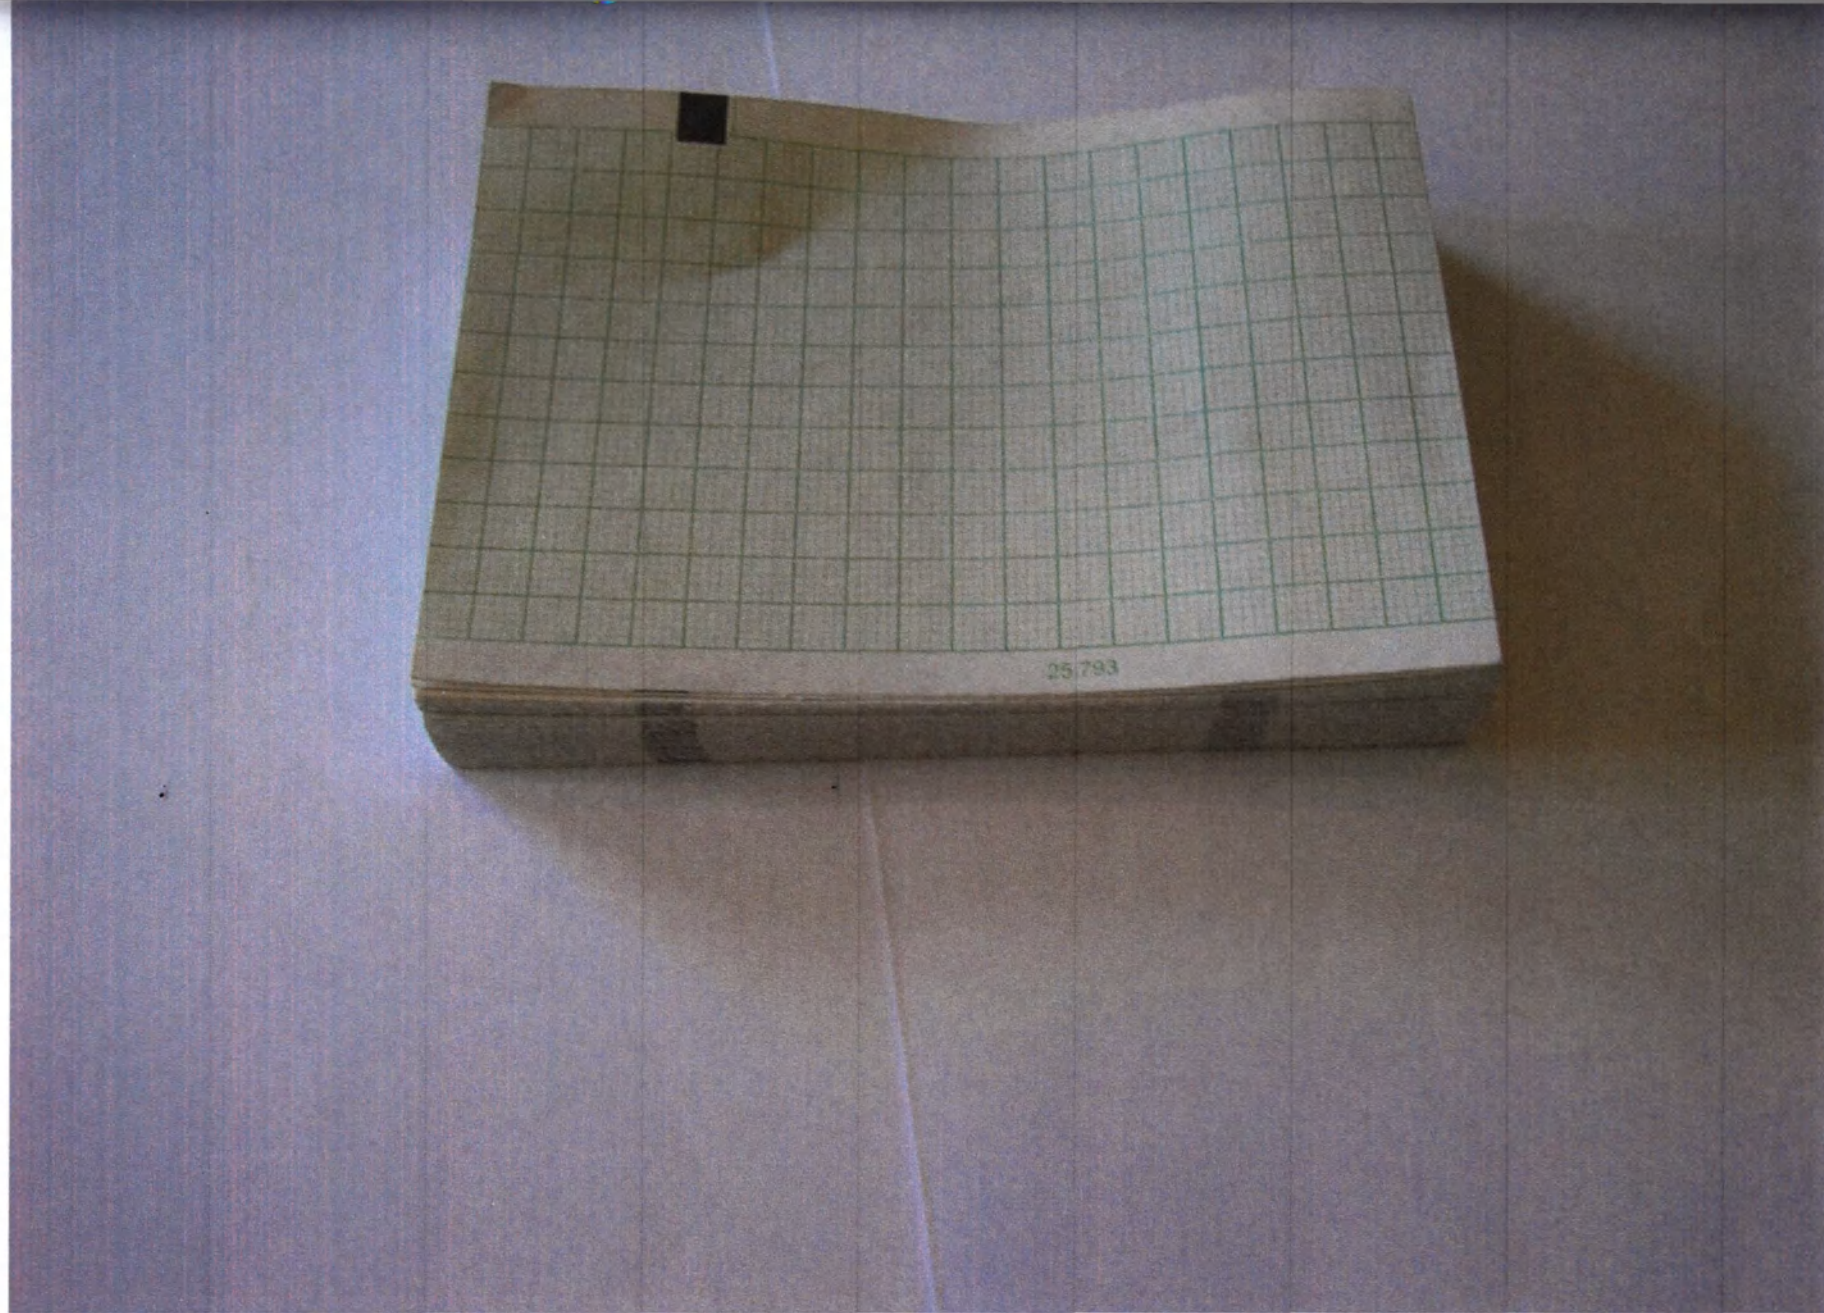

Бумага (лента) регистрирующая для ЭКГ, ЭЭГ, анализаторов, фетальных мониторов, видеопринтеров и других медицинских приборов

ООО ЦИРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru

ТВ 21 20 20 002-34330789-2017 в пачках с фотометрической меткой с нанесением диаграммной сетки без перфорации

СД СФ П БП шириной 70 мм длиной 18 м плотностью 55 ± 4 г/м²



Бумага (лента) регистрирующая для ЭКГ, ЭЭГ, анализаторов, фетальных мониторов, видеопринтеров и других медицинских приборов по ТУ 21.20.20-002-34330789-2017 в пачках с нанесением диаграммной сетки без фотометрической метки без перфорации П БП шириной 152 мм длиной 15 м плотностью 55 ± 4 г/м² в индивидуальной упаковке

Производитель: ООО «Мой Дом»

Россия, 192241, г. Санкт-Петербург, проспект Александровской фермы, 29, лит. П

Тел.: (812) 715-34-14, e-mail: moidom@mail.ru

Дата изготовления: 04.2017


Номер партии: 0072

Использовать до: 03.2022



Рег.уд. РЗН № _____ от _____

**Бумага (лента) регистрирующая для ЭКГ, ЭЭГ,
анализаторов, фетальных мониторов,
видеопринтеров и других медицинских приборов
по ТУ 21.20.20-002-34330789-2017
в рулонах с фотометрической меткой с нанесением диаграммной сетки
без перфорации**

СД СФ Р БП шириной 50 мм длиной 30 м плотностью $55 \pm 4 \text{ г/м}^2$



Не использовать
повторно



Условия
хранения

Бумага (лента) регистрирующая для ЭКГ, ЭЭГ, анализаторов, фетальных мониторов, видеопринтеров и других медицинских приборов
по ТУ 21.20.20-002-34330789-2017 в рулонах с фотометрической меткой с нанесением диаграммной сетки без перфорации


Производитель: ООО «Мой Дом»
Россия, 192241, г. Санкт-Петербург, проспект Александровской фермы, 29, лит. П
Тел.: (812) 715-34-14, e-mail: moidom@mail.ru
Дата изготовления: 04.2017
Номер партии: 0071
Использовать до: 03.2022
Рег.уд. РЗН № _____ от _____

**Бумага (лента) регистрирующая для ЭКГ,
ЭЭГ, анализаторов, фетальных мониторов,
видеопринтеров и других медицинских
приборов**


по ТУ 21.20.20-002-34330789-2017

**в пачках с нанесением диаграммной сетки без фотометрической метки
с перфорацией**


СД БФ П К101 шириной 150 мм длиной 20 м плотностью 55 ± 4 г/м²



Не использовать
повторно



Условия
хранения



Бумага (лента) регистрирующая для ЭКГ, ЭЭГ, анализаторов, фетальных мониторов, видеопринтеров и других медицинских приборов

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ТУ 21.20.20-002-34330789-2017 в пачках с нанесением диаграммной сетки без фотометрической метки с перфорацией

СД БФ П К101 шириной 150 мм длиной 20 м плотностью 55 ± 4 г/м²: этикетка

Верно

Всего в копии прошито, пронумеровано и

Скреплено печатью 8

Генеральный директор ООО «МОЙ ДОМ»

А.А. Полькин

