



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:**

Проводник гидрофильный NaviPro

**для эндоскопических панкреато-билиарных процедур, варианты
исполнения**

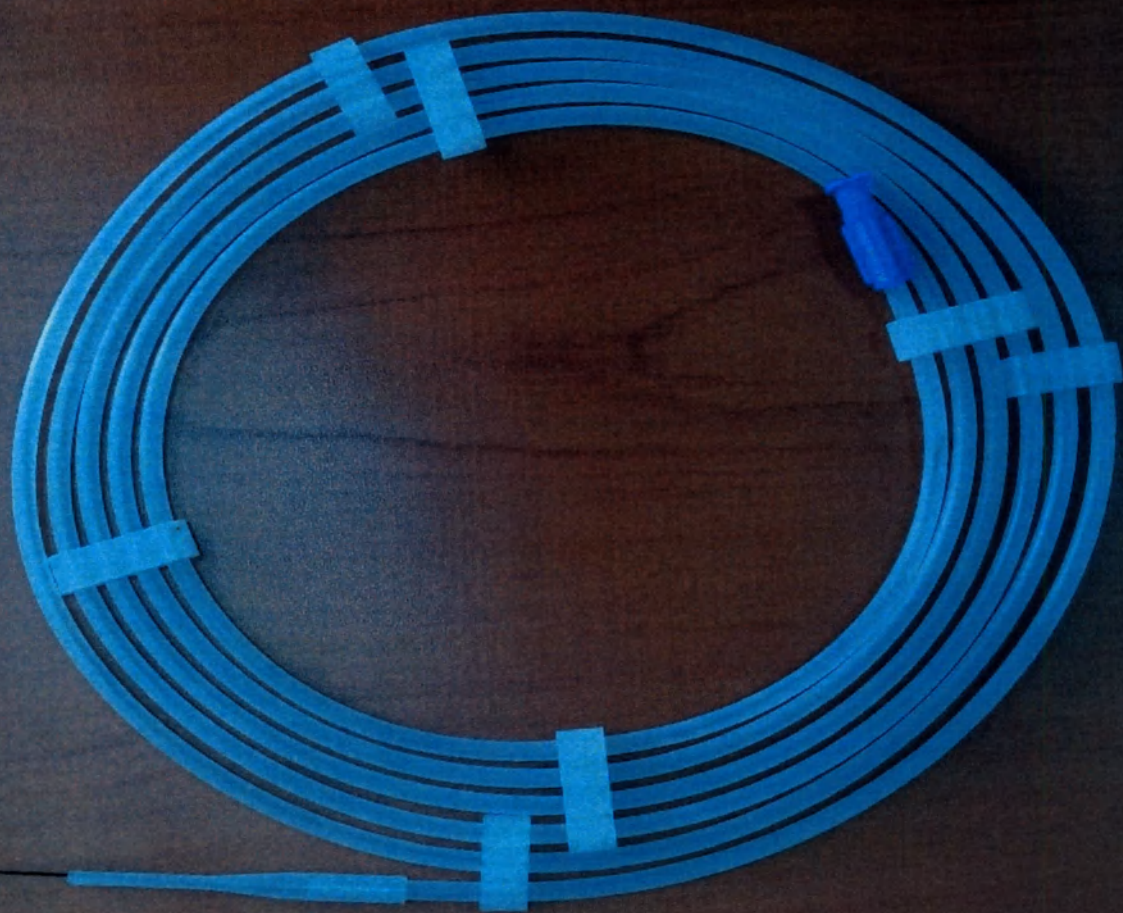


Проводник NaviPro гидрофильный

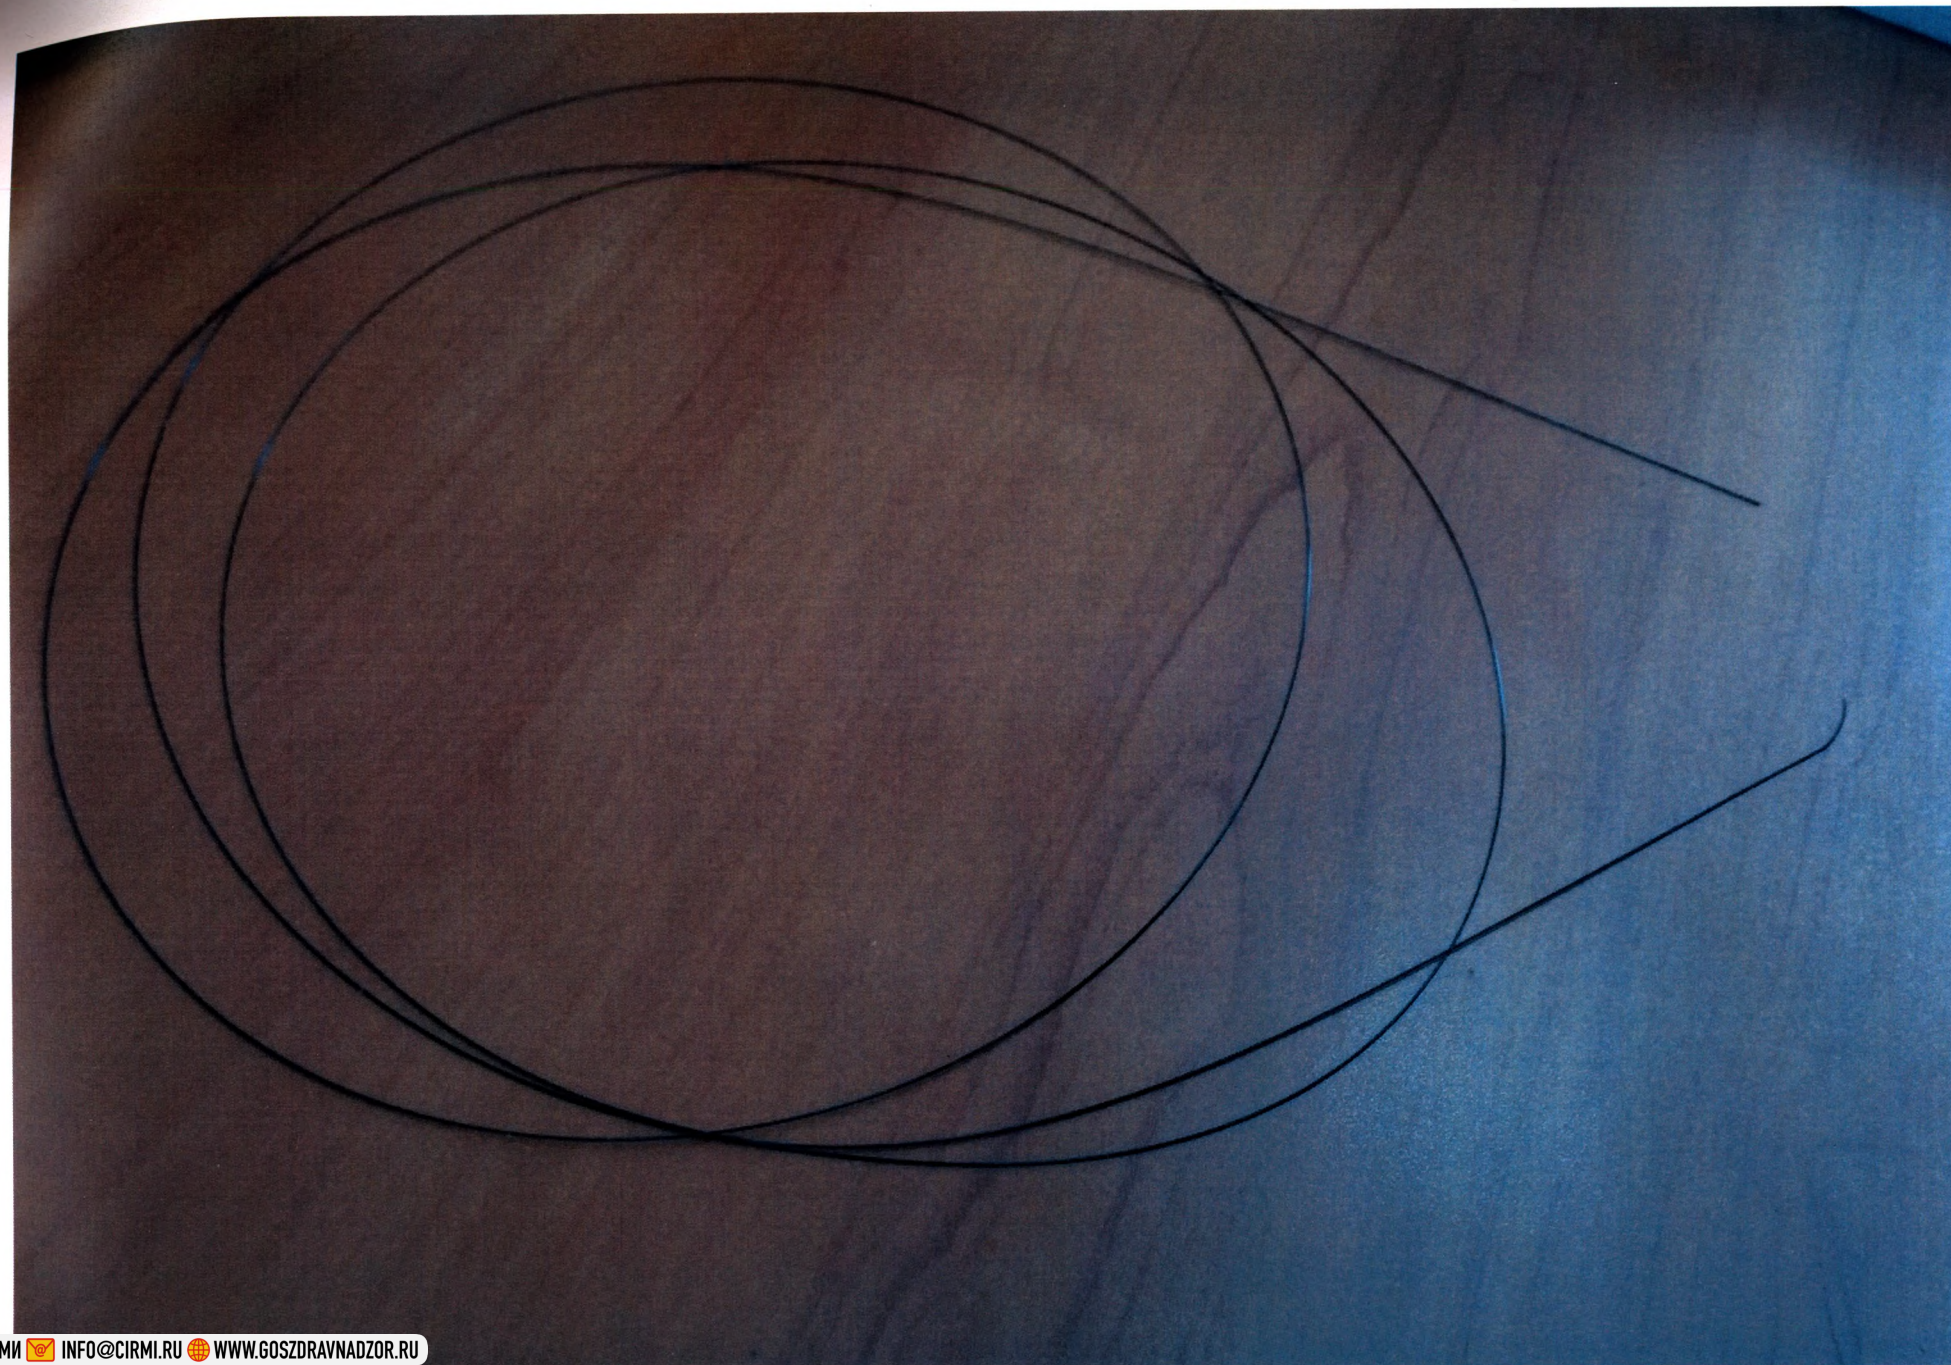





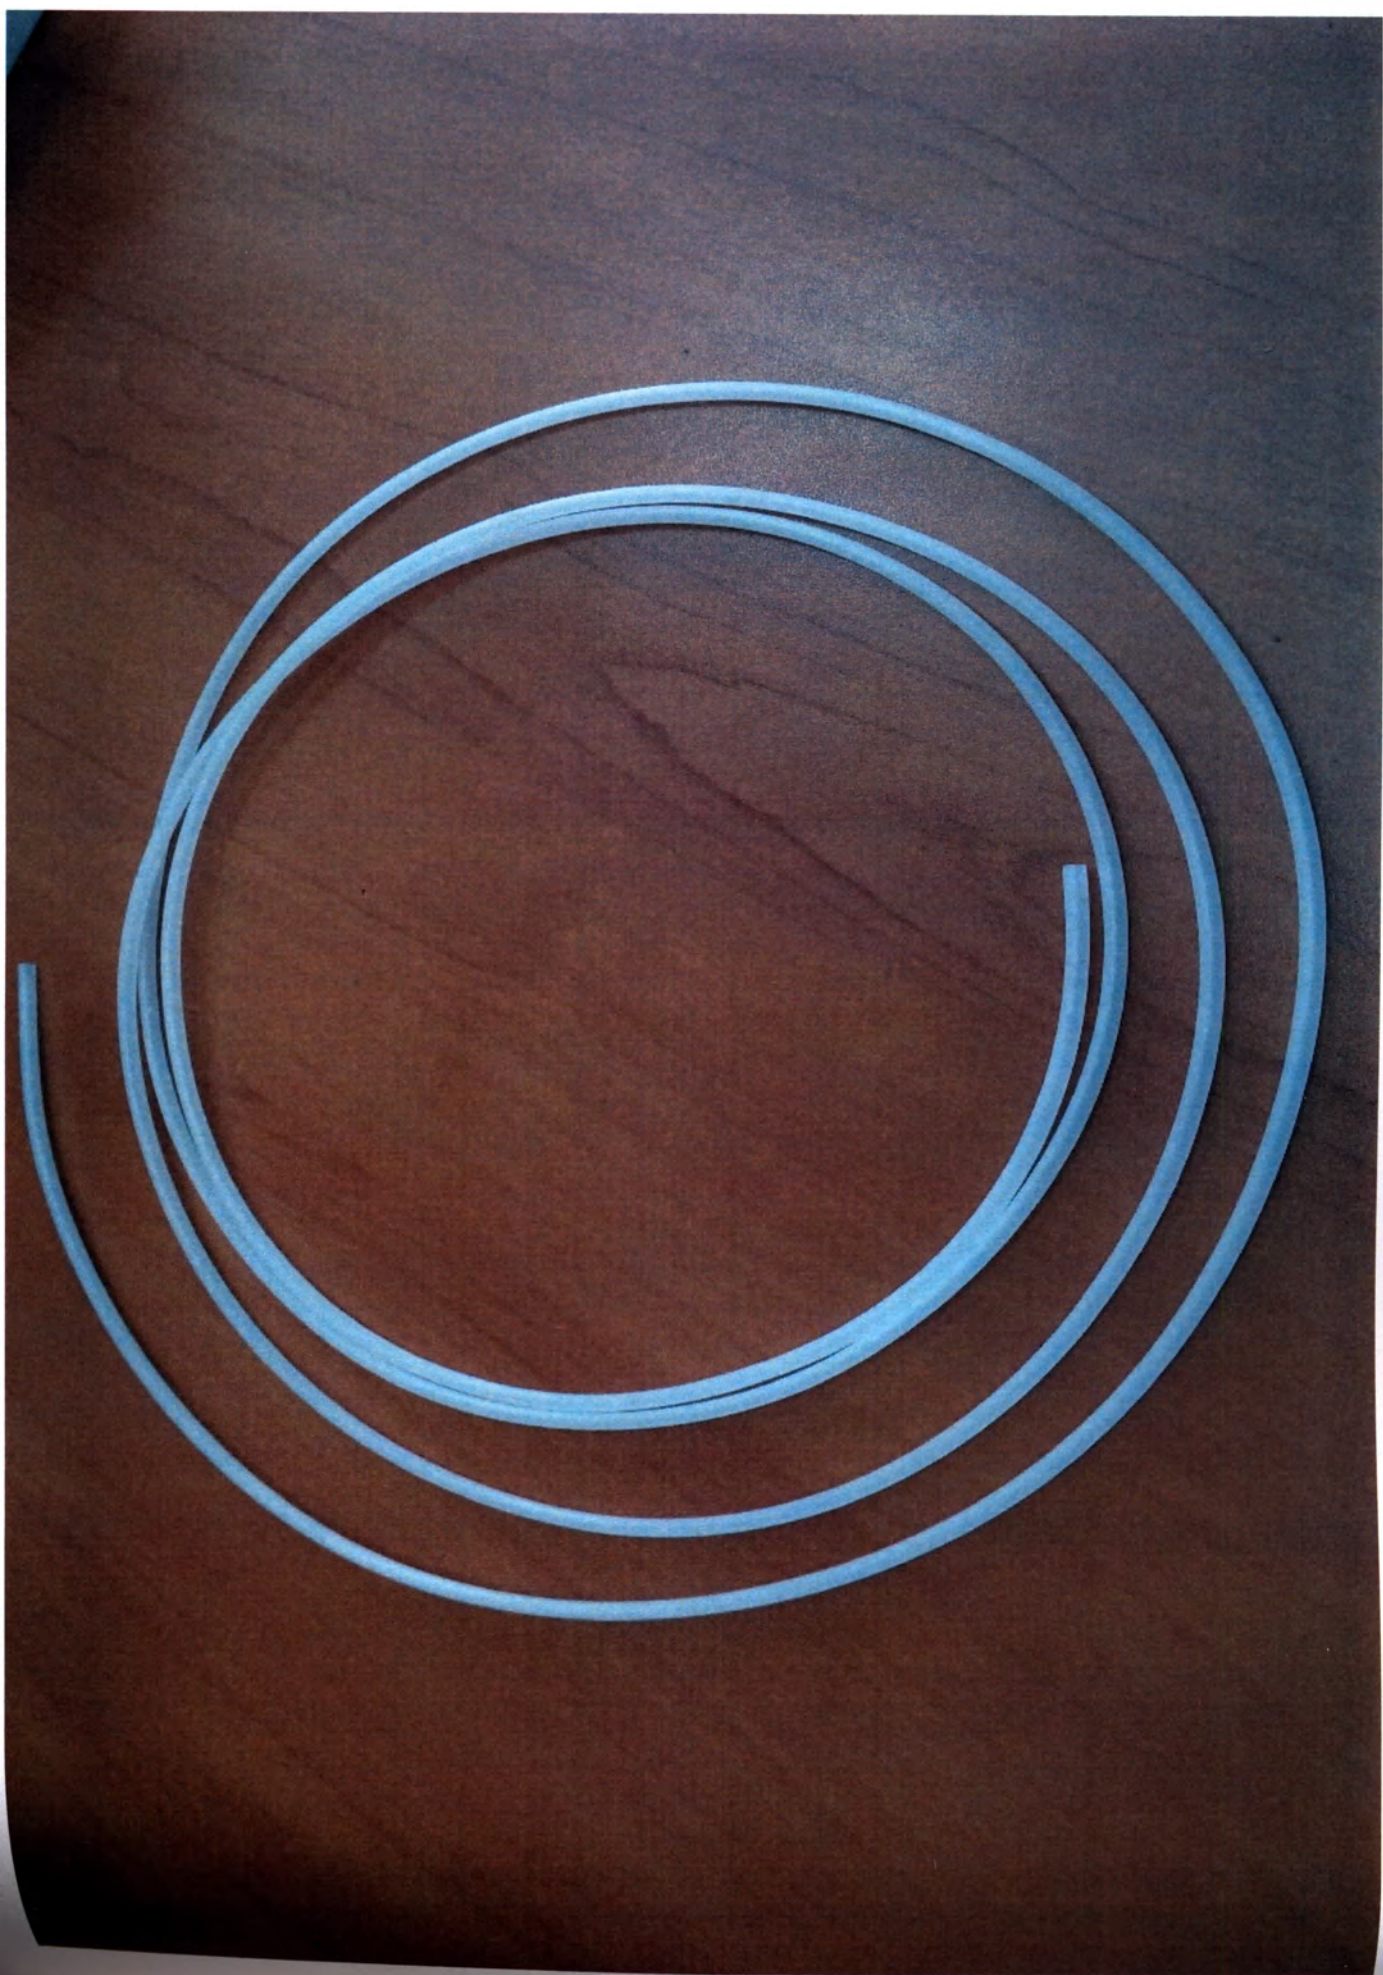



Boston
Scientific

NaviPro™


Hydrophilic Guidewire

Directions for Use	2
Instrucciones de uso	7
Mode d'emploi	12
Gebrauchsanweisung	17
Istruzioni per l'uso	23
Gebruiksaanwijzing	28
Instruções de Utilização	33



90807270-01 Rev. C

2013-02

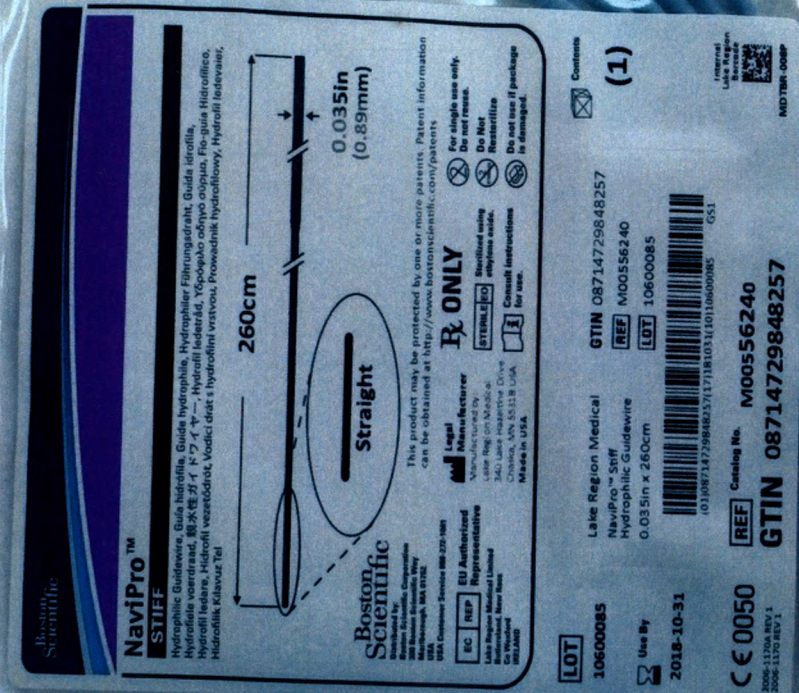




NaviPro™ Hydrophilic Guidewire

Boston
Scientific

Boston
Scientific

NaviPro™ STIFF

Hydrophilic Guidewire, Guia hidrófila, Guide hydrophile, Hydrophiler Führungsdrat, Guida idrofila, Hydrofiele voerdraad, 親水性ガイドワイヤー, Hydrofil ledetråd, Yöspigeko odgyó övvezet, Plo-guia Hidrofílica, Hydrofil ledare, Hidrofil vezetődírt, Vodící drát s hydrofilní vrstvou, Prowadnik hydrofilowy, Hydrofil ledvazir, Hidrofilik Kalavuz Tel

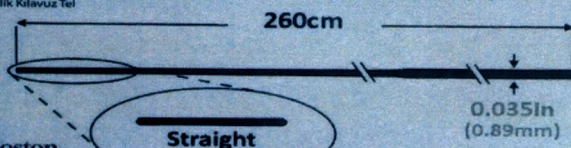

Boston
Scientific

Distributed by
Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1901

EC REP EU Authorized
Representative
Lake Region Medical Limited
Bullford, New Ross
Co Wexford
IRELAND

Legal
Manufacturer
Manufactured by:
Lake Region Medical
340 Lake Hazards Drive
Chaska, MN 55318 USA
Made in USA

Rx ONLY

STERILE EO Sterilized using
ethylene oxide.
Consult instructions
for use.

For single use only.
Do not reuse.
Do Not
Resterilize
Do not use if package
is damaged.

LOT

10600085

Use By
2018-10-31

Lake Region Medical
NaviPro™ Stiff
Hydrophilic Guidewire
0.035in x 260cm

GTIN 08714729839927

REF M00556241

LOT 10600085



(01)08714729839927(17)181031(10)10600085 GS1

CE 0050

2006-1170A REV 1
2006-1170 REV 1

REF Catalog No. M00556241

GTIN 08714729839927

Contents
(5)



MDTBR-008C

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
13 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.

