



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 июня 2022 года № РЗН 2022/17454

На медицинское изделие

Консоли медицинские для распределения медицинских газов и электропитания
"ОЗОН МК" по ТУ 32.50.50-016-64195679-2020

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Энергозащитные системы"
(ООО "ЭЗС"), Россия,

192241, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 56, к. 2, лит. А, пом. №40

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Энергозащитные системы"
(ООО "ЭЗС"), Россия,

192241, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 56, к. 2, лит. А, пом. №40

Место производства медицинского изделия

ООО "ЭЗС", Россия,

192241, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 56, к. 2, лит. А, нежилые пом. № 99,
100, 101, 107 (ПИБ №№ 20, 21, 23, 26, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48), нежилое пом.
№ 200 (ПИБ № 6), ч. нежилого пом. № 201 (ПИБ № 5), нежилое пом. № 205
(ПИБ № 12), ч. нежилого пом. № 206 (ПИБ № 10), нежилое пом. № 207
(ПИБ № 8)

Номер регистрационного досье № РД-43362/53746 от 09.08.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 14 листах

приказом Росздравнадзора от 03 июня 2022 года № 4936
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0066960

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17454

Лист 1

На медицинское изделие

Консоли медицинские для распределения медицинских газов и электропитания "ОЗОН МК" по ТУ 32.50.50-016-64195679-2020, варианты исполнения:

1. Консоль медицинская для распределения медицинских газов и электропитания настенная, варианты исполнения: ОЗОН МК-НО-400-Н, ОЗОН МК-НО-800-Н, ОЗОН МК-НО-1200-Н, ОЗОН МК-НО-1600-Н, ОЗОН МК-НО-2000-Н, ОЗОН МК-НД-600-Н, ОЗОН МК-НД-800-Н, ОЗОН МК-НД-1000-Н, ОЗОН МК-НД-1200-Н, ОЗОН МК-НД-1600-Н, ОЗОН МК-НД-2000-Н, ОЗОН МК-НД-2500-Н, ОЗОН МК-НД-3000-Н, ОЗОН МК-НД-3200-Н, ОЗОН МК-НД-4000-Н - 1 шт., в составе:

- 1.1. Колонка консоли - 1 шт.
- 1.2. Клапан газовый быстроразъемный - не более 36 шт.
- 1.3. Штекер газовый быстроразъемного клапана - не более 36 шт.
- 1.4. Электрические розетки - не более 38 шт.
- 1.5. Автоматические выключатели - не более 10 шт.
- 1.6. Индикатор наличия питания - не более 10 шт.
- 1.7. Клемма заземления - не более 10 шт.
- 1.8. Клемма уравнивания потенциалов - не более 10 шт.
- 1.9. Крепление настенное - 1 шт.
- 1.10. Крепежный рельс для навесного оборудования - не более 20 шт. (при необходимости).
- 1.11. Кронштейн для навесного оборудования - не более 6 шт. (при необходимости).
- 1.12. Кронштейн для монитора - не более 6 шт. (при необходимости).
- 1.13. Клапан пневмопривода типа AirMotor - не более 6 шт. (при необходимости).
- 1.14. Штекер газовый для клапана пневмопривода типа AirMotor - не более 6 шт. (при необходимости).
- 1.15. Клапан отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более 6 шт. (при необходимости).
- 1.16. Штекер газовый для клапана отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более 6 шт. (при необходимости).
- 1.17. Устройство эжекторное для отвода наркогазов - не более 6 шт. (при необходимости).
- 1.18. Сервисный клапан перекрытия магистрали - не более 6 шт. (при необходимости).
- 1.19. Регулятор вакуума - не более 6 шт. (при необходимости).
- 1.20. Контейнер-сборник с крышкой для аспирации - не более 6 шт. (при необходимости).
- 1.21. Корзина контейнера-сборника с крышкой для аспирации - не более 6 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0101195

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17454

Лист 2

(при необходимости).

1.22. Комплект шлангов для аспирации - не более 6 шт. (при необходимости).

1.23. Контрольный манометр - не более 5 шт. (при необходимости).

1.24. Датчик давления - не более 5 шт. (при необходимости).

1.25. Разъём информационный видео/радио/телефон - не более 12 шт.

(при необходимости).

1.26. Кнопка вызова/сброса - не более 6 шт. (при необходимости).

1.27. Регулятор освещения - не более 8 шт. (при необходимости).

1.28. Выключатель электрический - не более 8 шт. (при необходимости).

1.29. Часы - не более 6 шт. (при необходимости).

1.30. Панель контроля газов со светозвуковой аварийной сигнализацией - не более 5 шт. (при необходимости).

1.31. Светильник - не более 8 шт. (при необходимости).

1.32. Навесная приборная полка - не более 8 шт. (при необходимости).

1.33. Навесная приборная полка с ящиками - не более 8 шт. (при необходимости).

1.34. Навесная тумба с ящиками - не более 8 шт. (при необходимости).

1.35. Полка для инфузоматов, секционная - не более 8 шт. (при необходимости).

1.36. Подвесная подвижная тележка с полками - не более 6 шт. (при необходимости).

1.37. Капельница с регулировкой высоты положения - не более 8 шт.

(при необходимости).

1.38. Штатив инфузионный - не более 8 шт. (при необходимости).

1.39. Лампа местного освещения с изменяемой геометрией - не более 6 шт.

(при необходимости).

1.40. Корзина для материалов - не более 6 шт. (при необходимости).

1.41. Крепежный комплект - 1 шт.

1.42. Руководство по эксплуатации.

2. Консоль медицинская для распределения медицинских газов и электропитания настенная ОЗОН МК-ПГ-700-Н, в составе:

2.1. Колонка консоли - 1 шт.

2.2. Крепление настенное - 1 шт.

2.3. Контрольный манометр - не более 6 шт.


2.4. Датчик давления - не более 6 шт. (при необходимости).

2.5. Панель контроля газов со светозвуковой аварийной сигнализацией - не более 1 шт. (при необходимости).

2.6. Клапан газовый быстроразъемный - не более 6 шт. (при необходимости).

2.7. Штекер газовый быстроразъемного клапана - не более 6 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

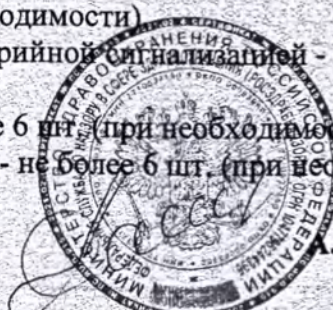

А.В. Самойлова

0101196

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17454

Лист 3

- 2.8. Сервисный клапан перекрытия магистрали - не более 6 шт.
2.9. Крепежный комплект - 1 шт.
2.10. Руководство по эксплуатации.
3. Консоль медицинская для распределения медицинских газов и электропитания потолочная с поворотным креплением, варианты исполнения: ОЗОН МК-НД-600-ОП, ОЗОН МК-НД-800-ОП, ОЗОН МК-НД-1000-ОП, ОЗОН МК-НД-1200-ОП, ОЗОН МК-НД-1600-ОП, ОЗОН МК-НД-2000-ОП - 1 шт., в составе:
3.1. Колонка консоли - 1 шт.
3.2. Клапан газовый быстроразъемный - не более 20 шт.
3.3. Штекер газовый быстроразъемного клапана - не более 20 шт.
3.4. Электрические розетки - не более 22 шт.
3.5. Автоматические выключатели - не более 5 шт.
3.6. Индикатор наличия питания - не более 5 шт.
3.7. Клемма заземления - не более 5 шт.
3.8. Клемма уравнивания потенциалов - не более 5 шт.
3.9. Крепление потолочное поворотное - 1 шт.
3.10. Крепежный рельс для навесного оборудования - не более 12 шт.
(при необходимости).
3.11. Кронштейн для навесного оборудования - не более 4 шт. (при необходимости).
3.12. Кронштейн для монитора - не более 4 шт. (при необходимости).
3.13. Клапан пневмопривода типа AirMotor - не более 4 шт. (при необходимости).
3.14. Штекер газовый для клапана пневмопривода типа AirMotor - не более 4 шт.
(при необходимости).
3.15. Клапан отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более 4 шт.
(при необходимости).
3.16. Штекер газовый для клапана отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более 4 шт. (при необходимости).
3.17. Устройство эжекторное для отвода наркогазов - не более 4 шт.
(при необходимости).
3.18. Сервисный клапан перекрытия магистрали - не более 5 шт. (при необходимости).
3.19. Регулятор вакуума - не более 4 шт. (при необходимости).
3.20. Контейнер-сборник с крышкой для аспирации - не более 4 шт.
(при необходимости).
3.21. Корзина контейнера-сборника с крышкой для аспирации - не более 4 шт.
(при необходимости).
3.22. Комплект шлангов для аспирации - не более 4 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0101197

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 июня 2022 года


№ РЗН 2022/17454

Лист 4

- 3.23. Контрольный манометр - не более 5 шт. (при необходимости).
- 3.24. Датчик давления - не более 5 шт. (при необходимости).
- 3.25. Разъём информационный видео/радио/телефон - не более 8 шт. (при необходимости).
- 3.26. Кнопка вызова/сброса - не более 2 шт. (при необходимости).
- 3.27. Часы - не более 3 шт. (при необходимости).
- 3.28. Панель контроля газов со светозвуковой аварийной сигнализацией - не более 2 шт. (при необходимости).
- 3.29. Навесная приборная полка - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.30. Навесная приборная полка с ящиками - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.31. Навесная тумба с ящиками - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.32. Полка для инфузоматов, секционная - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.33. Капельница с регулировкой высоты положения - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.34. Штатив инфузионный - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.35. Лампа местного освещения с изменяемой геометрией - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.36. Корзина для материалов - не более 4 шт. (при необходимости).
- 3.37. Крепежный комплект - 1 шт.
- 3.38. Руководство по эксплуатации.
- 4. Консоль медицинская для распределения медицинских газов и электропитания потолочная с подъемно-поворотным креплением, варианты исполнения: ОЗОН МК-НД-600-ОПП, ОЗОН МК-НД-800-ОПП, ОЗОН МК-НД-1000-ОПП, ОЗОН МК-НД-1200-ОПП, ОЗОН МК-НД-1600-ОПП, ОЗОН МК-НД-2000-ОПП - 1 шт., в составе:
 - 4.1. Колонка консоли - 1 шт.
 - 4.2. Клапан газовый быстроразъемный - не более 20 шт.
 - 4.3. Штекер газовый быстроразъемного клапана - не более 20 шт.
 - 4.4. Электрические розетки - не более 22 шт.
 - 4.5. Автоматические выключатели - не более 5 шт.
 - 4.6. Индикатор наличия питания - не более 5 шт.
 - 4.7. Клемма заземления - не более 5 шт.
 - 4.8. Клемма уравнивания потенциалов - не более 5 шт.
 - 4.9. Крепление потолочное подъемно-поворотное - 1 шт.
 - 4.10. Крепежный рельс для навесного оборудования - не более 12 шт. (при необходимости).
 - 4.11. Кронштейн для навесного оборудования - не более 4 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

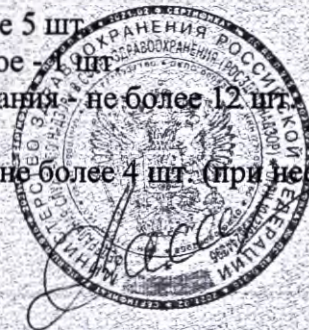

0101198

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17454

Лист 5

- 4.12. Кронштейн для монитора - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.13. Клапан пневмопривода типа AirMotor - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.14. Штекер газовый для клапана пневмопривода типа AirMotor - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.15. Клапан отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.16. Штекер газовый для клапана отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.17. Устройство эжекторное для отвода наркогазов - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.18. Сервисный клапан перекрытия магистрали - не более 5 шт. (при необходимости).
- 4.19. Регулятор вакуума - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.20. Контейнер-сборник с крышкой для аспирации - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.21. Корзина контейнера-сборника с крышкой для аспирации - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.22. Комплект шлангов для аспирации - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.23. Контрольный манометр - не более 5 шт. (при необходимости).
- 4.24. Датчик давления - не более 5 шт. (при необходимости).
- 4.25. Разъём информационный видео/радио/телефон - не более 8 шт. (при необходимости).
- 4.26. Кнопка вызова/сброса - не более 2 шт. (при необходимости).
- 4.27. Часы - не более 3 шт. (при необходимости).
- 4.28. Панель контроля газов со светозвуковой аварийной сигнализацией - не более 2 шт. (при необходимости).
- 4.29. Навесная приборная полка - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.30. Навесная приборная полка с ящиками - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.31. Навесная тумба с ящиками - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.32. Полка для инфузоматов, секционная - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.33. Капельница с регулировкой высоты положения - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.34. Штатив инфузионный - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.35. Лампа местного освещения с изменяемой геометрией - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.36. Корзина для материалов - не более 4 шт. (при необходимости).
- 4.37. Крепежный комплект - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0101199

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17454

Лист 6

4.38. Руководство по эксплуатации.

5. Консоль медицинская для распределения медицинских газов и электропитания потолочная с П-образным (мост) креплением, варианты исполнения: ОЗОН МК-НО-800-ПП, ОЗОН МК-НО-1200-ПП, ОЗОН МК-НО-1600-ПП, ОЗОН МК-НО-2000-ПП, ОЗОН МК-НД-600-ПП, ОЗОН МК-НД-800-ПП, ОЗОН МК-НД-1000-ПП, ОЗОН МК-НД-1200-ПП, ОЗОН МК-НД-1600-ПП, ОЗОН МК-НД-2000-ПП, ОЗОН МК-НД-2500-ПП, ОЗОН МК-НД-3000-ПП, ОЗОН МК-НД-3200-ПП, ОЗОН МК-НД-4000-ПП - 1 шт., в составе:

5.1. Колонка консоли - 1 шт.

5.2. Клапан газовый быстросъемный - не более 36 шт.

5.3. Штекер газовый быстросъемного клапана - не более 36 шт.

5.4. Электрические розетки - не более 38 шт.

5.5. Автоматические выключатели - не более 10 шт.

5.6. Индикатор наличия питания - не более 10 шт.

5.7. Клемма заземления - не более 10 шт.

5.8. Клемма уравнивания потенциалов - не более 10 шт.

5.9. Крепление П-образное (мост) потолочное - 1 шт.

5.10. Крепежный рельс для навесного оборудования - не более 20 шт.

(при необходимости).

5.11. Кронштейн для навесного оборудования - не более 6 шт. (при необходимости).

5.12. Кронштейн для монитора - не более 6 шт. (при необходимости).

5.13. Клапан пневмопривода типа AirMotor - не более 6 шт. (при необходимости).

5.14. Штекер газовый для клапана пневмопривода типа AirMotor - не более 6 шт.

(при необходимости).

5.15. Клапан отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более 6 шт.

(при необходимости).

5.16. Штекер газовый для клапана отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более

6 шт. (при необходимости).

5.17. Устройство эжекторное для отвода наркогазов - не более 6 шт.

(при необходимости).

5.18. Сервисный клапан перекрытия магистрали - не более 5 шт. (при необходимости).

5.19. Регулятор вакуума - не более 6 шт. (при необходимости).


5.20. Контейнер-сборник с крышкой для аспирации - не более 6 шт.

(при необходимости).

5.21. Корзина контейнера-сборника с крышкой для аспирации - не более 6 шт.

(при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

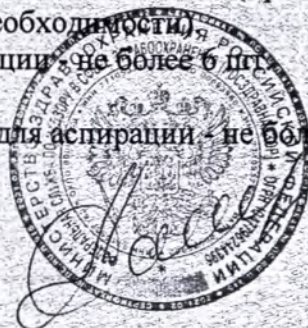

А.В. Самойлова

0101200

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17454

Лист 7

- 5.22. Комплект шлангов для аспирации - не более 6 шт. (при необходимости).
- 5.23. Контрольный манометр - не более 5 шт. (при необходимости).
- 5.24. Датчик давления - не более 5 шт. (при необходимости).
- 5.25. Разъём информационный видео/радио/телефон - не более 12 шт. (при необходимости).
- 5.26. Кнопка вызова/сброса - не более 6 шт. (при необходимости).
- 5.27. Регулятор освещения - не более 8 шт. (при необходимости).
- 5.28. Выключатель электрический - не более 8 шт. (при необходимости).
- 5.29. Часы - не более 6 шт. (при необходимости).
- 5.30. Панель контроля газов со светозвуковой аварийной сигнализацией - не более 5 шт. (при необходимости).
- 5.31. Светильник - не более 8 шт. (при необходимости).
- 5.32. Навесная приборная полка - не более 8 шт. (при необходимости).
- 5.33. Навесная приборная полка с ящиками - не более 8 шт. (при необходимости).
- 5.34. Навесная тумба с ящиками - не более 8 шт. (при необходимости).
- 5.35. Полка для инфузоматов, секционная - не более 8 шт. (при необходимости).
- 5.36. Подвесная подвижная тележка с полками - не более 6 шт. (при необходимости).
- 5.37. Капельница с регулировкой высоты положения - не более 8 шт. (при необходимости).
- 5.38. Штатив инфузионный - не более 8 шт. (при необходимости).
- 5.39. Лампа местного освещения с изменяемой геометрией - не более 6 шт. (при необходимости).
- 5.40. Корзина для материалов - не более 6 шт. (при необходимости).
- 5.41. Крепежный комплект - 1 шт.
- 5.42. Руководство по эксплуатации.
- 6. Консоль медицинская для распределения медицинских газов и электропитания потолочная с креплением опора, варианты исполнения: ОЗОН МК-НО-400-О, ОЗОН МК-НО-800-О, ОЗОН МК-НД-600-О, ОЗОН МК-НД-800-О, ОЗОН МК-НД-1000-О, ОЗОН МК-НД-1200-О, ОЗОН МК-НД-1600-О, ОЗОН МК-НД-2000-О, ОЗОН МК-НД-2500-О - 1 шт., в составе:
 - 6.1. Колонка консоли - 1 шт.
 - 6.2. Клапан газовый быстроразъемный - не более 24 шт.
 - 6.3. Штекер газовый быстроразъемного клапана - не более 24 шт.
 - 6.4. Электрические розетки - не более 26 шт.
 - 6.5. Автоматические выключатели - не более 6 шт.
 - 6.6. Индикатор наличия питания - не более 6 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0102401

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17454

Лист 8

- 6.7. Клемма заземления - не более 6 шт.
- 6.8. Клемма уравнивания потенциалов - не более 6 шт.
- 6.9. Крепление опоры потолочное - 1 шт.
- 6.10. Крепежный рельс для навесного оборудования - не более 12 шт.
(при необходимости).
- 6.11. Кронштейн для навесного оборудования - не более 4 шт. (при необходимости).
- 6.12. Кронштейн для монитора - не более 4 шт. (при необходимости).
- 6.13. Клапан пневмопривода типа AirMotor - не более 4 шт. (при необходимости).
- 6.14. Штекер газовый для клапана пневмопривода типа AirMotor - не более 4 шт.
(при необходимости).
- 6.15. Клапан отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более 4 шт.
(при необходимости).
- 6.16. Штекер газовый для клапана отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более 4 шт. (при необходимости).
- 6.17. Устройство эжекторное для отвода наркогазов - не более 4 шт.
(при необходимости).
- 6.18. Сервисный клапан перекрытия магистрали - не более 5 шт. (при необходимости).
- 6.19. Регулятор вакуума - не более 4 шт. (при необходимости).
- 6.20. Контейнер-сборник с крышкой для аспирации - не более 4 шт.
(при необходимости).
- 6.21. Корзина контейнера-сборника с крышкой для аспирации - не более 4 шт.
(при необходимости).
- 6.22. Комплект шлангов для аспирации - не более 4 шт. (при необходимости).
- 6.23. Контрольный манометр - не более 5 шт. (при необходимости).
- 6.24. Датчик давления - не более 5 шт. (при необходимости).
- 6.25. Разъём информационный видео/радио/телефон - не более 9 шт.
(при необходимости).
- 6.26. Кнопка вызова/сброса - не более 4 шт. (при необходимости).
- 6.27. Часы - не более 4 шт. (при необходимости).
- 6.28. Панель контроля газов со светозвуковой аварийной сигнализацией - не более 3 шт. (при необходимости).
- 6.29. Навесная приборная полка - не более 6 шт. (при необходимости).
- 6.30. Навесная приборная полка с ящиками - не более 6 шт. (при необходимости).
- 6.31. Навесная тумба с ящиками - не более 6 шт. (при необходимости).
- 6.32. Полка для инфузоматов, секционная - не более 6 шт. (при необходимости).
- 6.33. Капельница с регулировкой высоты положения - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0102402

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17454

Лист 9

(при необходимости).

6.34. Штатив инфузионный - не более 4 шт. (при необходимости).

6.35. Лампа местного освещения с изменяемой геометрией - не более 4 шт.

(при необходимости).

6.36. Корзина для материалов - не более 4 шт. (при необходимости).

6.37. Крепежный комплект - 1 шт.

6.38. Руководство по эксплуатации.

7. Консоль медицинская для распределения медицинских газов и электропитания напольно-потолочная на колесной опоре, варианты исполнения: ОЗОН МК-НД-600-КО, ОЗОН МК-НД-800-КО, ОЗОН МК-НД-1000-КО, ОЗОН МК-НД-1200-КО, ОЗОН МК-НД-1600-КО, ОЗОН МК-НД-2000-КО, ОЗОН МК-НД-2500-КО - 1 шт., в составе:

7.1. Колонка консоли - 1 шт.

7.2. Клапан газовый быстроразъемный - не более 24 шт.

7.3. Штекер газовый быстроразъемного клапана - не более 24 шт.

7.4. Электрические розетки - не более 26 шт.

7.5. Автоматические выключатели - не более 6 шт.

7.6. Индикатор наличия питания - не более 6 шт.

7.7. Клемма заземления - не более 6 шт.

7.8. Клемма уравнивания потенциалов - не более 6 шт.

7.9. Крепление напольно-потолочное на колесной опоре - 1 шт.

7.10. Крепежный рельс для навесного оборудования - не более 12 шт.

(при необходимости).

7.11. Кронштейн для навесного оборудования - не более 4 шт. (при необходимости).

7.12. Кронштейн для монитора - не более 4 шт. (при необходимости).

7.13. Клапан пневмопривода типа AirMotor - не более 4 шт. (при необходимости).

7.14. Штекер газовый для клапана пневмопривода типа AirMotor - не более 4 шт.

(при необходимости).

7.15. Клапан отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более 4 шт.

(при необходимости).

7.16. Штекер газовый для клапана отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более 4 шт. (при необходимости).

7.17. Устройство эжекторное для отвода наркогазов - не более 4 шт.

(при необходимости).

7.18. Сервисный клапан перекрытия магистрали - не более 5 шт. (при необходимости).

7.19. Регулятор вакуума - не более 4 шт. (при необходимости).

7.20. Контейнер-сборник с крышкой для аспирации - не более 4 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0102403

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17454

Лист 10

(при необходимости).

7.21. Корзина контейнера-сборника с крышкой для аспирации - не более 4 шт.

(при необходимости).

7.22. Комплект шлангов для аспирации - не более 4 шт. (при необходимости).

7.23. Контрольный манометр - не более 5 шт. (при необходимости).

7.24. Датчик давления - не более 5 шт. (при необходимости).

7.25. Разъём информационный видео/радио/телефон - не более 9 шт.

(при необходимости).

7.26. Кнопка вызова/сброса - не более 4 шт. (при необходимости).

7.27. Часы - не более 4 шт. (при необходимости).

7.28. Панель контроля газов со светозвуковой аварийной сигнализацией - не более 3 шт. (при необходимости).

7.29. Навесная приборная полка - не более 6 шт. (при необходимости).

7.30. Навесная приборная полка с ящиками - не более 6 шт. (при необходимости).

7.31. Полка для инфузоматов, секционная - не более 6 шт. (при необходимости).

7.32. Капельница с регулировкой высоты положения - не более 4 шт.

(при необходимости).

7.33. Штатив инфузионный - не более 4 шт. (при необходимости).

7.34. Лампа местного освещения с изменяемой геометрией - не более 4 шт.

(при необходимости).

7.35. Корзина для материалов - не более 4 шт. (при необходимости).

7.36. Крепежный комплект - 1 шт.

7.37. Руководство по эксплуатации.

8. Консоль медицинская для распределения медицинских газов и электропитания с напольным креплением, варианты исполнения: ОЗОН МК-НО-800-НП, ОЗОН МК-НО-1200-НП, ОЗОН МК-НО-1600-НП, ОЗОН МК-НО-2000-НП, ОЗОН МК-НД-600-НП, ОЗОН МК-НД-800-НП, ОЗОН МК-НД-1000-НП, ОЗОН МК-НД-1200-НП, ОЗОН МК-НД-1600-НП, ОЗОН МК-НД-2000-НП, ОЗОН МК-НД-2500-НП, ОЗОН МК-НД-3000-НП, ОЗОН МК-НД-3200-НП, ОЗОН МК-НД-4000-НП - 1 шт., в составе:

8.1. Колонка консоли - 1 шт.

8.2. Клапан газовый быстроразъемный - не более 36 шт.

8.3. Штекер газовый быстроразъемного клапана - не более 36 шт.

8.4. Электрические розетки - не более 38 шт.

8.5. Автоматические выключатели - не более 10 шт.

8.6. Индикатор наличия питания - не более 10 шт.

8.7. Клемма заземления - не более 10 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0102404

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 июня 2022 года


№ РЗН 2022/17454

Лист 11

- 8.8. Клемма уравнивания потенциалов - не более 10 шт.
- 8.9. Крепление напольное - 1 шт.
- 8.10. Крепежный рельс для навесного оборудования - не более 20 шт.
(при необходимости).
- 8.11. Кронштейн для навесного оборудования - не более 6 шт. (при необходимости).
- 8.12. Кронштейн для монитора - не более 6 шт. (при необходимости).
- 8.13. Клапан пневмопривода типа AirMotor - не более 6 шт. (при необходимости).
- 8.14. Штекер газовый для клапана пневмопривода типа AirMotor - не более 6 шт.
(при необходимости).
- 8.15. Клапан отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более 6 шт.
(при необходимости).
- 8.16. Штекер газовый для клапана отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более
6 шт. (при необходимости).
- 8.17. Устройство эжекторное для отвода наркогазов - не более 6 шт.
(при необходимости).
- 8.18. Сервисный клапан перекрытия магистрали - не более 5 шт. (при необходимости).
- 8.19. Регулятор вакуума - не более 6 шт. (при необходимости).
- 8.20. Контейнер-сборник с крышкой для аспирации - не более 6 шт.
(при необходимости).
- 8.21. Корзина контейнера-сборника с крышкой для аспирации - не более 6 шт.
(при необходимости).
- 8.22. Комплект шлангов для аспирации - не более 6 шт. (при необходимости).
- 8.23. Контрольный манометр - не более 5 шт. (при необходимости).
- 8.24. Датчик давления - не более 5 шт. (при необходимости).
- 8.25. Разъем информационный видео/радио/телефон - не более 12 шт.
(при необходимости).
- 8.26. Кнопка вызова/сброса - не более 6 шт. (при необходимости).
- 8.27. Регулятор освещения - не более 8 шт. (при необходимости).
- 8.28. Выключатель электрический - не более 8 шт. (при необходимости).
- 8.29. Часы - не более 6 шт. (при необходимости).
- 8.30. Панель контроля газов со светозвуковой аварийной сигнализацией - не более
5 шт. (при необходимости).
- 8.31. Светильник - не более 8 шт. (при необходимости).
- 8.32. Навесная приборная полка - не более 8 шт. (при необходимости).
- 8.33. Навесная приборная полка с ящиками - не более 8 шт. (при необходимости).
- 8.34. Навесная тумба с ящиками - не более 8 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

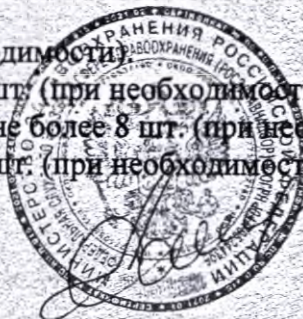

0102405

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17454

Лист 12

- 8.35. Полка для инфузоматов, секционная - не более 8 шт. (при необходимости).
8.36. Подвесная подвижная тележка с полками - не более 6 шт. (при необходимости).
8.37. Капельница с регулировкой высоты положения - не более 8 шт.
(при необходимости).
8.38. Штатив инфузионный - не более 8 шт. (при необходимости).
8.39. Лампа местного освещения с изменяемой геометрией - не более 6 шт.
(при необходимости).
8.40. Корзина для материалов - не более 6 шт. (при необходимости).
8.41. Крепежный комплект - 1 шт.
8.42. Руководство по эксплуатации.
9. Консоль медицинская для распределения медицинских газов и электропитания с
настенным поворотным креплением, варианты исполнения: ОЗОН МК-НД-600-ОПН,
ОЗОН МК-НД-800-ОПН, ОЗОН МК-НД-1000-ОПН, ОЗОН МК-НД-1200-ОПН, ОЗОН
МК-НД-1600-ОПН, ОЗОН МК-НД-2000-ОПН - 1 шт., в составе:
9.1. Колонка консоли - 1 шт.
9.2. Клапан газовый быстроразъемный - не более 20 шт.
9.3. Штекер газовый быстроразъемного клапана - не более 20 шт.
9.4. Электрические розетки - не более 22 шт.
9.5. Автоматические выключатели - не более 5 шт.
9.6. Индикатор наличия питания - не более 5 шт.
9.7. Клемма заземления - не более 5 шт.
9.8. Клемма уравнивания потенциалов - не более 5 шт.
9.9. Крепление настенное поворотное - 1 шт.
9.10. Крепежный рельс для навесного оборудования - не более 12 шт.
(при необходимости).
9.11. Кронштейн для навесного оборудования - не более 4 шт. (при необходимости).
9.12. Кронштейн для монитора - не более 4 шт. (при необходимости).
9.13. Клапан пневмопривода типа AirMotor - не более 4 шт. (при необходимости).
9.14. Штекер газовый для клапана пневмопривода типа AirMotor - не более 4 шт.
(при необходимости).
9.15. Клапан отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более 4 шт.
(при необходимости).
9.16. Штекер газовый для клапана отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более
4 шт. (при необходимости).
9.17. Устройство эжекторное для отвода наркогазов - не более 4 шт.
(при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

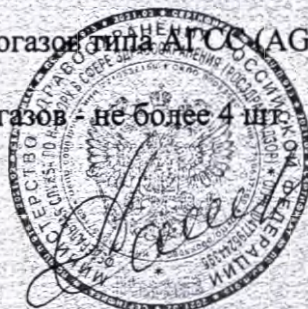

А.В. Самойлова

0102406

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17454

Лист 13

- 9.18. Сервисный клапан перекрытия магистрали - не более 5 шт. (при необходимости).
- 9.19. Регулятор вакуума - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.20. Контейнер-сборник с крышкой для аспирации - не более 4 шт.
(при необходимости).
- 9.21. Корзина контейнера-сборника с крышкой для аспирации - не более 4 шт.
(при необходимости).
- 9.22. Комплект шлангов для аспирации - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.23. Контрольный манометр - не более 5 шт. (при необходимости).
- 9.24. Датчик давления - не более 5 шт. (при необходимости).
- 9.25. Разъём информационный видео/радио/телефон - не более 8 шт.
(при необходимости).
- 9.26. Кнопка вызова/сброса - не более 2 шт. (при необходимости).
- 9.27. Часы - не более 3 шт. (при необходимости).
- 9.28. Панель контроля газов со светозвуковой аварийной сигнализацией - не более 2 шт. (при необходимости).
- 9.29. Навесная приборная полка - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.30. Навесная приборная полка с ящиками - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.31. Навесная тумба с ящиками - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.32. Полка для инфузоматов, секционная - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.33. Подвесная подвижная тележка с полками - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.34. Капельница с регулировкой высоты положения - не более 4 шт.
(при необходимости).
- 9.35. Штатив инфузионный - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.36. Лампа местного освещения с изменяемой геометрией - не более 4 шт.
(при необходимости).
- 9.37. Корзина для материалов - не более 4 шт. (при необходимости).
- 9.38. Крепежный комплект - 1 шт.
- 9.39. Руководство по эксплуатации.
- 10. Консоль медицинская для распределения медицинских газов и электропитания
настенная ОЗОН МК-ГК-800-Н, в составе:
 - 10.1. Колонка консоли - 1 шт.
 - 10.2. Крепление настенное - 1 шт.
 - 10.3. Клапан газовый быстроразъемный - не более 6 шт.
 - 10.4. Штекер газовый быстроразъемного клапана - не более 6 шт.
 - 10.5. Клапан отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более 2 шт.
(при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0102407

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17454

Лист 14

- 10.6. Штекер газовый для клапана отвода наркогазов типа АГСС (AGSS) - не более 2 шт. (при необходимости).
10.7. Крепежный комплект - 1 шт.
10.8. Руководство по эксплуатации.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0102408