



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БАЛТТЕКС»

 В.К. Кулаков

"12" июля 2021г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


«Сканер интраоральный TRIOS® 3 в вариантах исполнения»,


3Shape Trios A/S (3Шейп Триос А/С), Дания


Оглавление


1. Модель TRIOS® 3 S1P (переносная), в комплектации:	3
1.1. Сканер интраоральный TRIOS® 3 без ручки.	5
1.2. Кабель питания.	6
1.3. Сетевой адаптер.	7
1.4. Модуль POD – блок обработки изображений.	8
1.5. Сканирующие насадки TRIOS® 3– до 5 шт.	10
1.6. Защитная насадка TRIOS® 3.	12
1.7. Насадка для 3D-калибровки TRIOS® 3.	14
1.8. Набор для калибровки определения цвета TRIOS® 3.	15
1.9. Соединительный Ethernet кабель (1 метр).	17
1.10. Адаптер USB-Ethernet (для подключения сканера к компьютеру).	19
1.11. USB диск с инструкцией по применению.	20
1.12. USB ключ доступа без ПО.	22
2. Модель TRIOS® 3 S1A (мобильный стенд), в комплектации:	23
1.1. Сканер интраоральный TRIOS® 3 с ручкой.	25
1.2. Модуль Cart на колесах с multi-touch монитором, беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth, проводным соединениями USB и Ethernet, интегрированным высокопроизводительным процессором, оптимизированным для 3D сканирования.	27
1.3. Кабель питания.	28
1.4. Кабель LAN Network (5 метров).	29
1.5. Сканирующие насадки TRIOS® 3 - до 5 шт.	30
1.6. Защитная насадка TRIOS® 3.	32
1.7. Насадка для 3D-калибровки TRIOS® 3.	34
1.8. Набор для калибровки определения цвета TRIOS® 3.	35
1.9. USB диск с инструкцией по применению.	37
1.10. USB ключ активации сканера.	39

1. Модель TKIOS-5 STP (переносная), в комплектации:

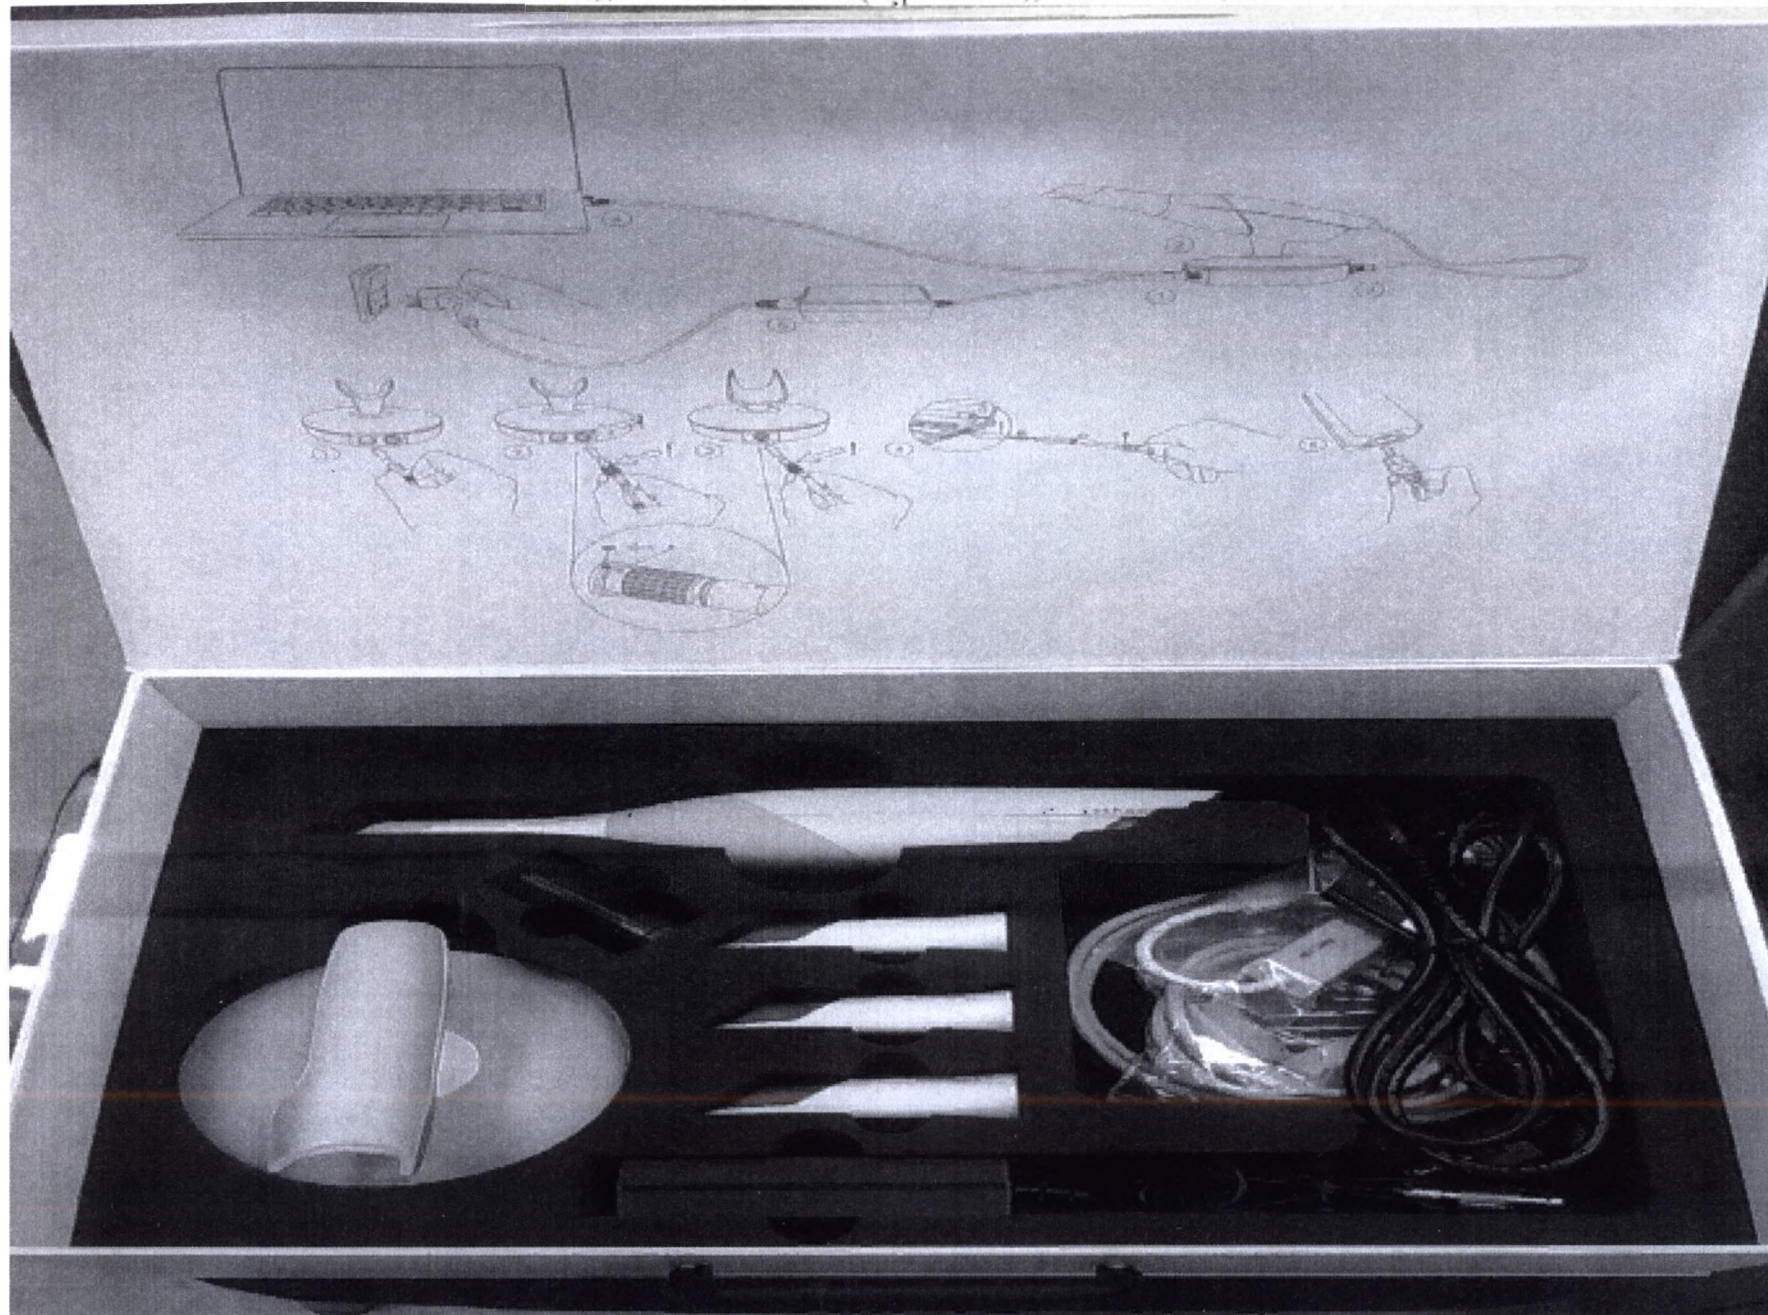

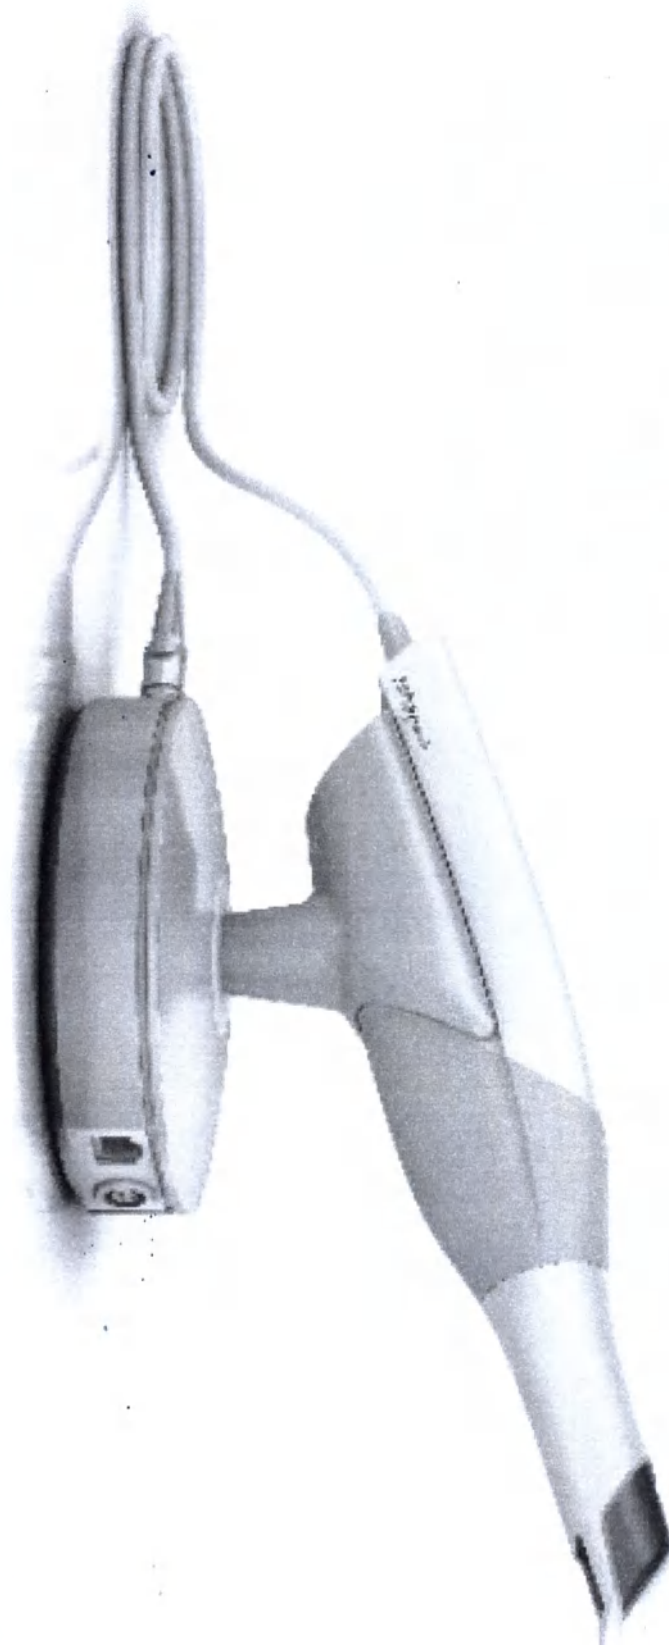


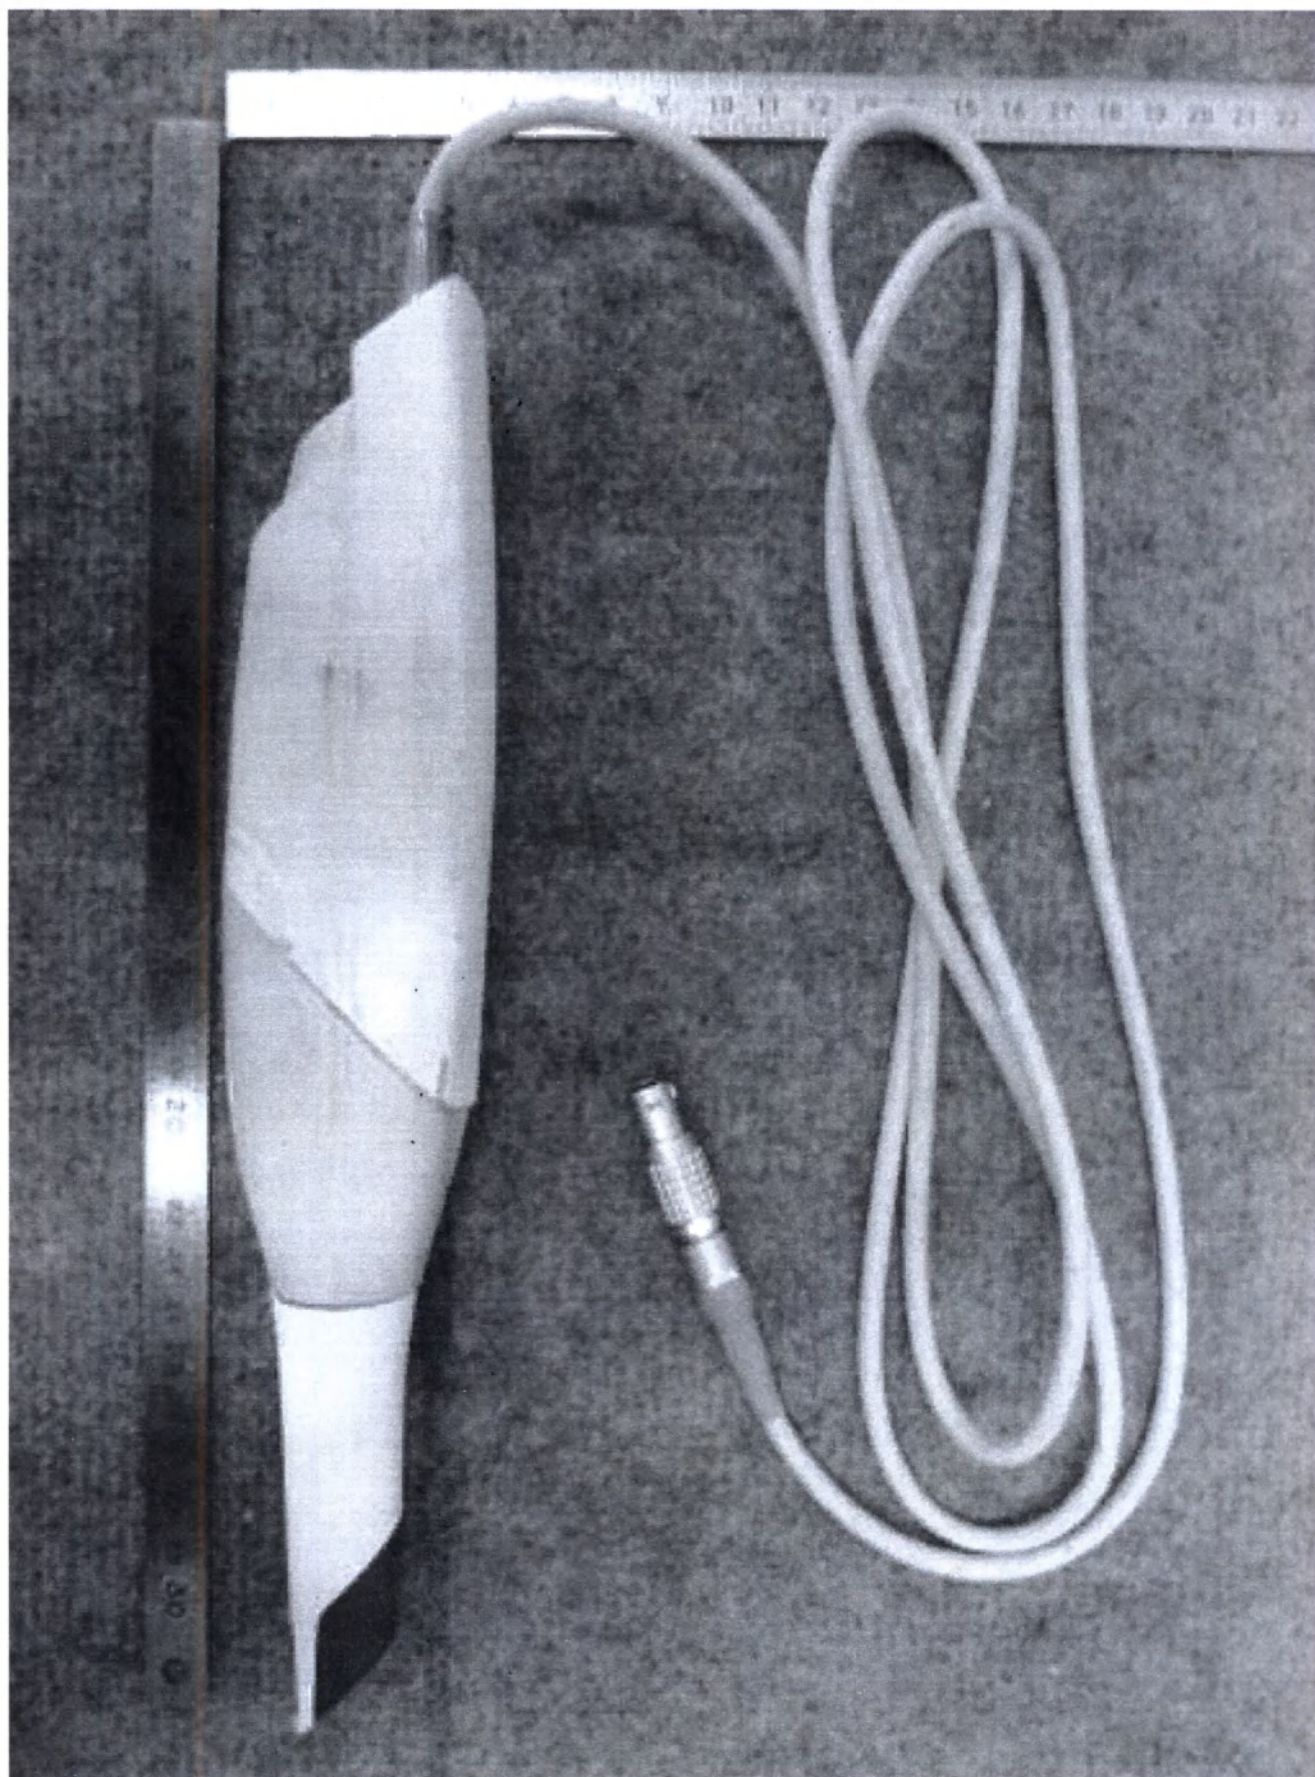


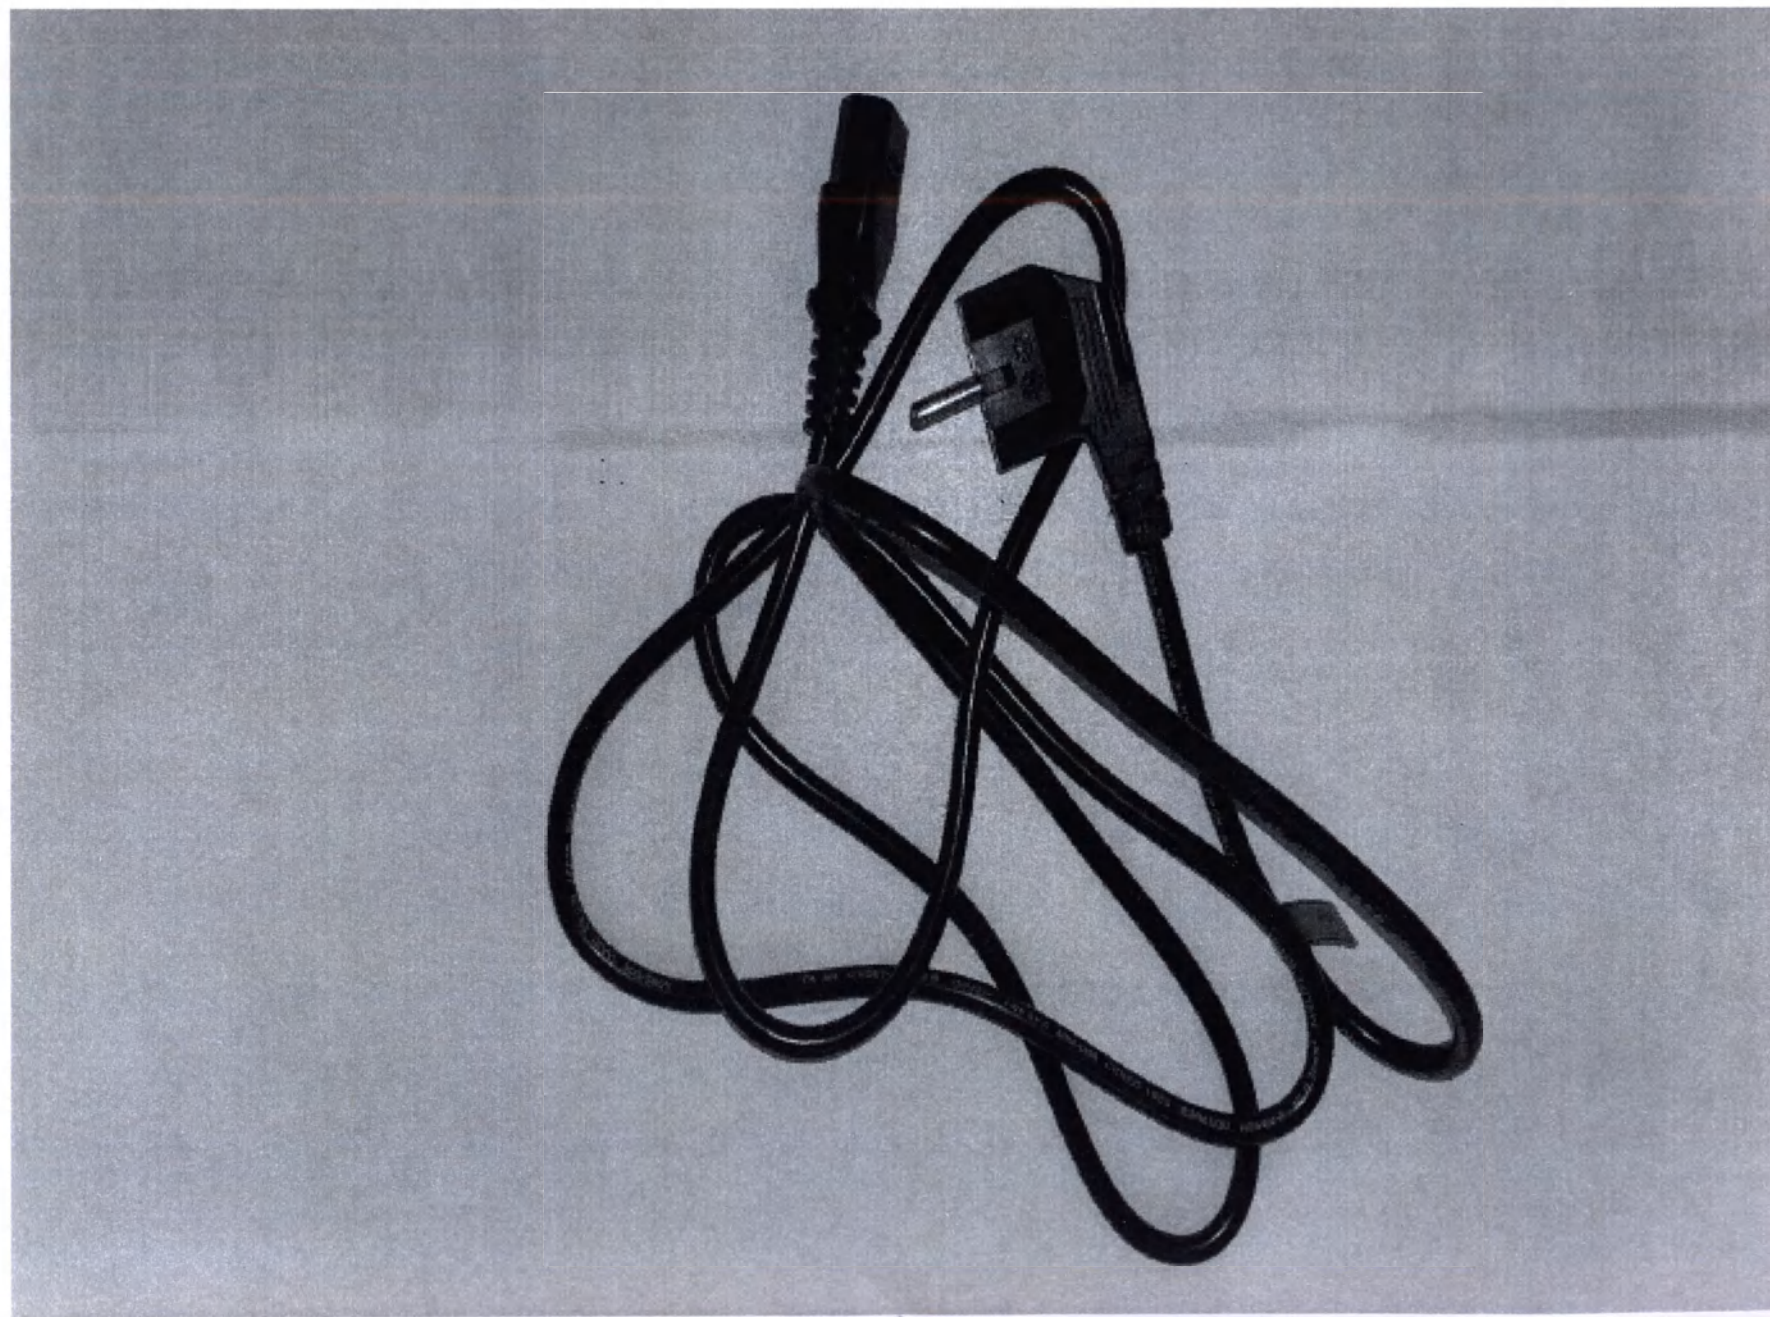


1.2. Кабель питания.

1.3. Сетевой адаптер.

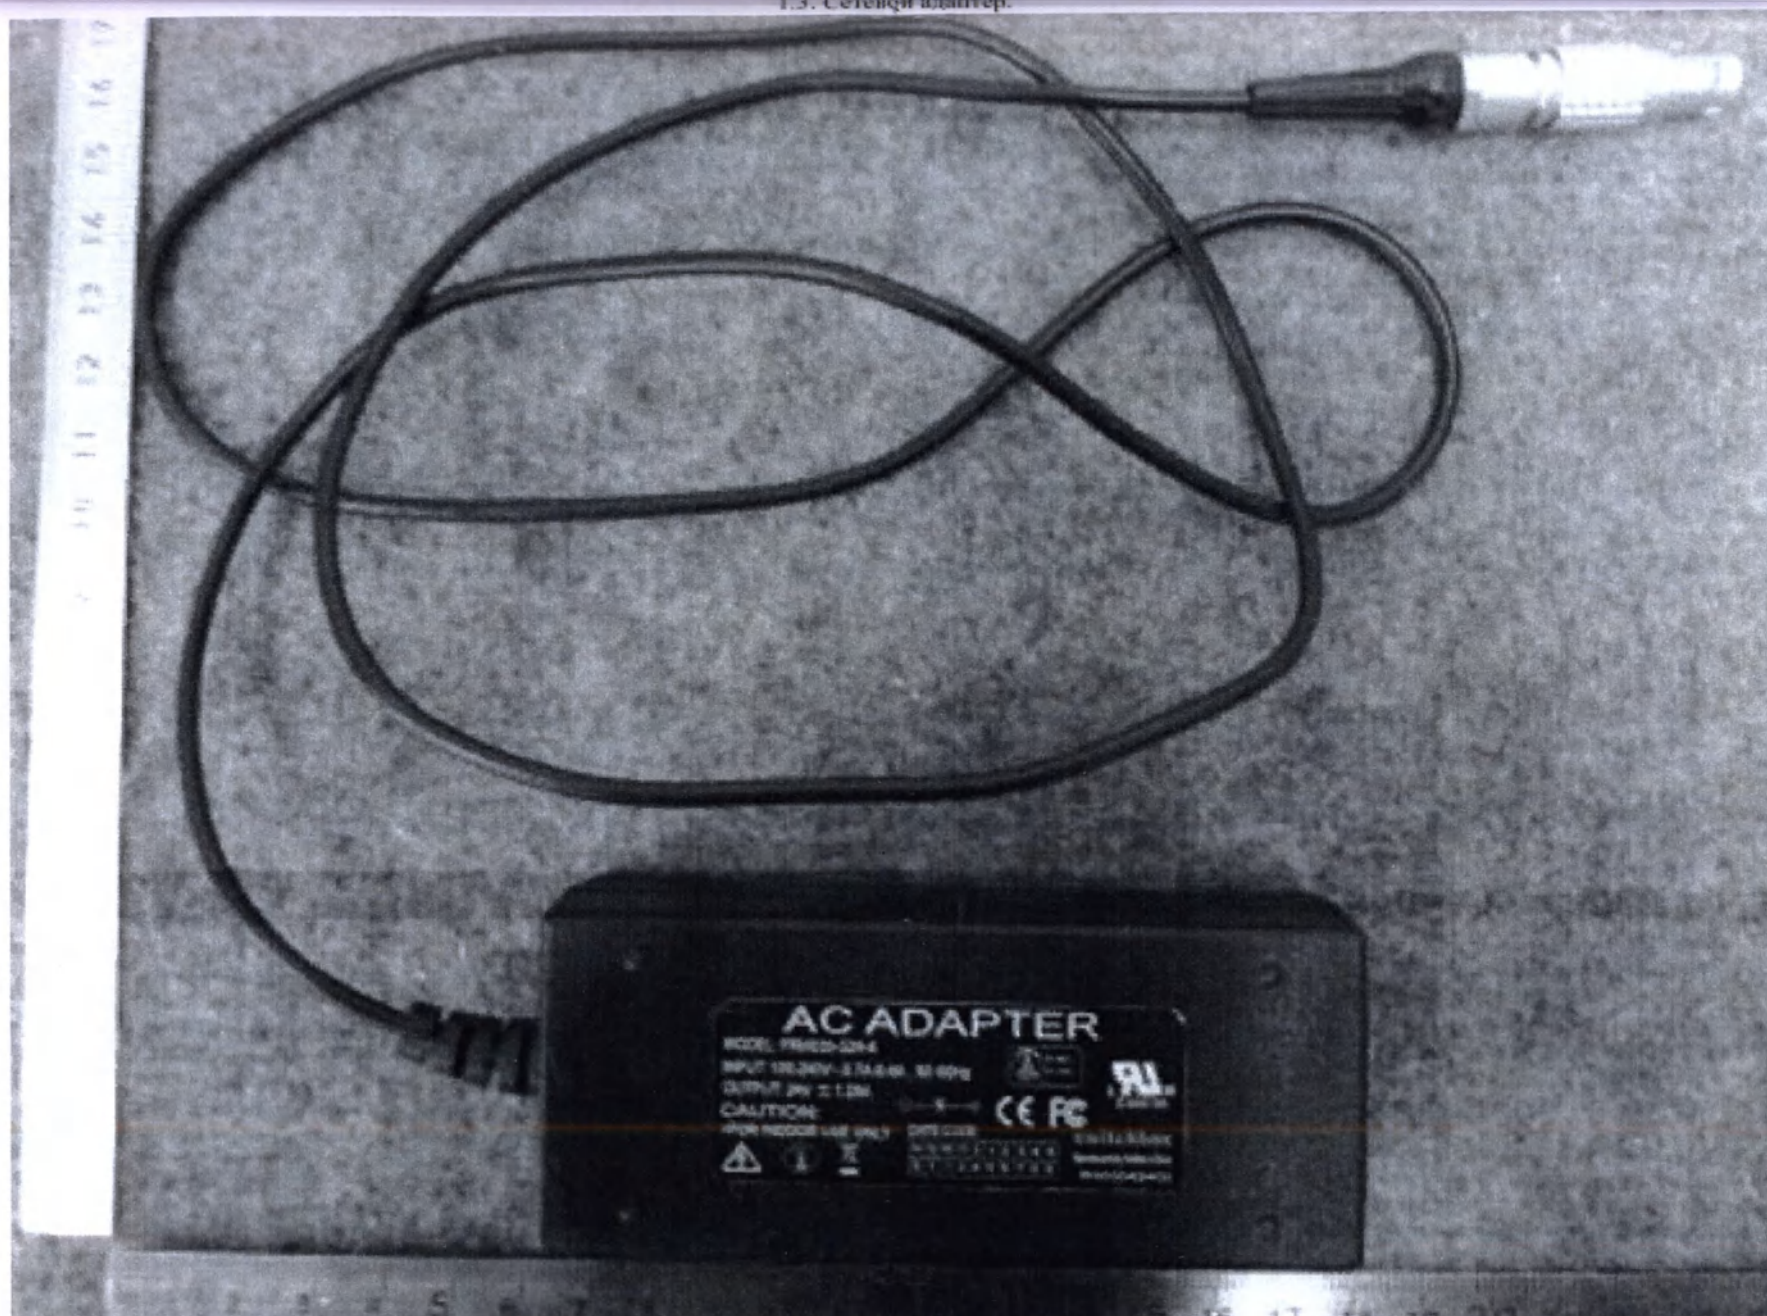


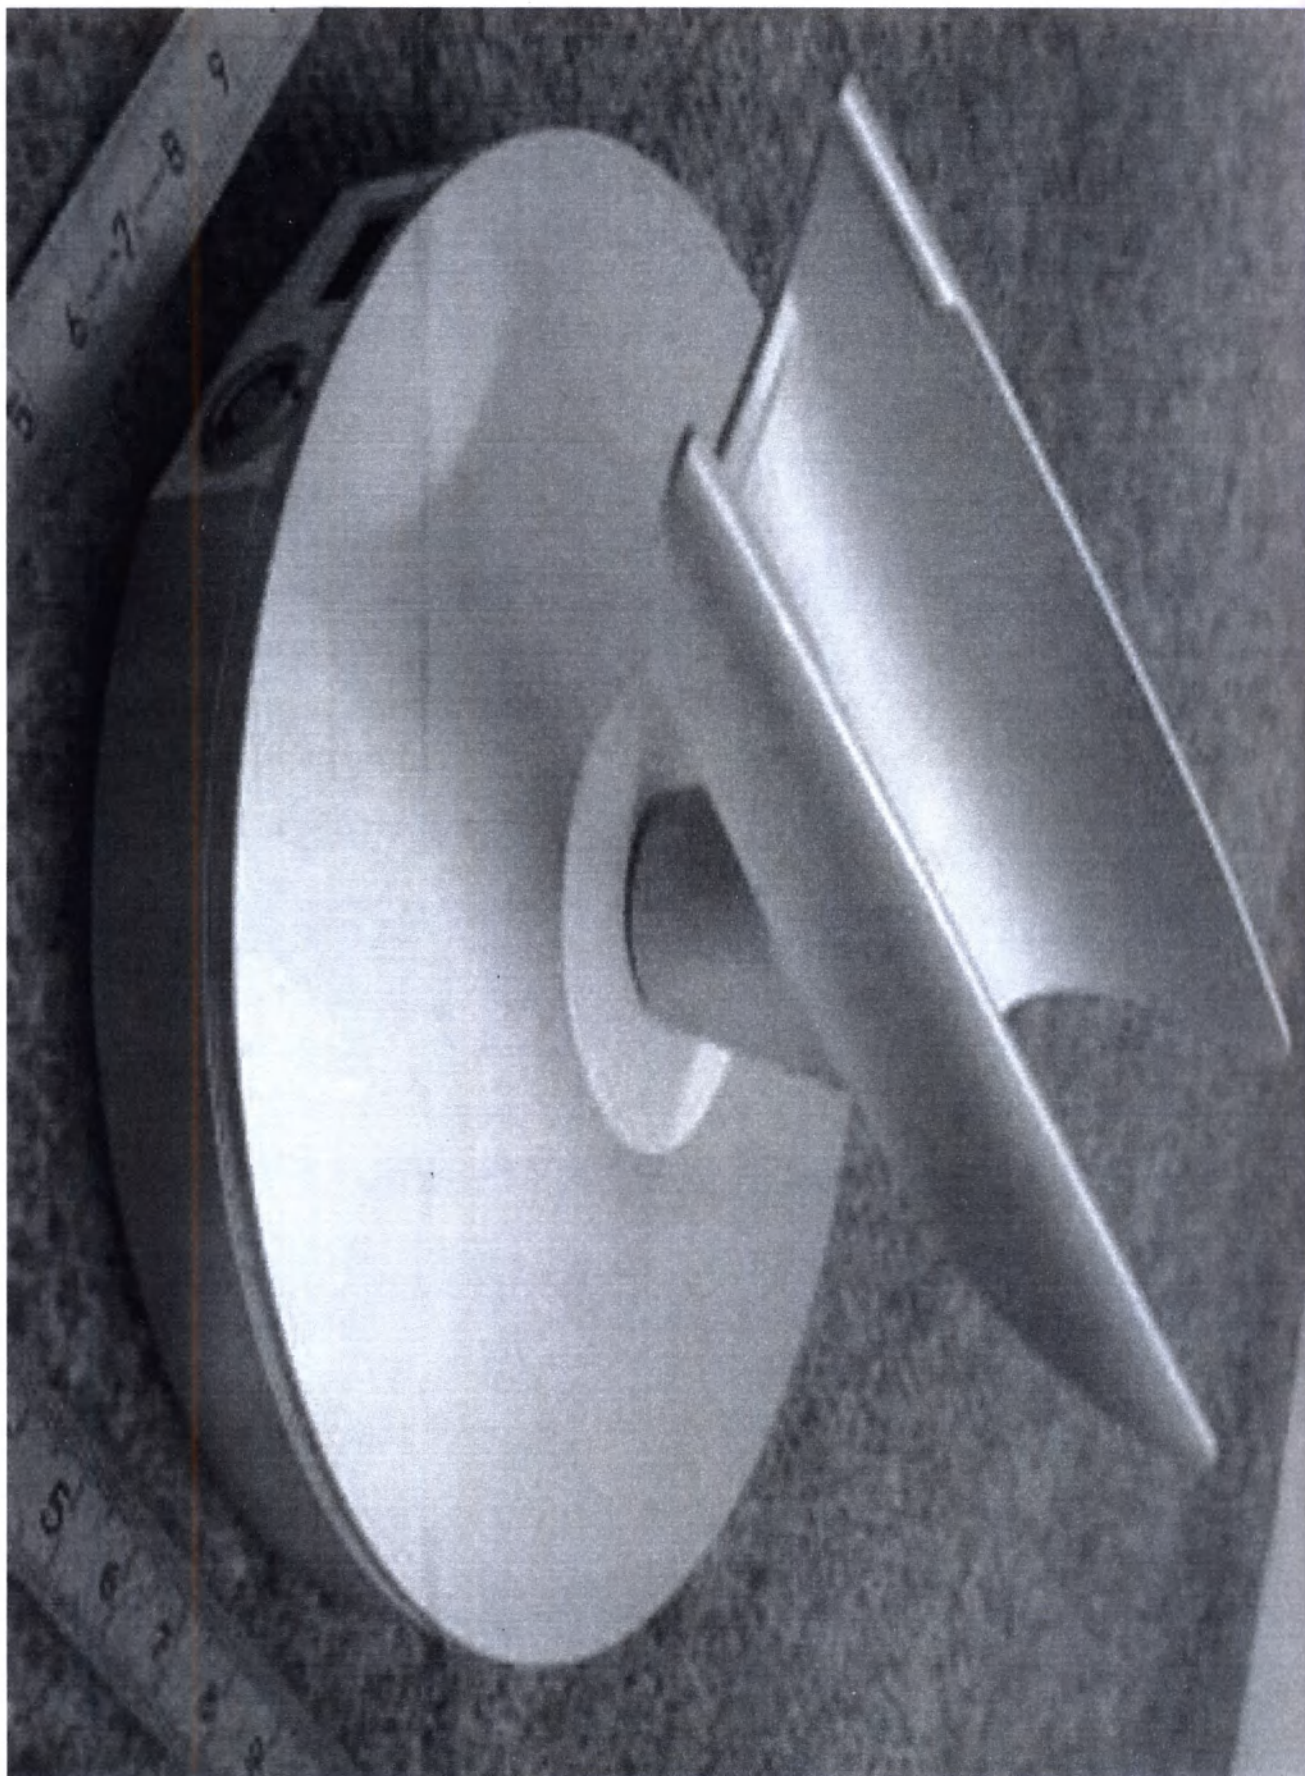

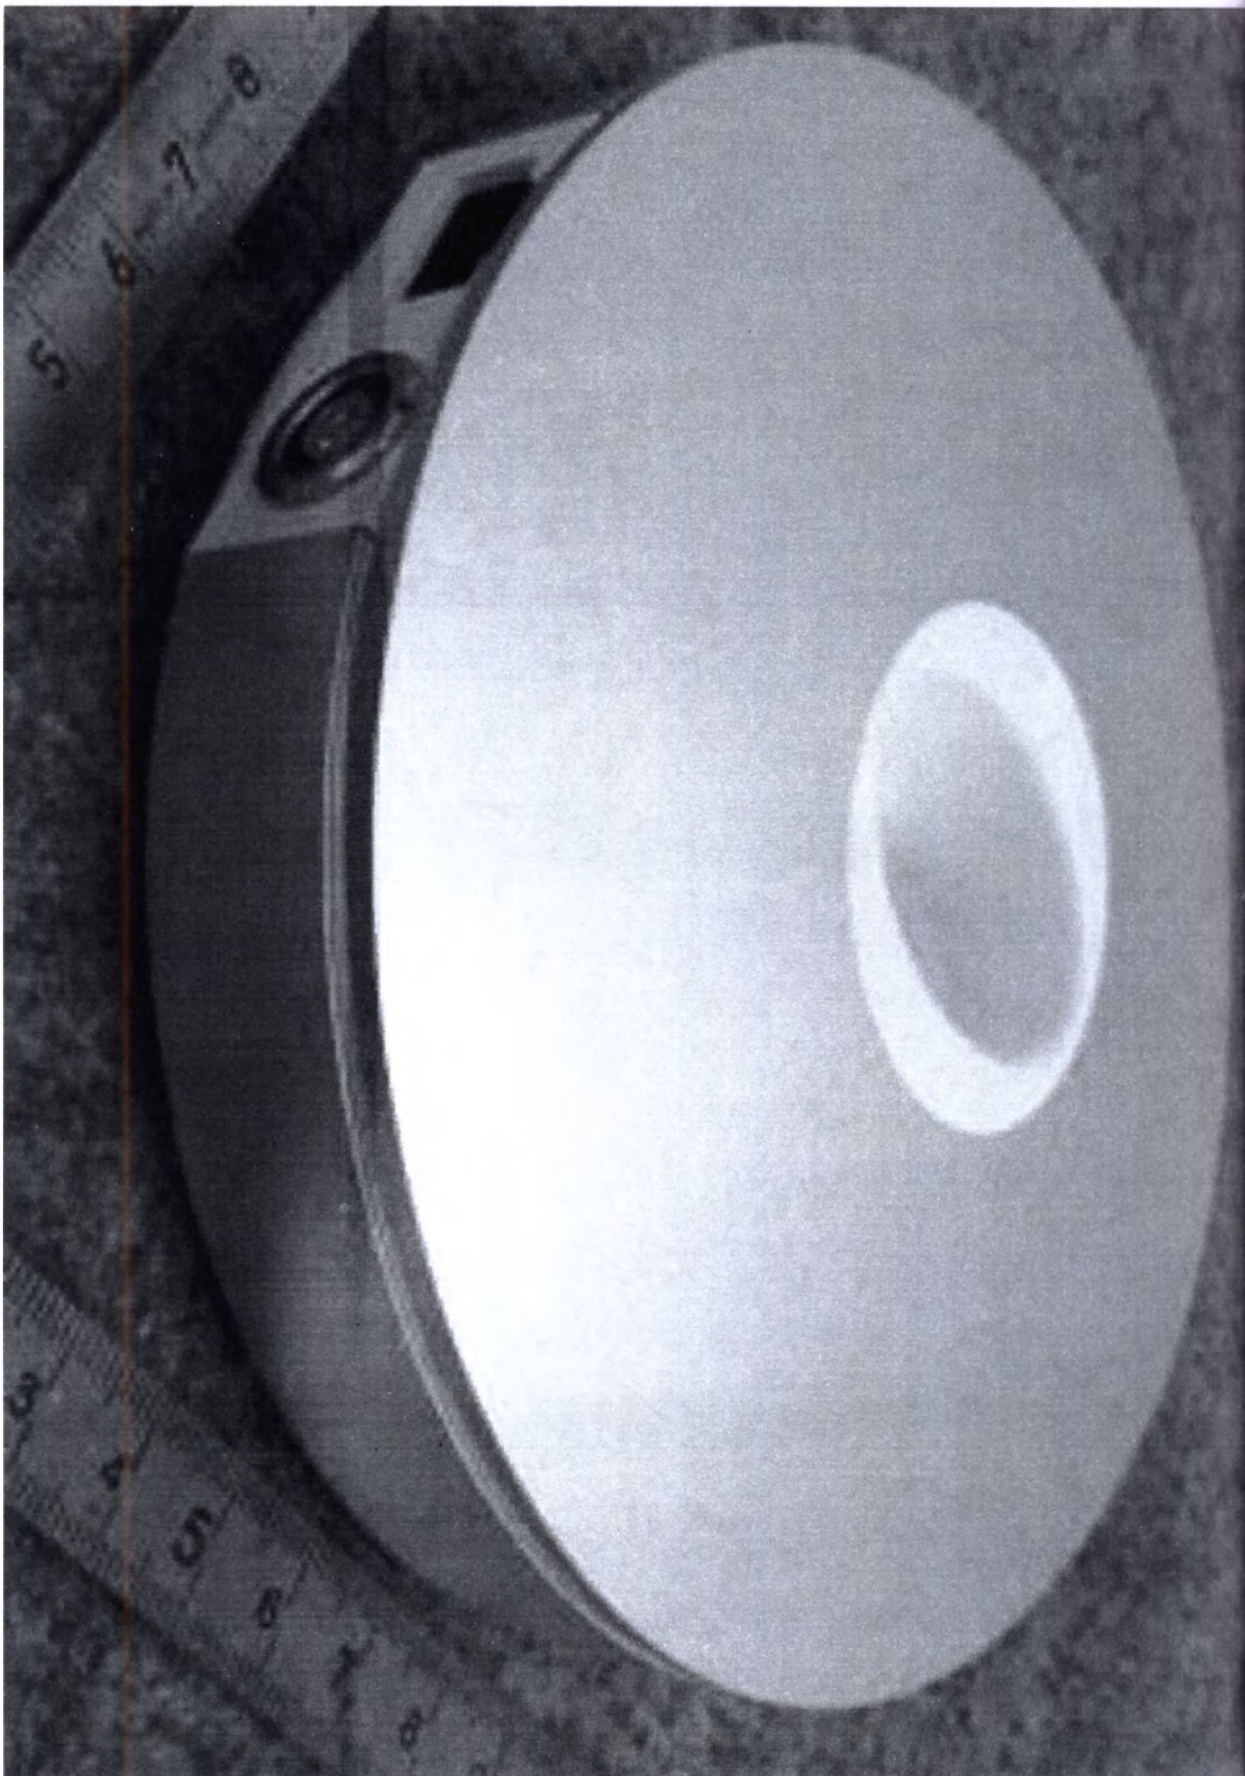




1.3. Комплектное изделие TRIOS 3-го поколения

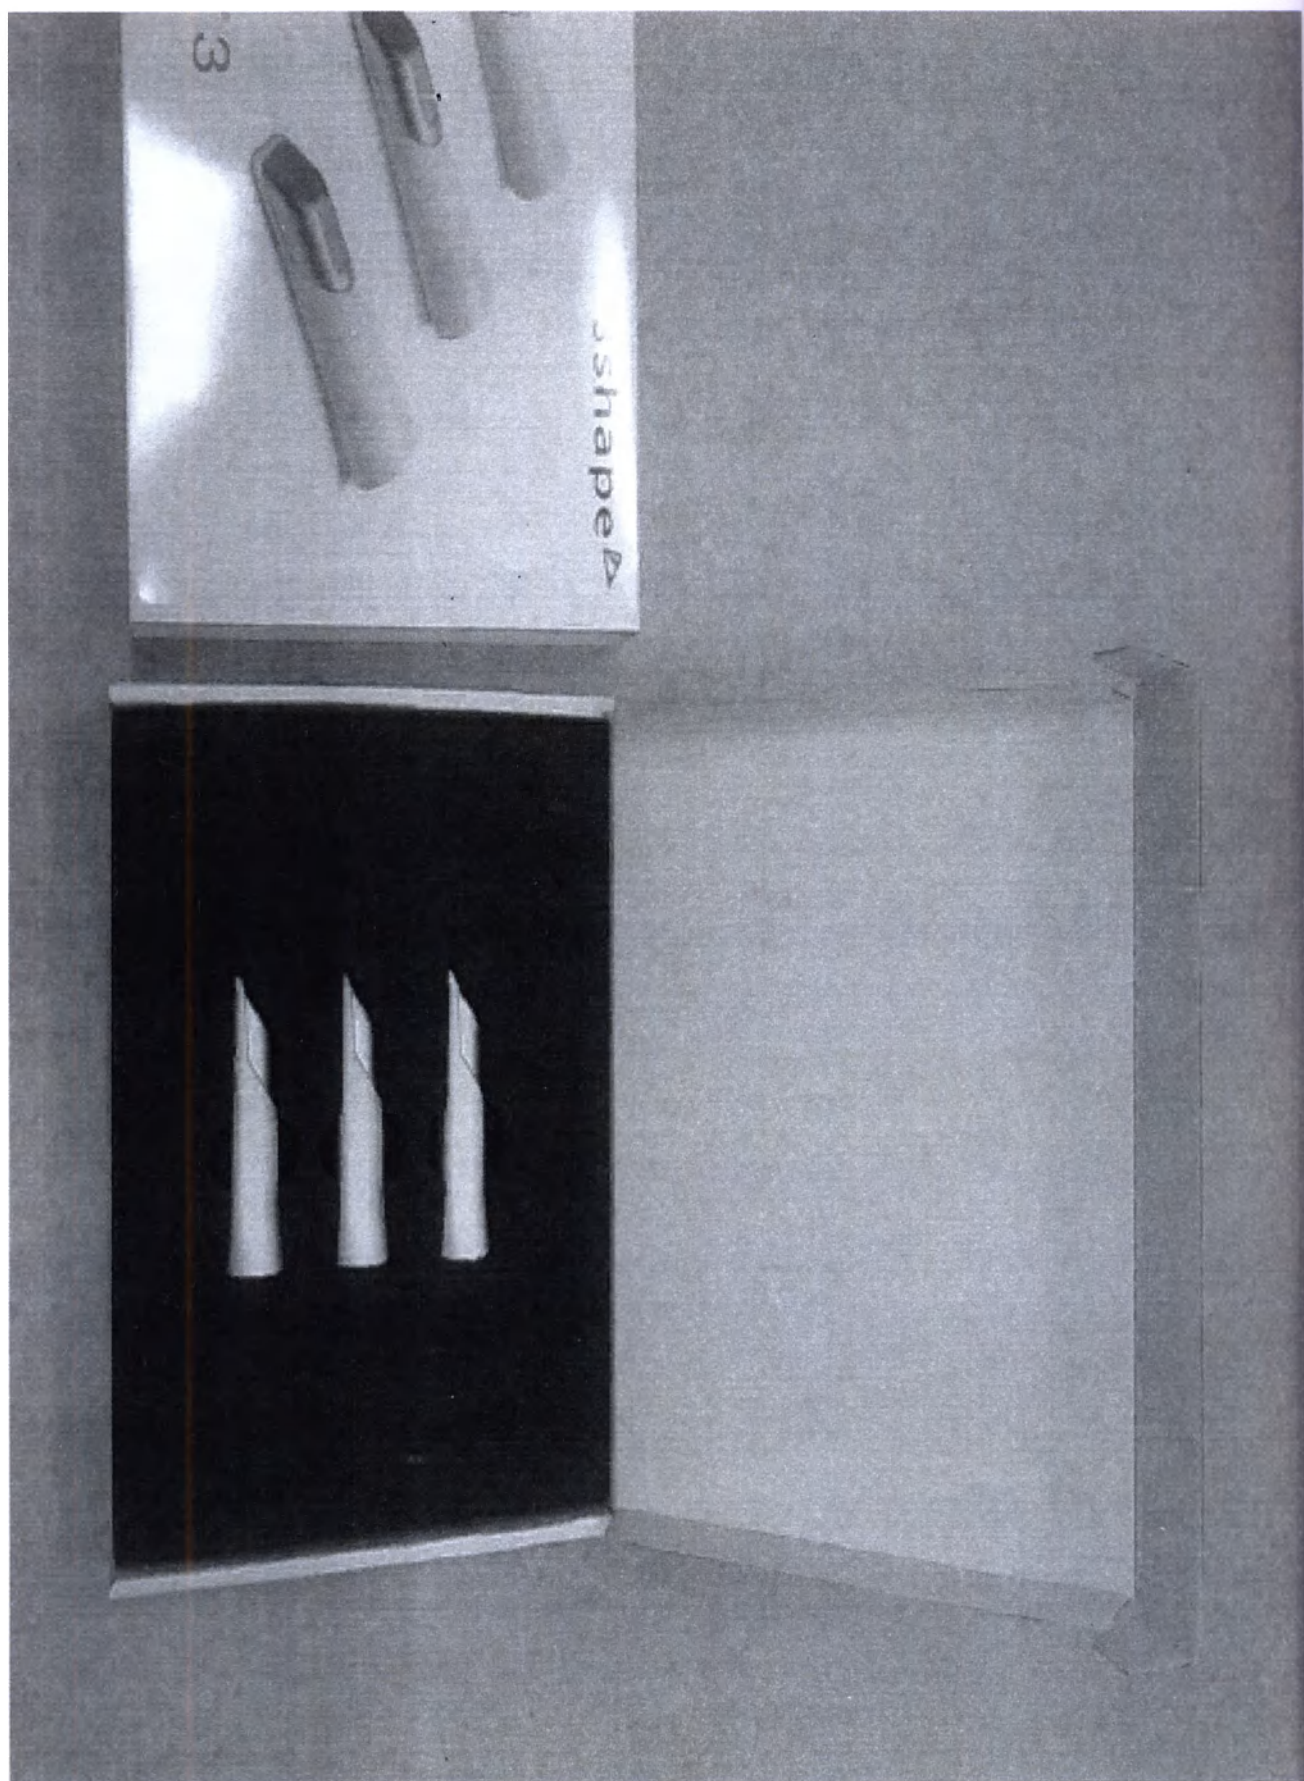





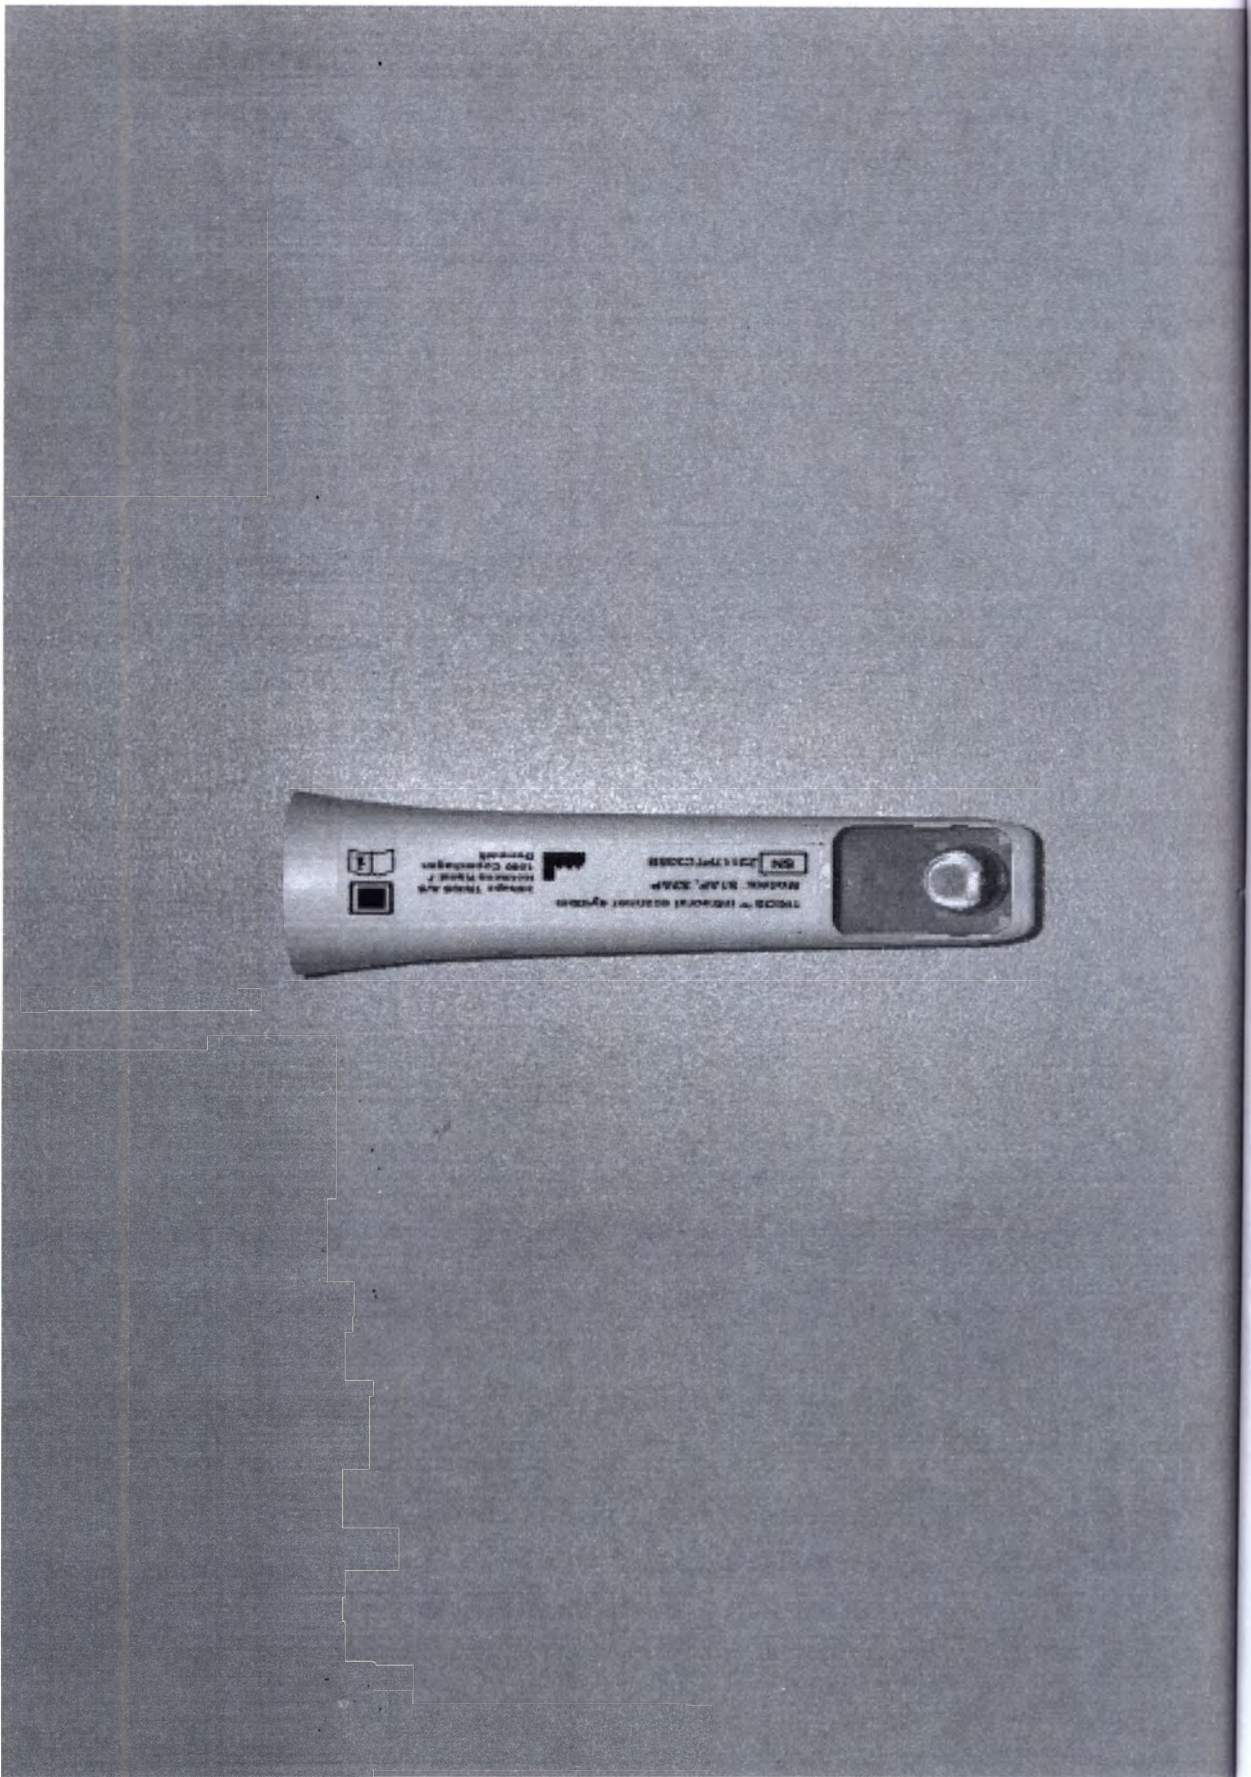







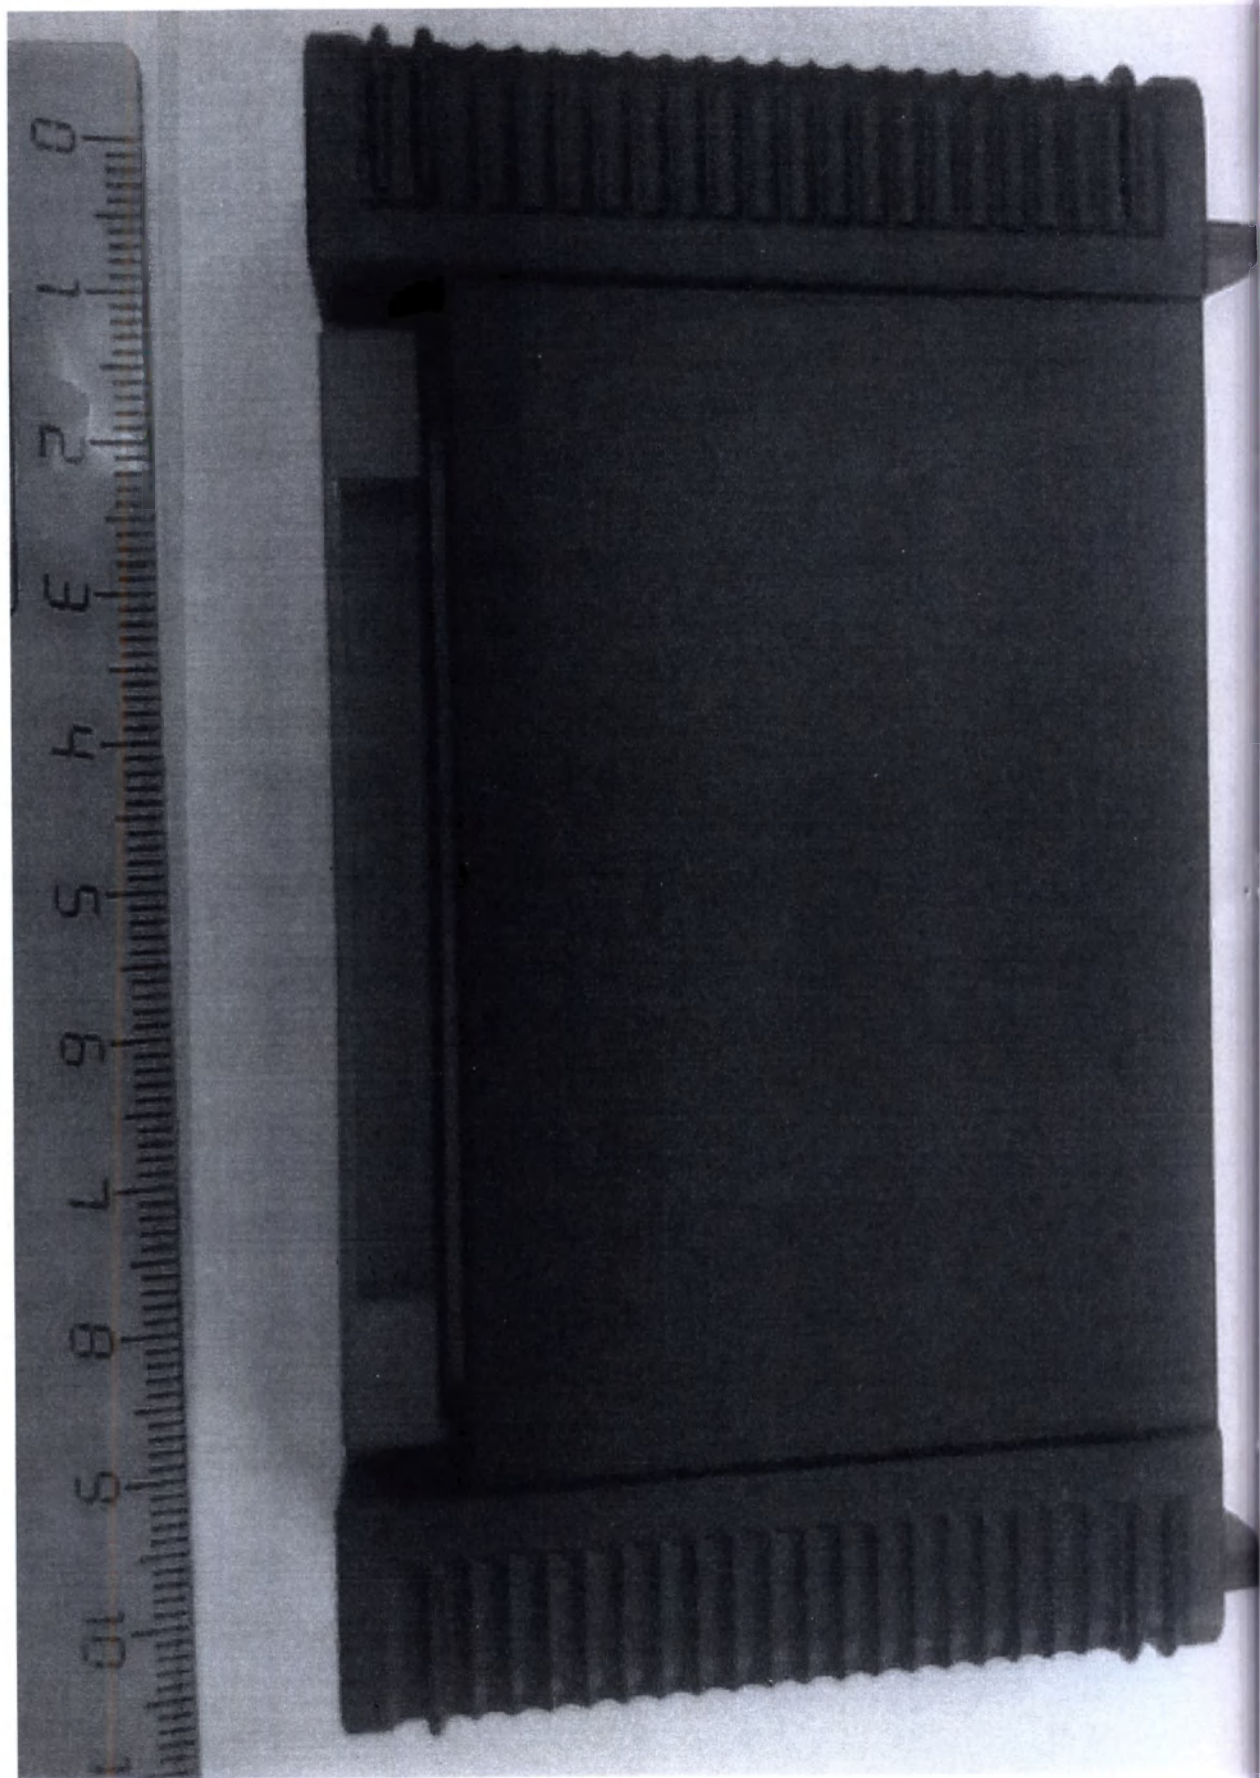

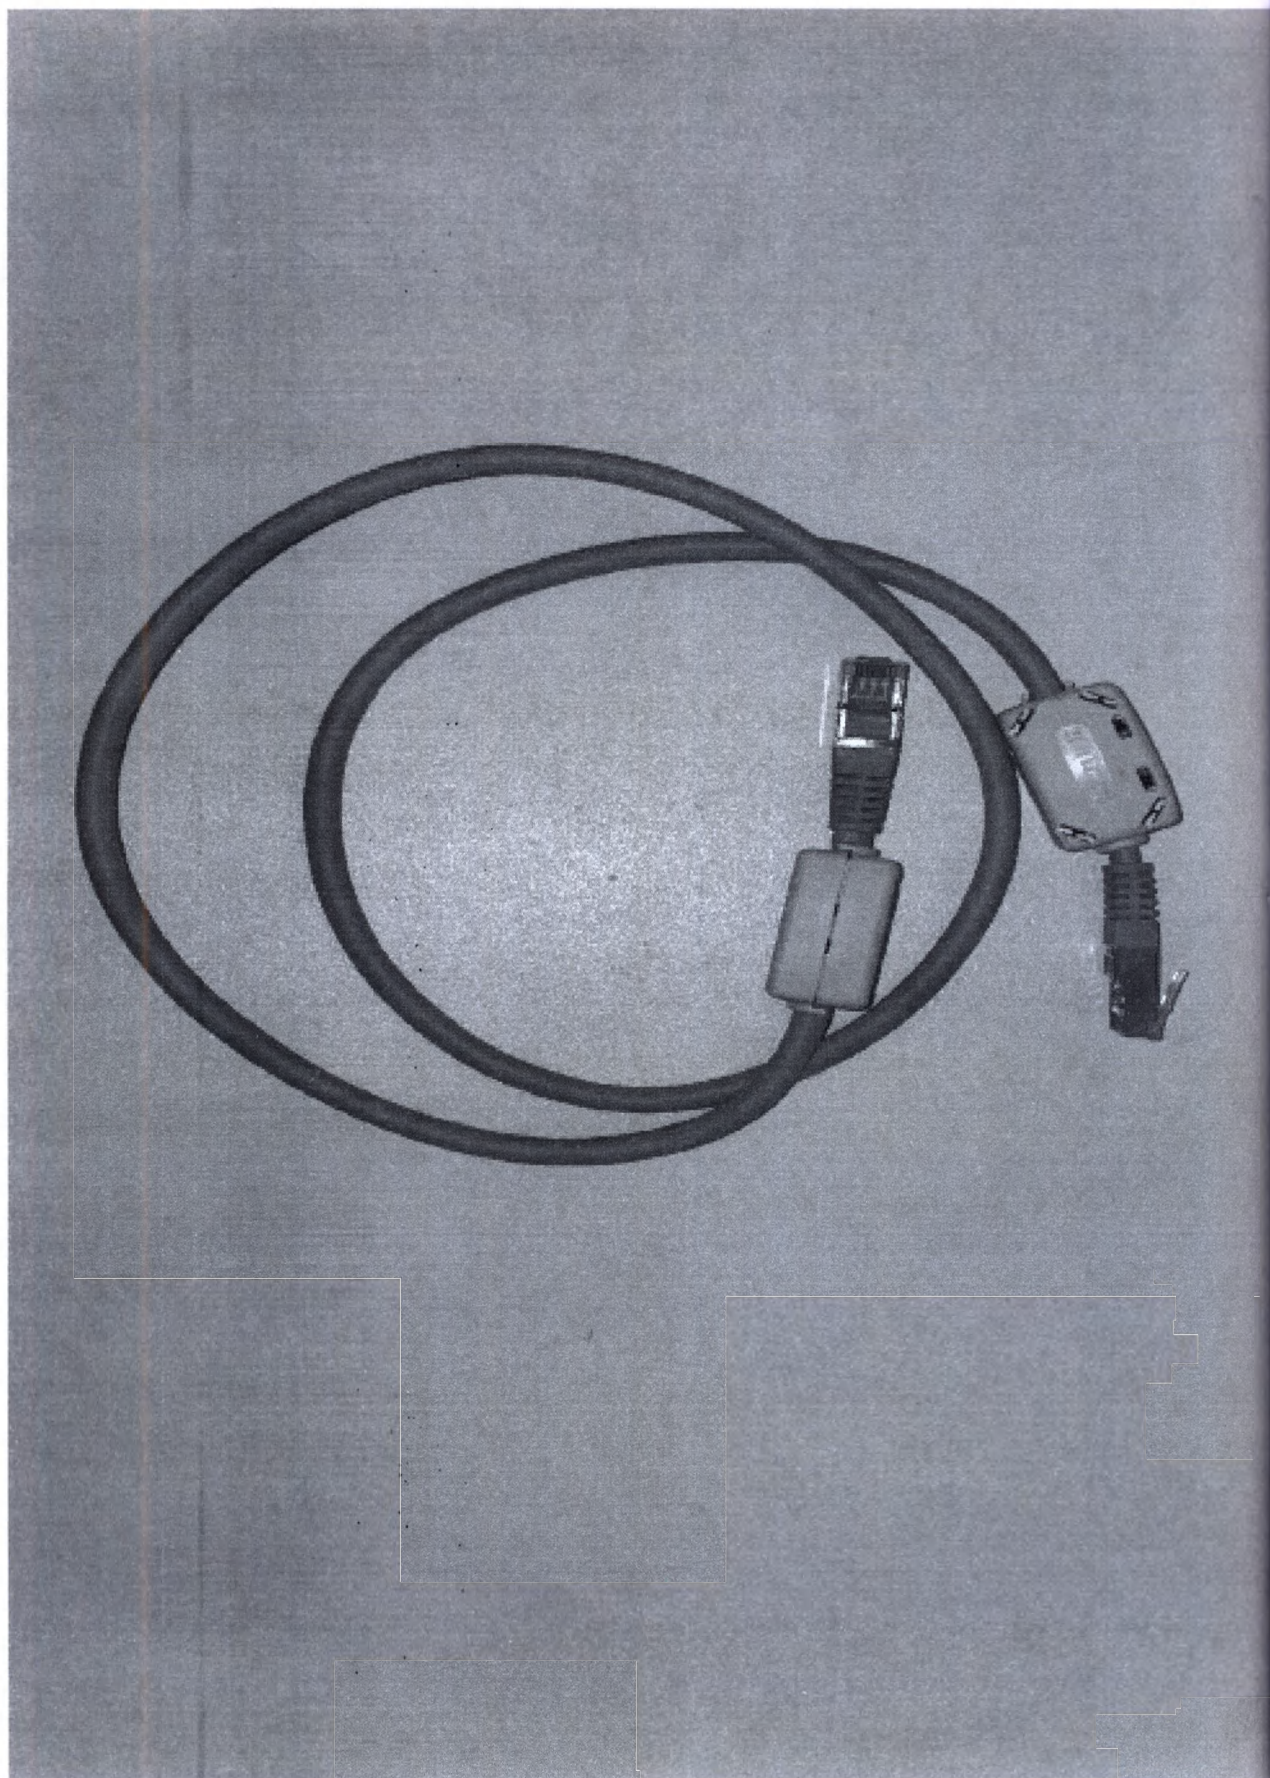

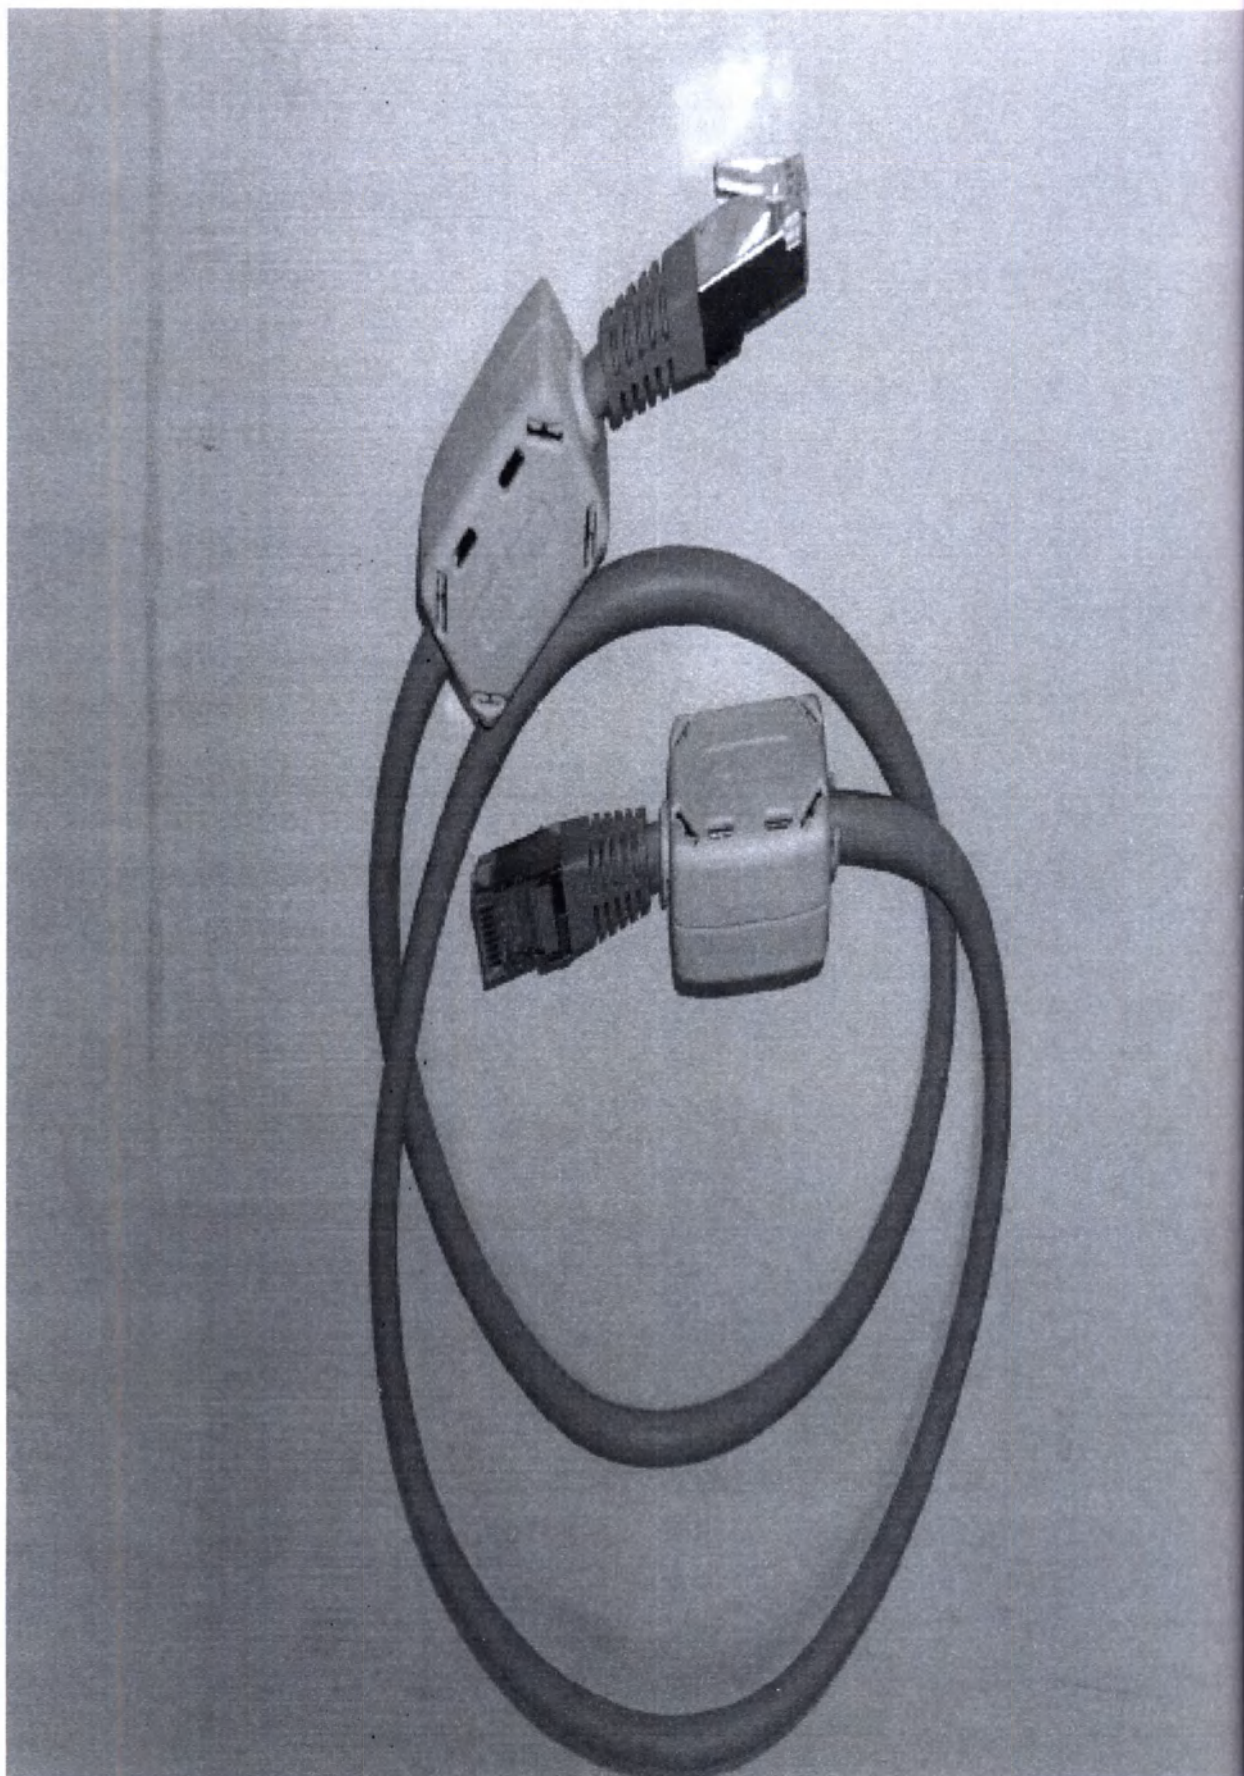

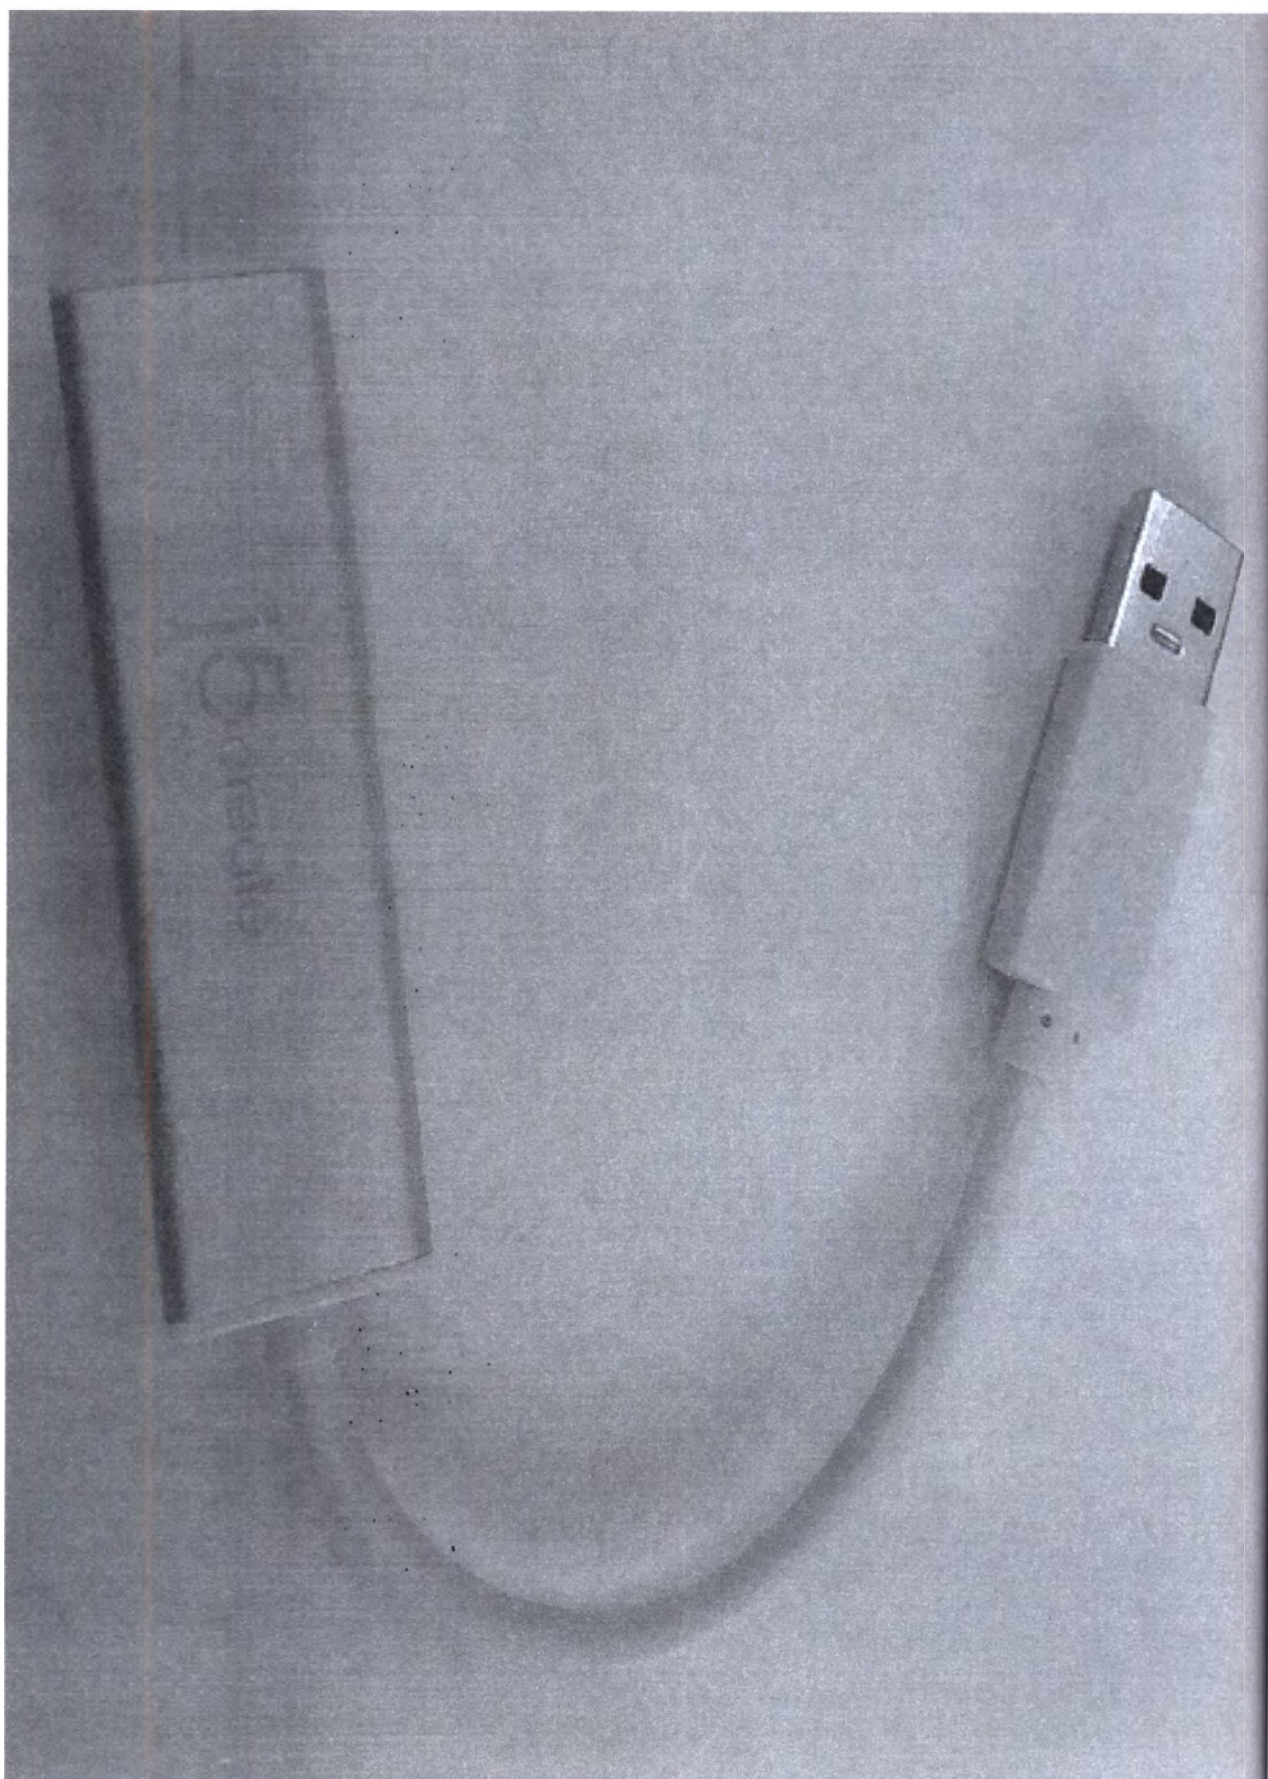

3Shape TRIOS



3Shape


3Shape TRIOS




3Shape TRIOS





2. Модель TRIOS® 3 S1A (мобильный стенд), в комплектации:

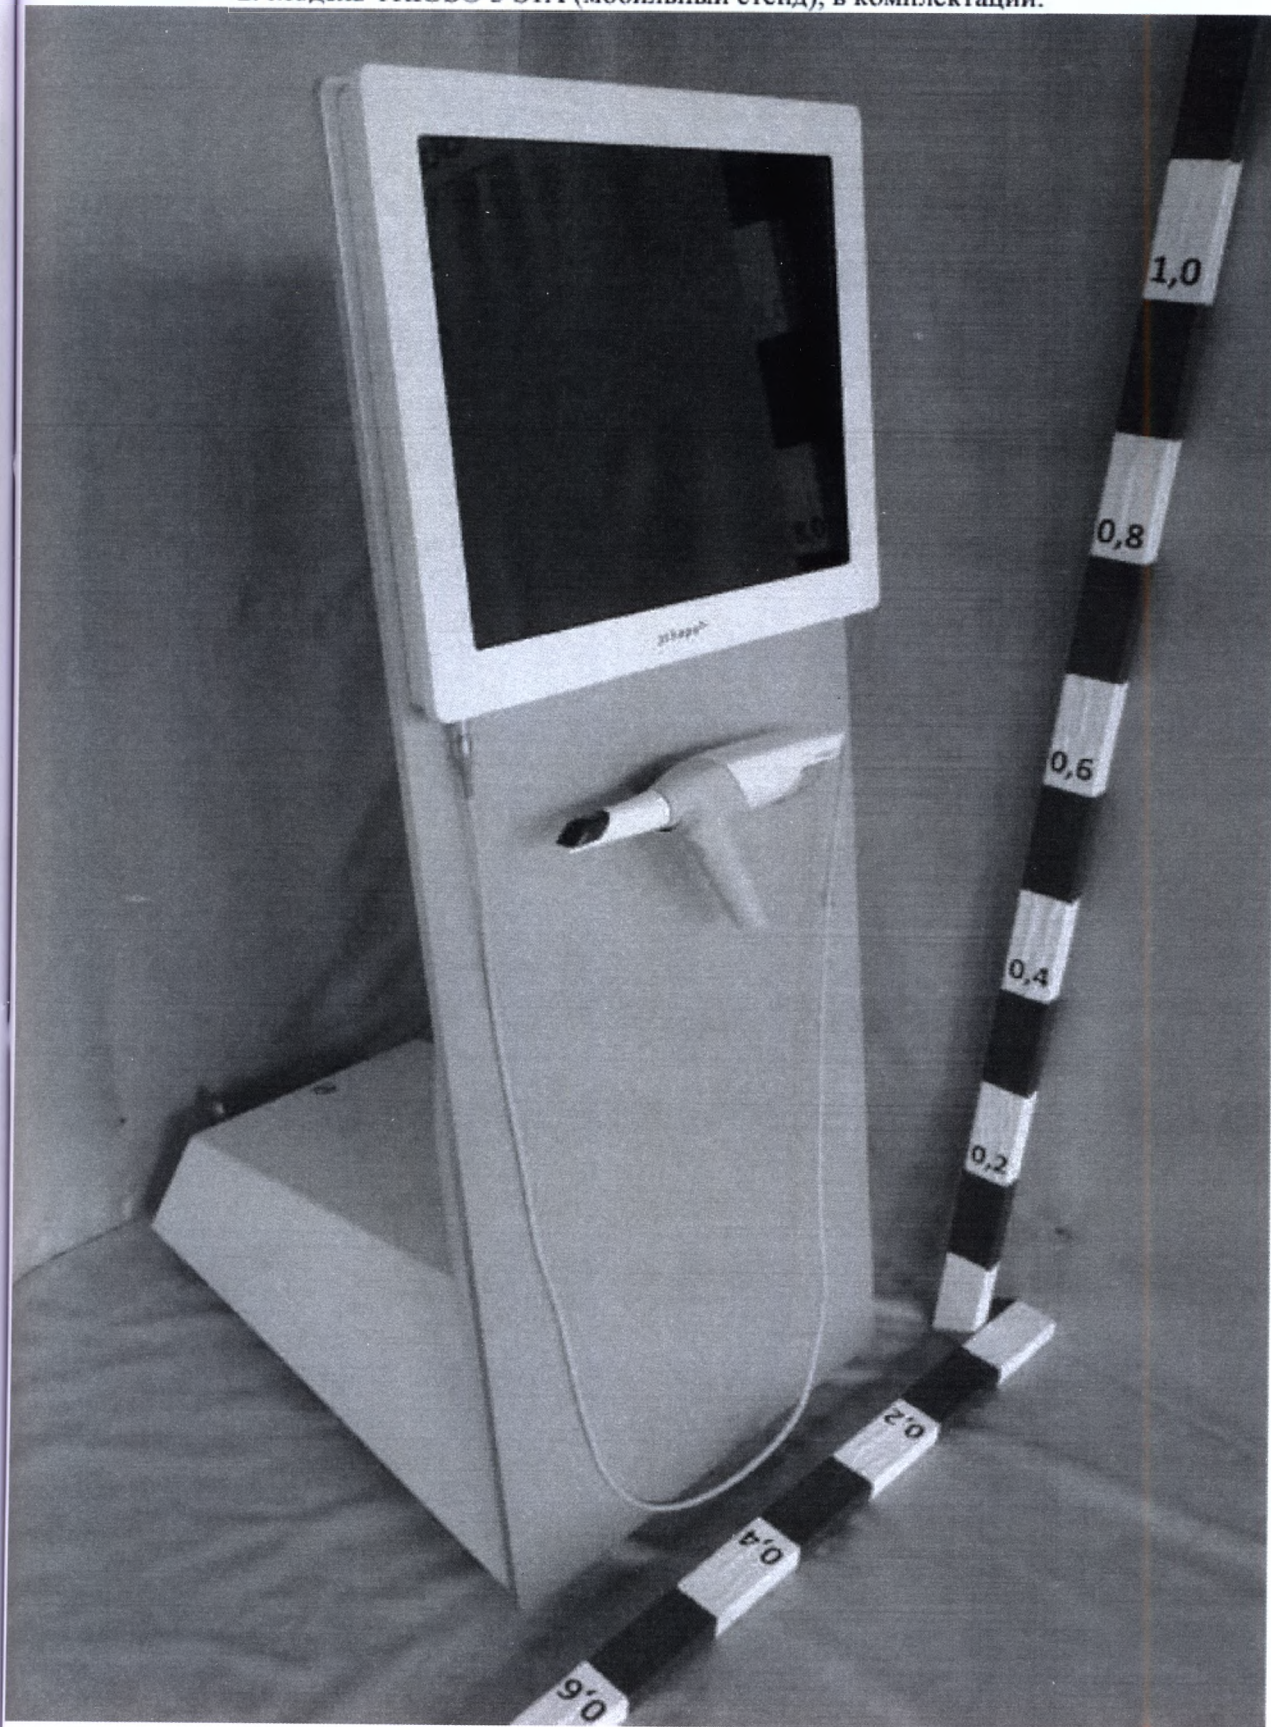

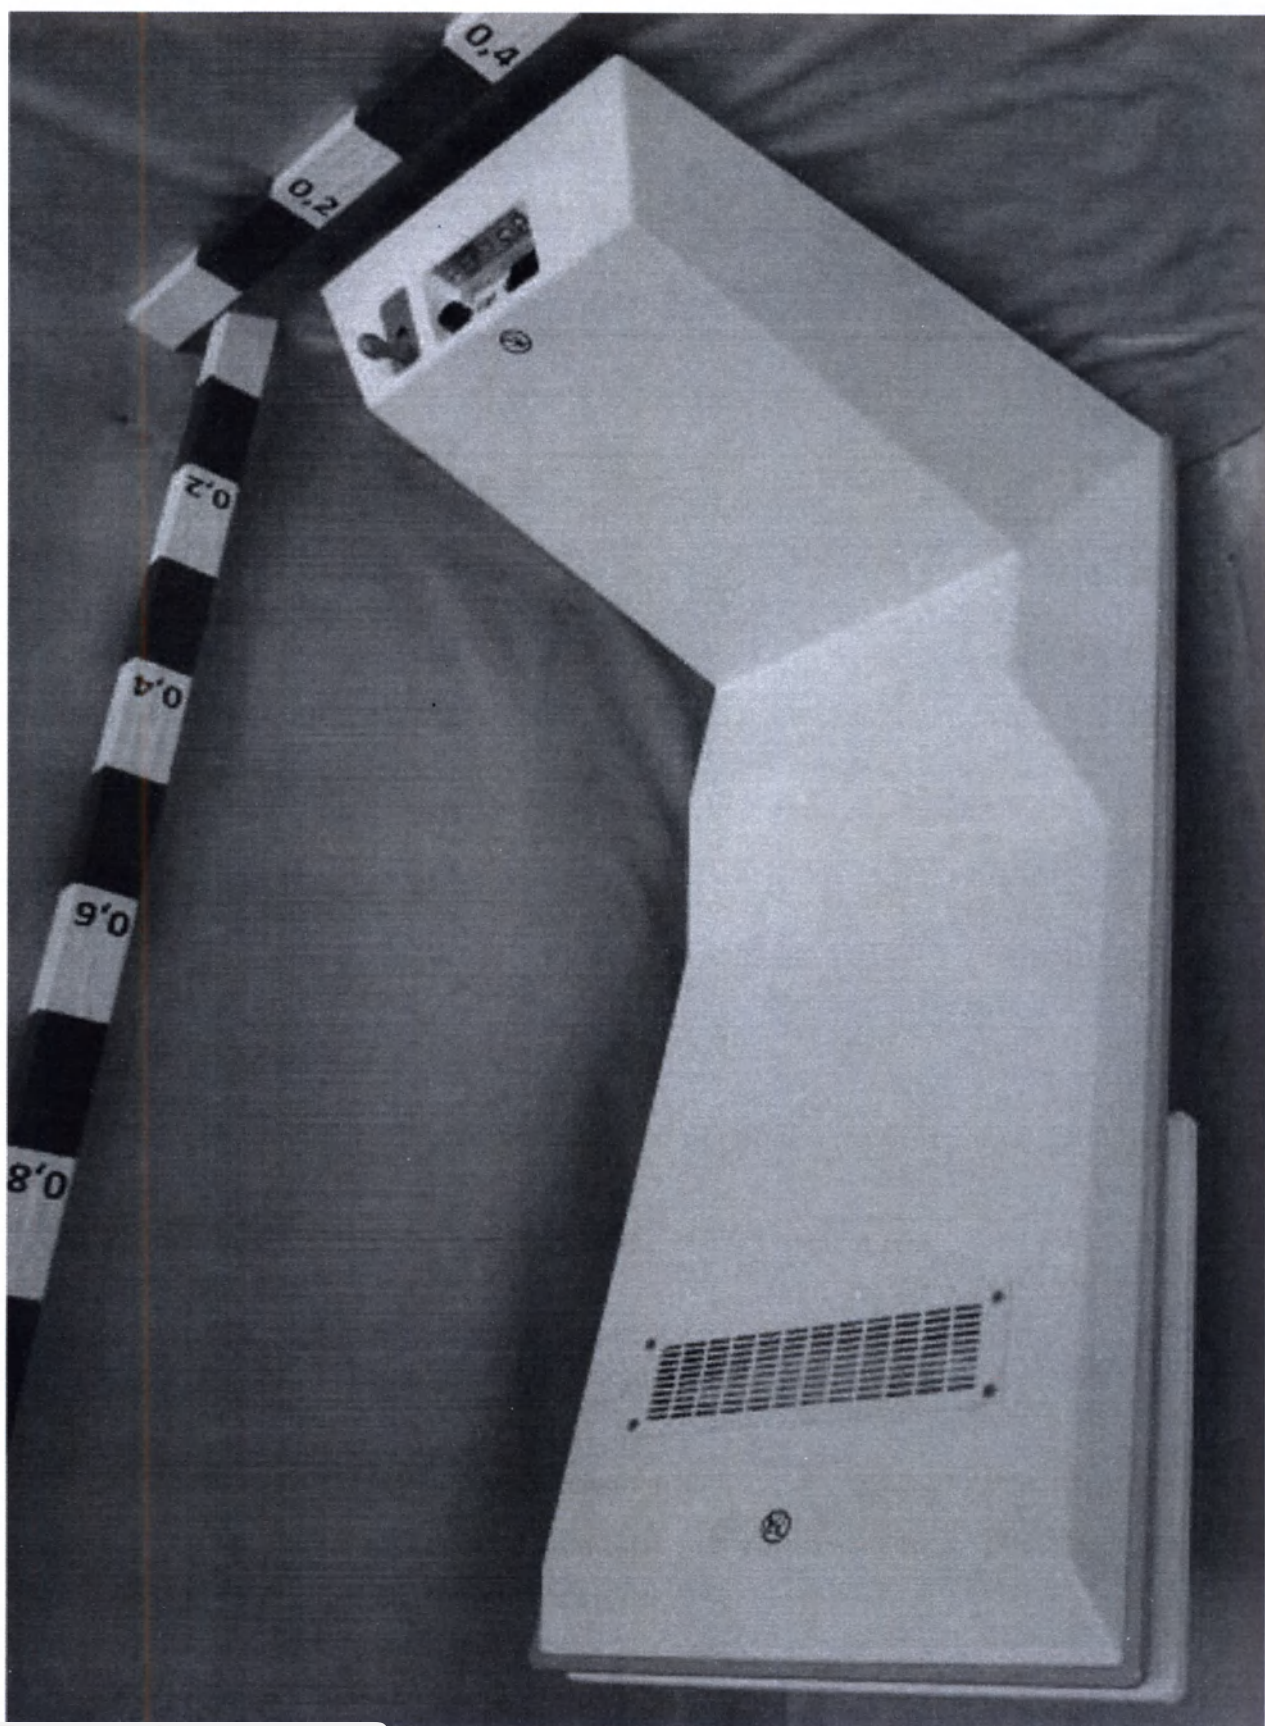



1.1. Сканер интраоральный TRIOS® 3 с ручкой.

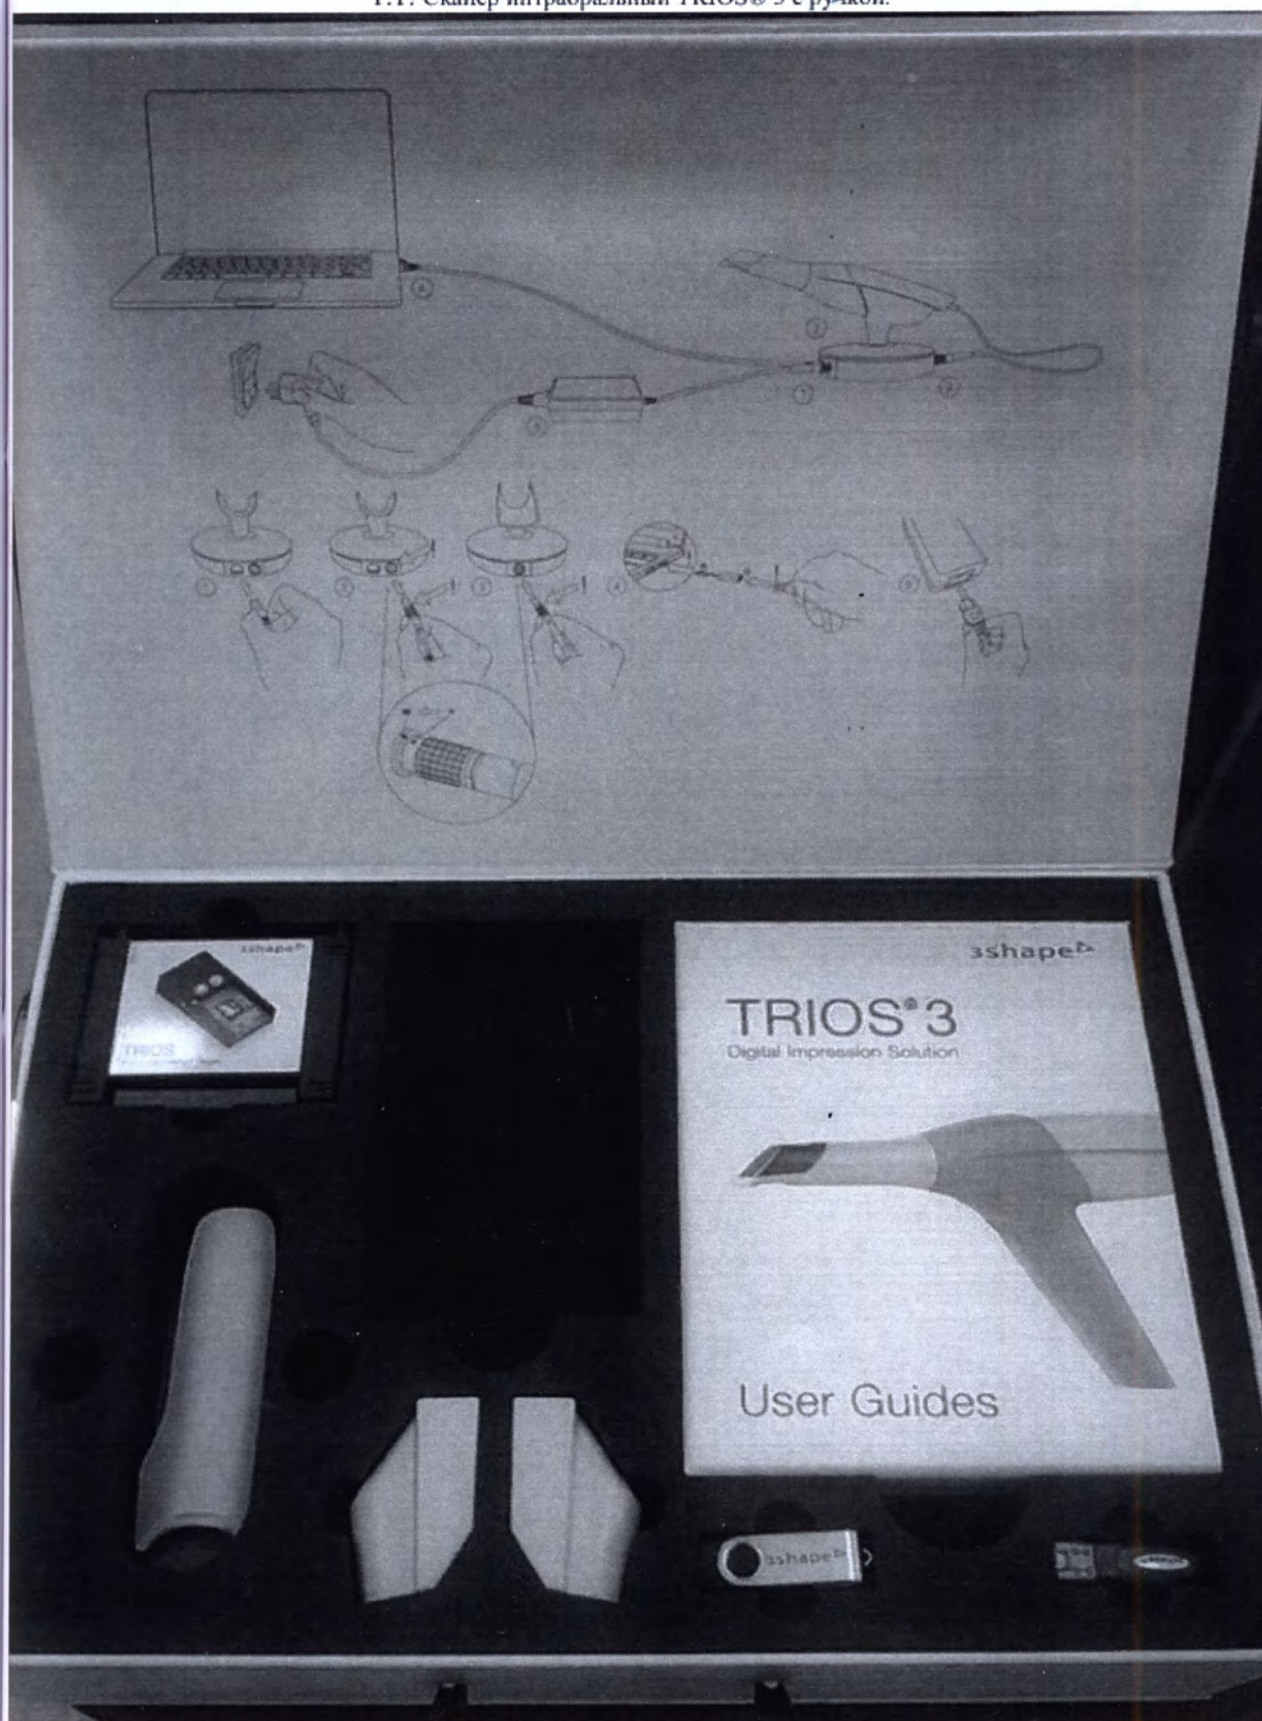

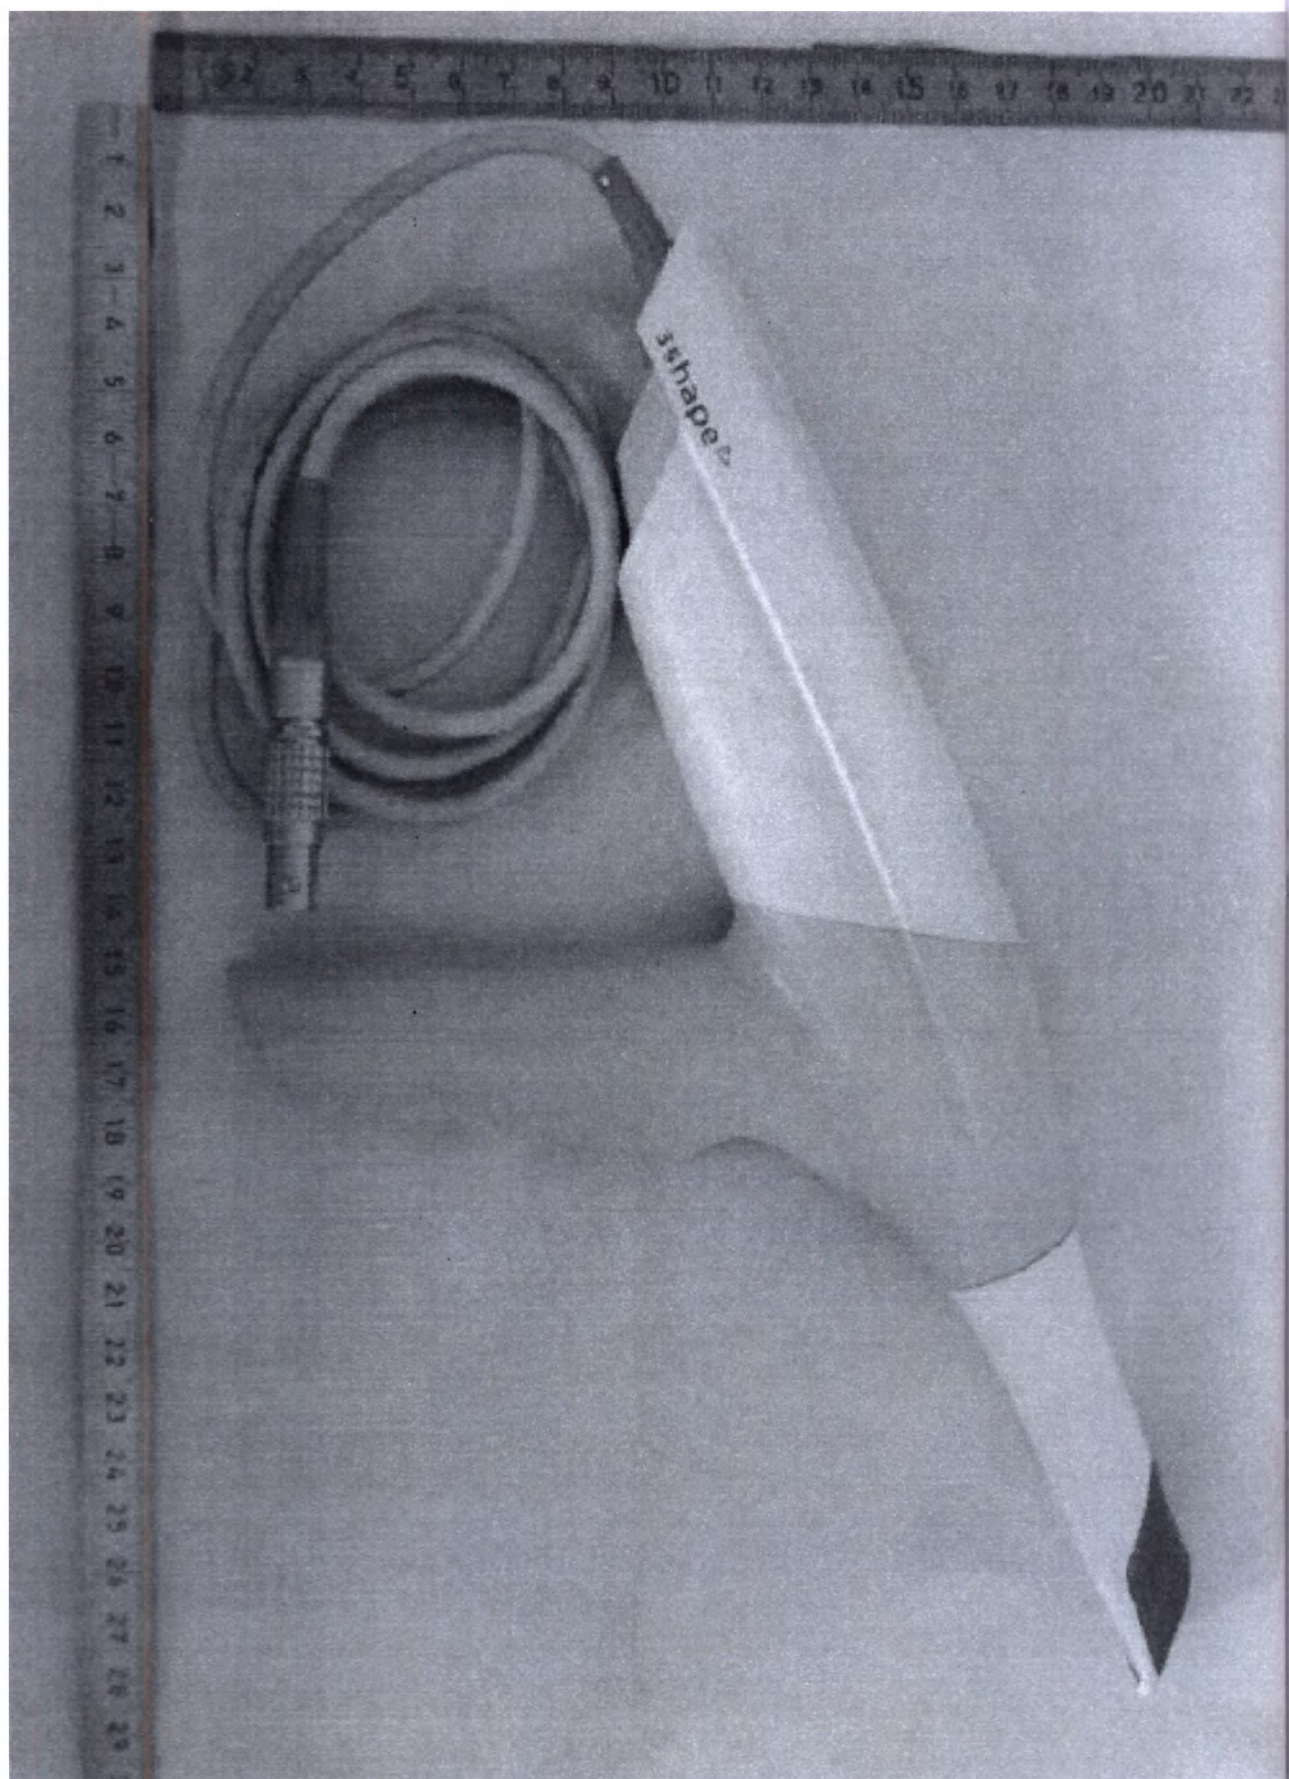



Модуль Cart на колесах с multi-touch монитором, беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth, проводным соединениями USB и Ethernet, интегрированным высокопроизводительным процессором, оптимизированным для 3D сканирования.

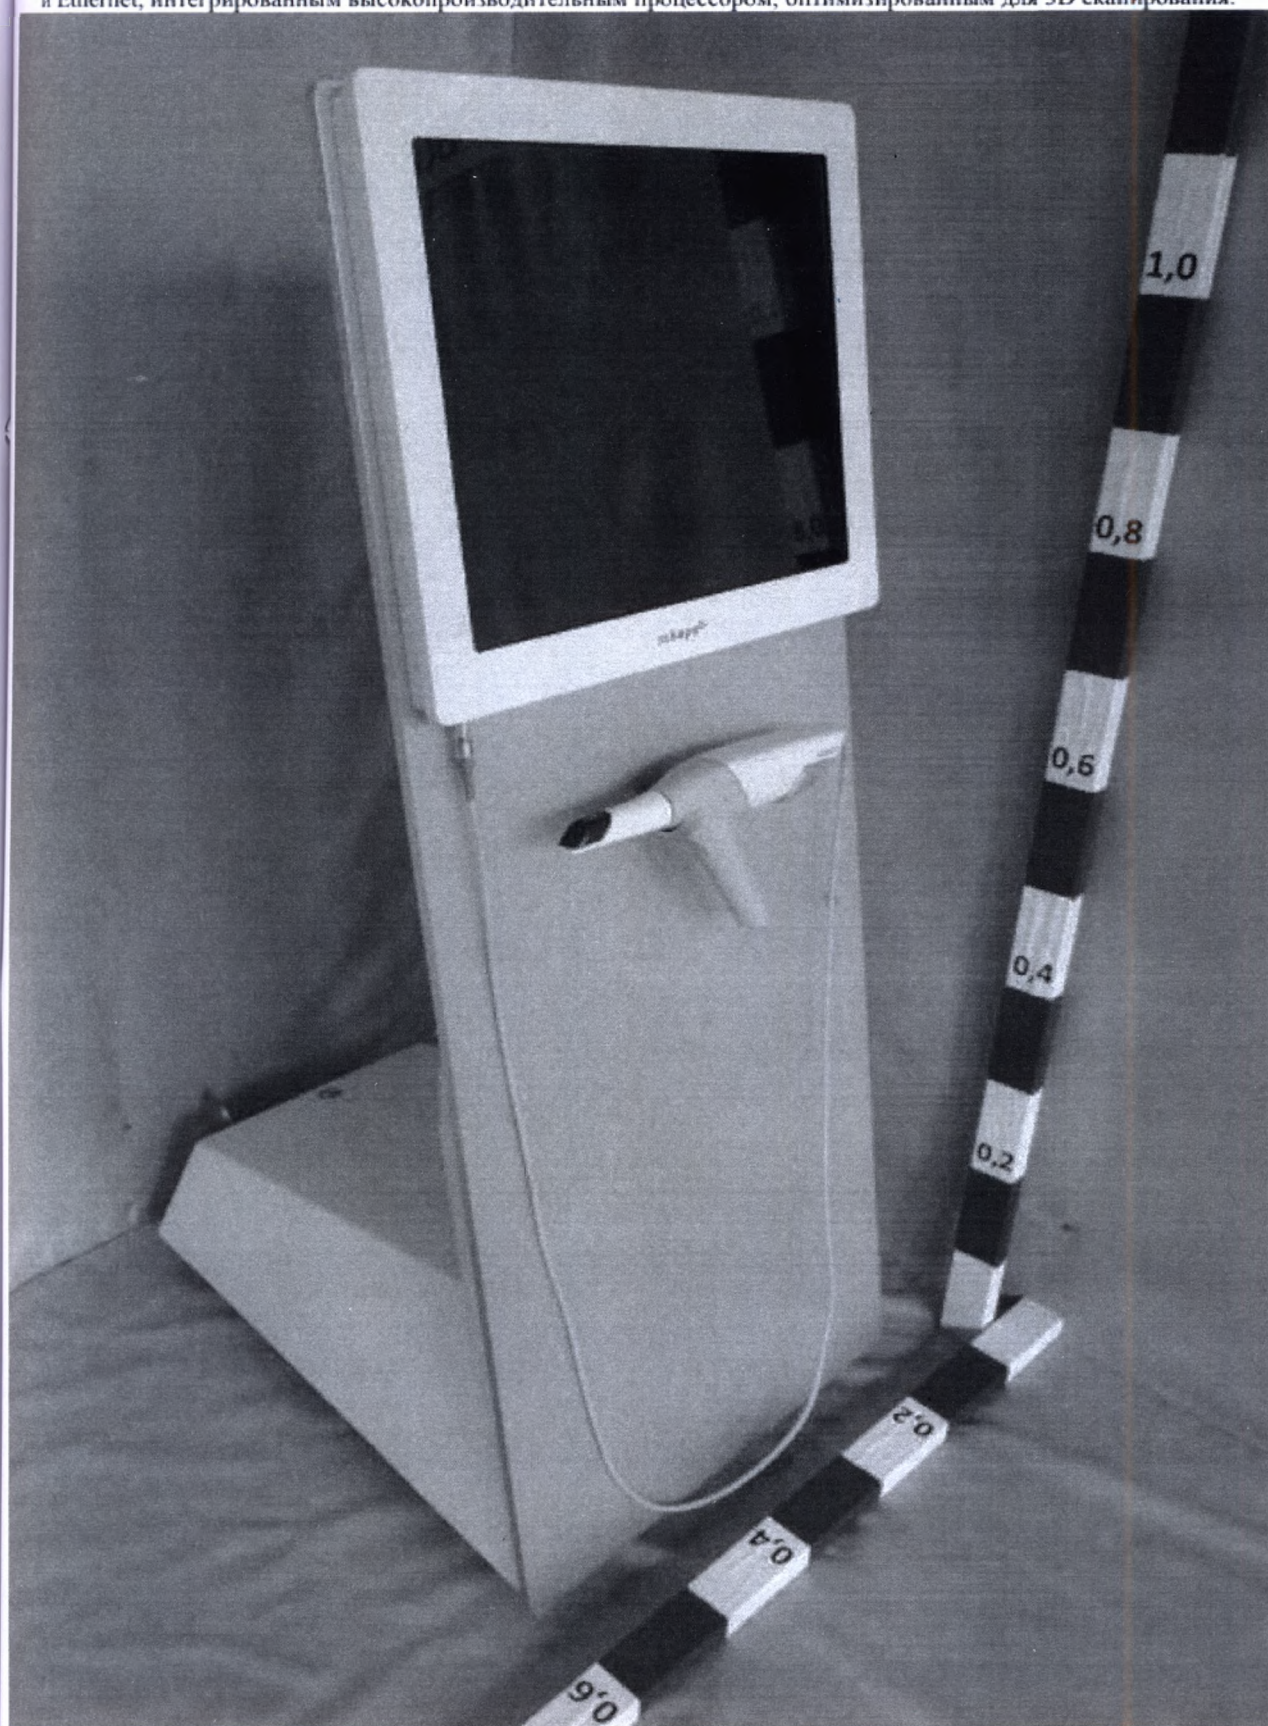


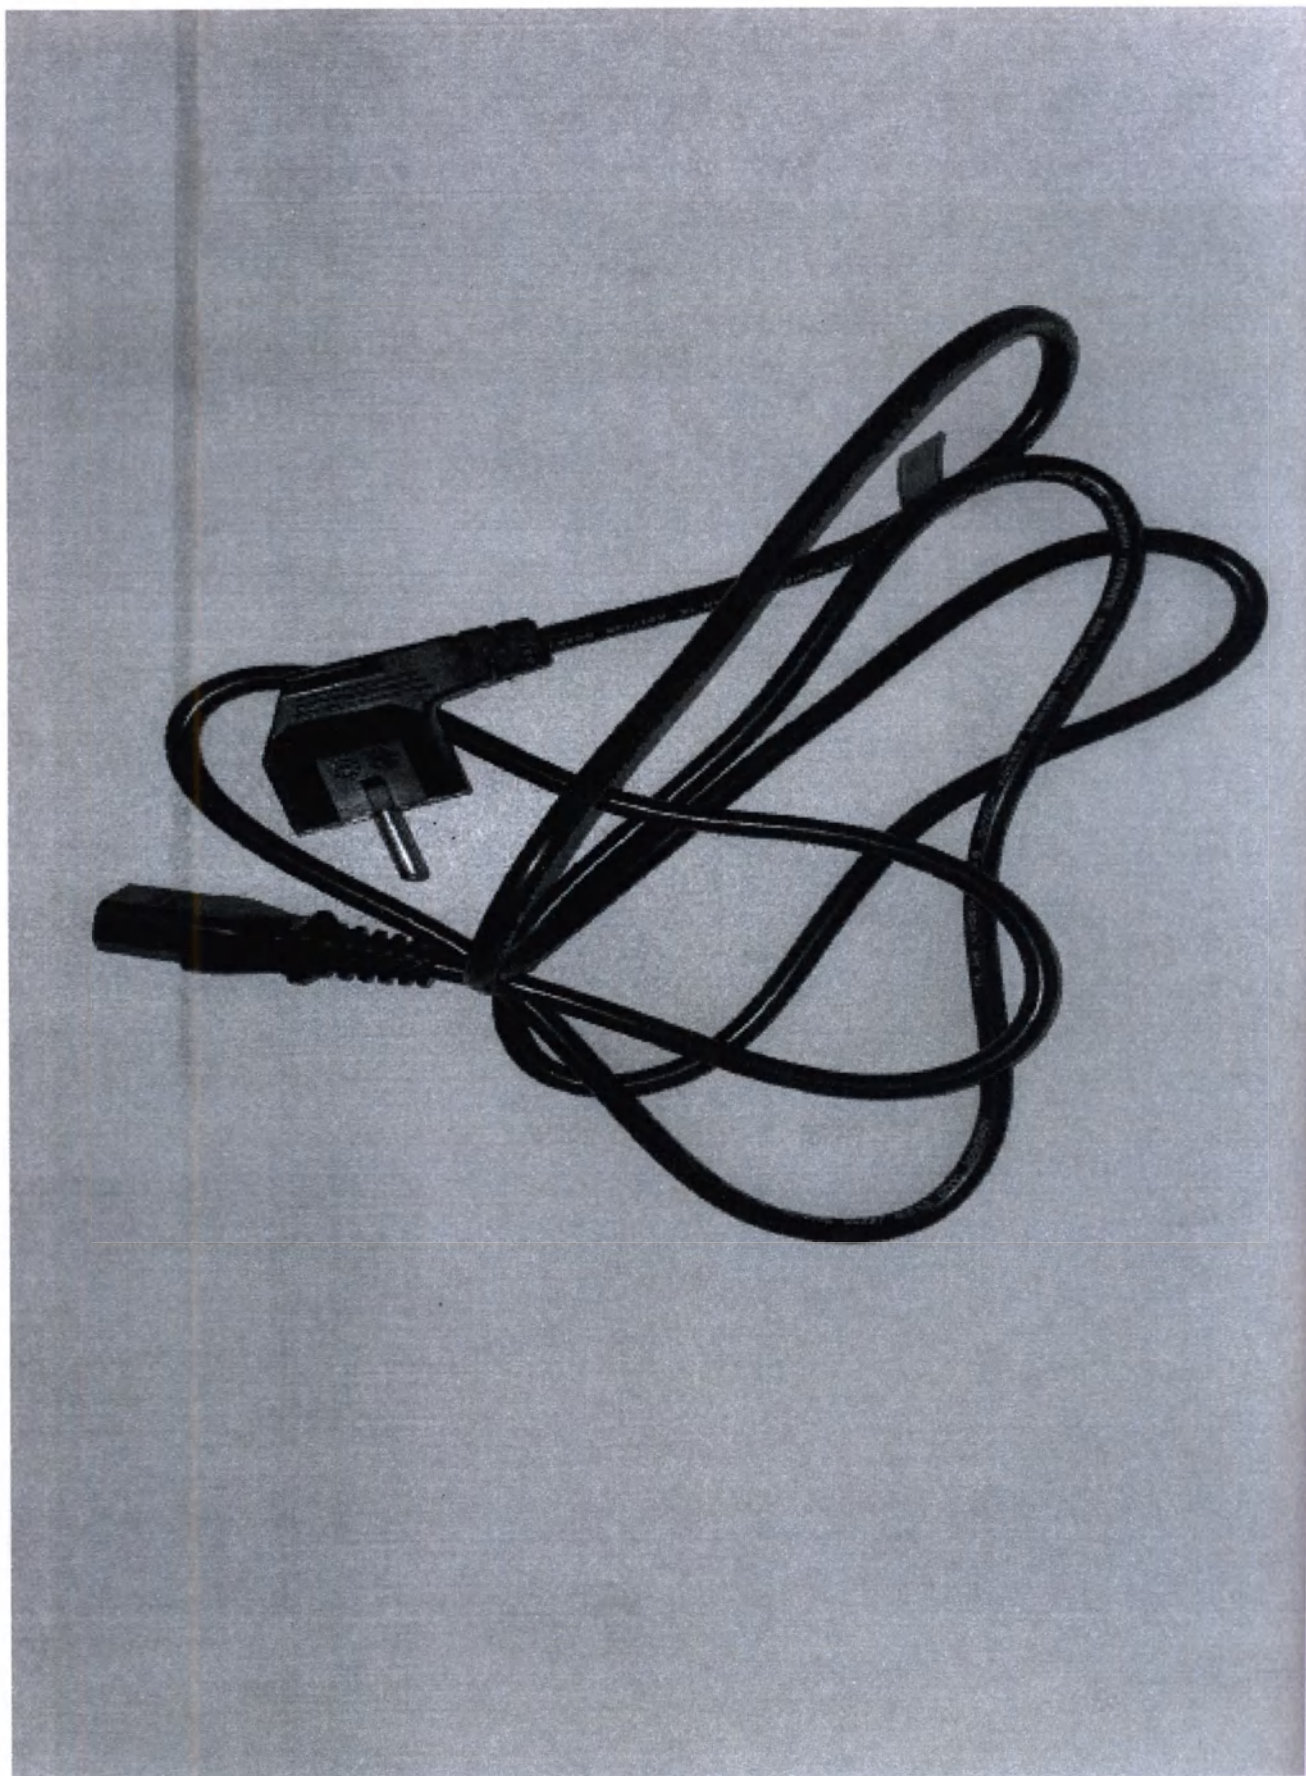



1.4. Кабель LAN Network (5 метров).

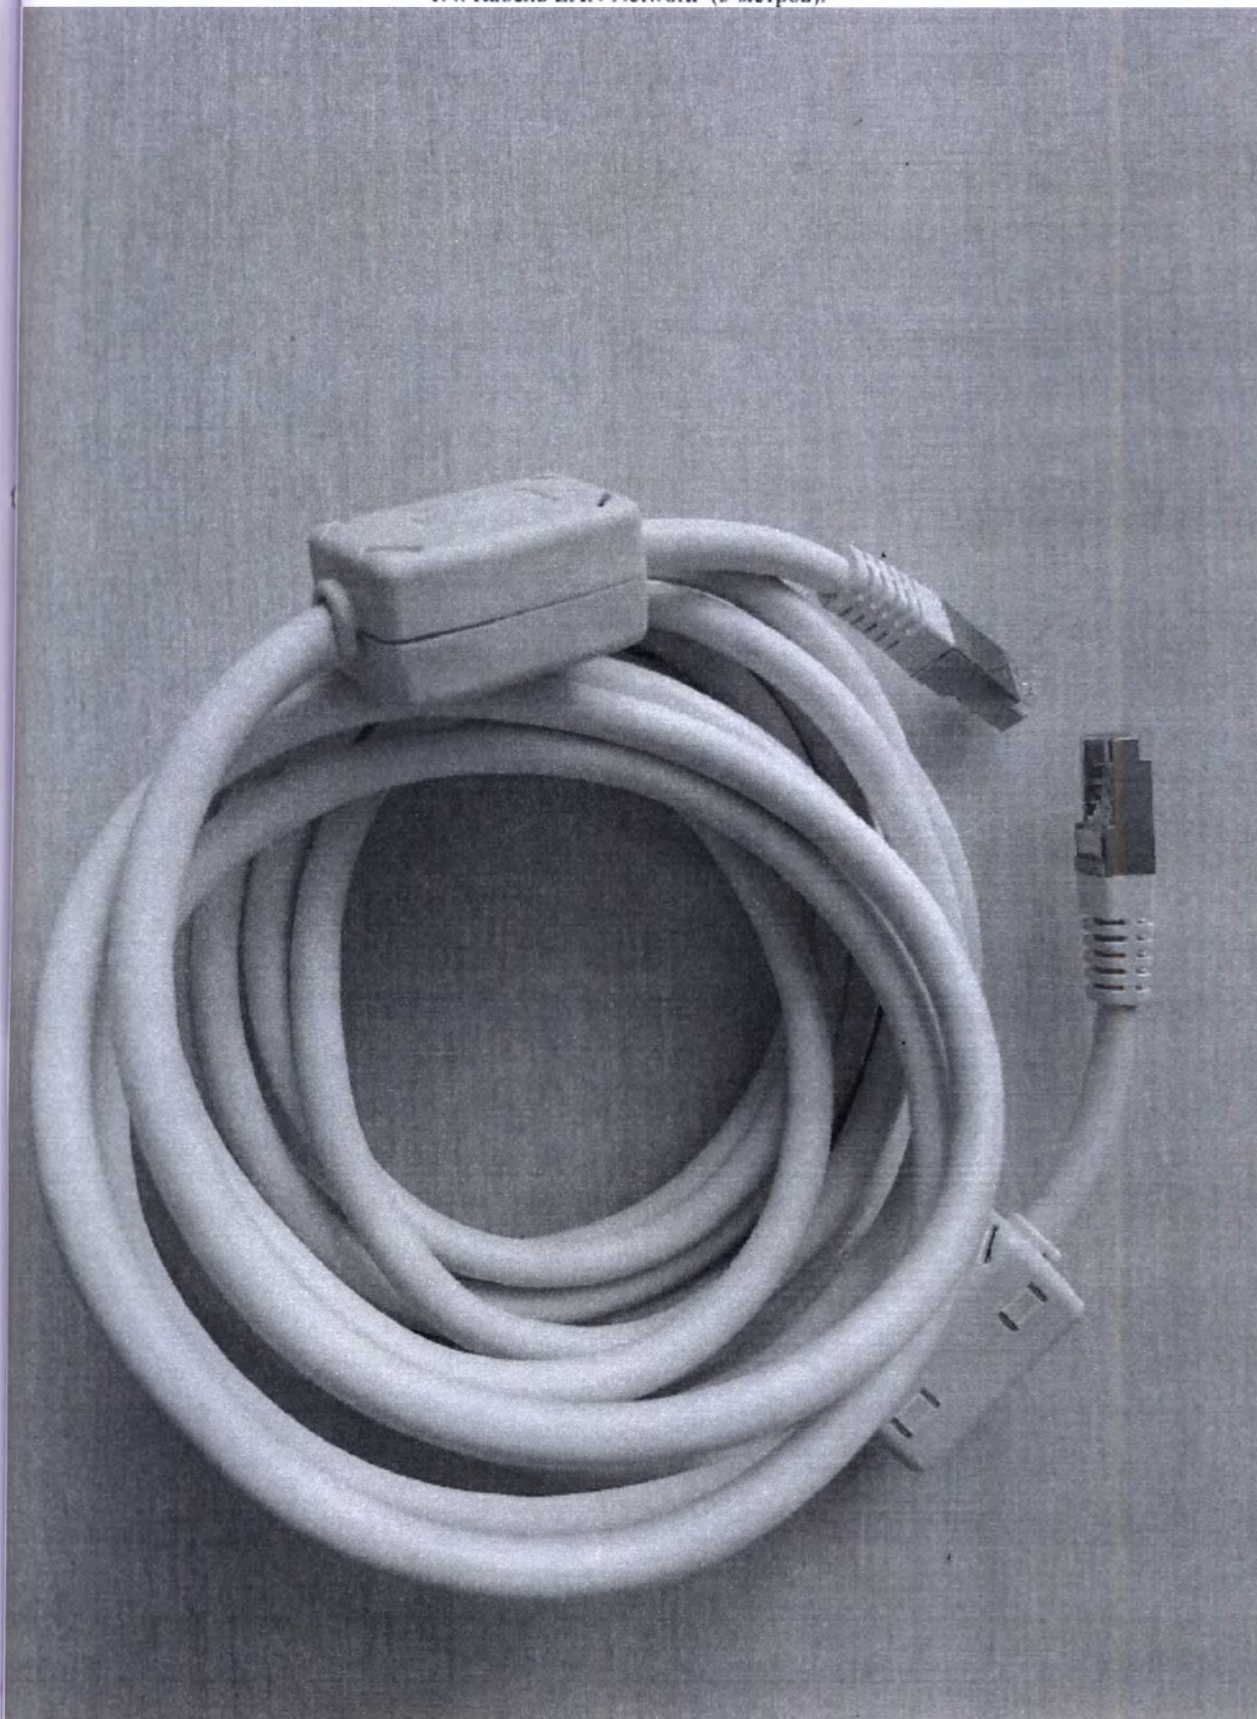

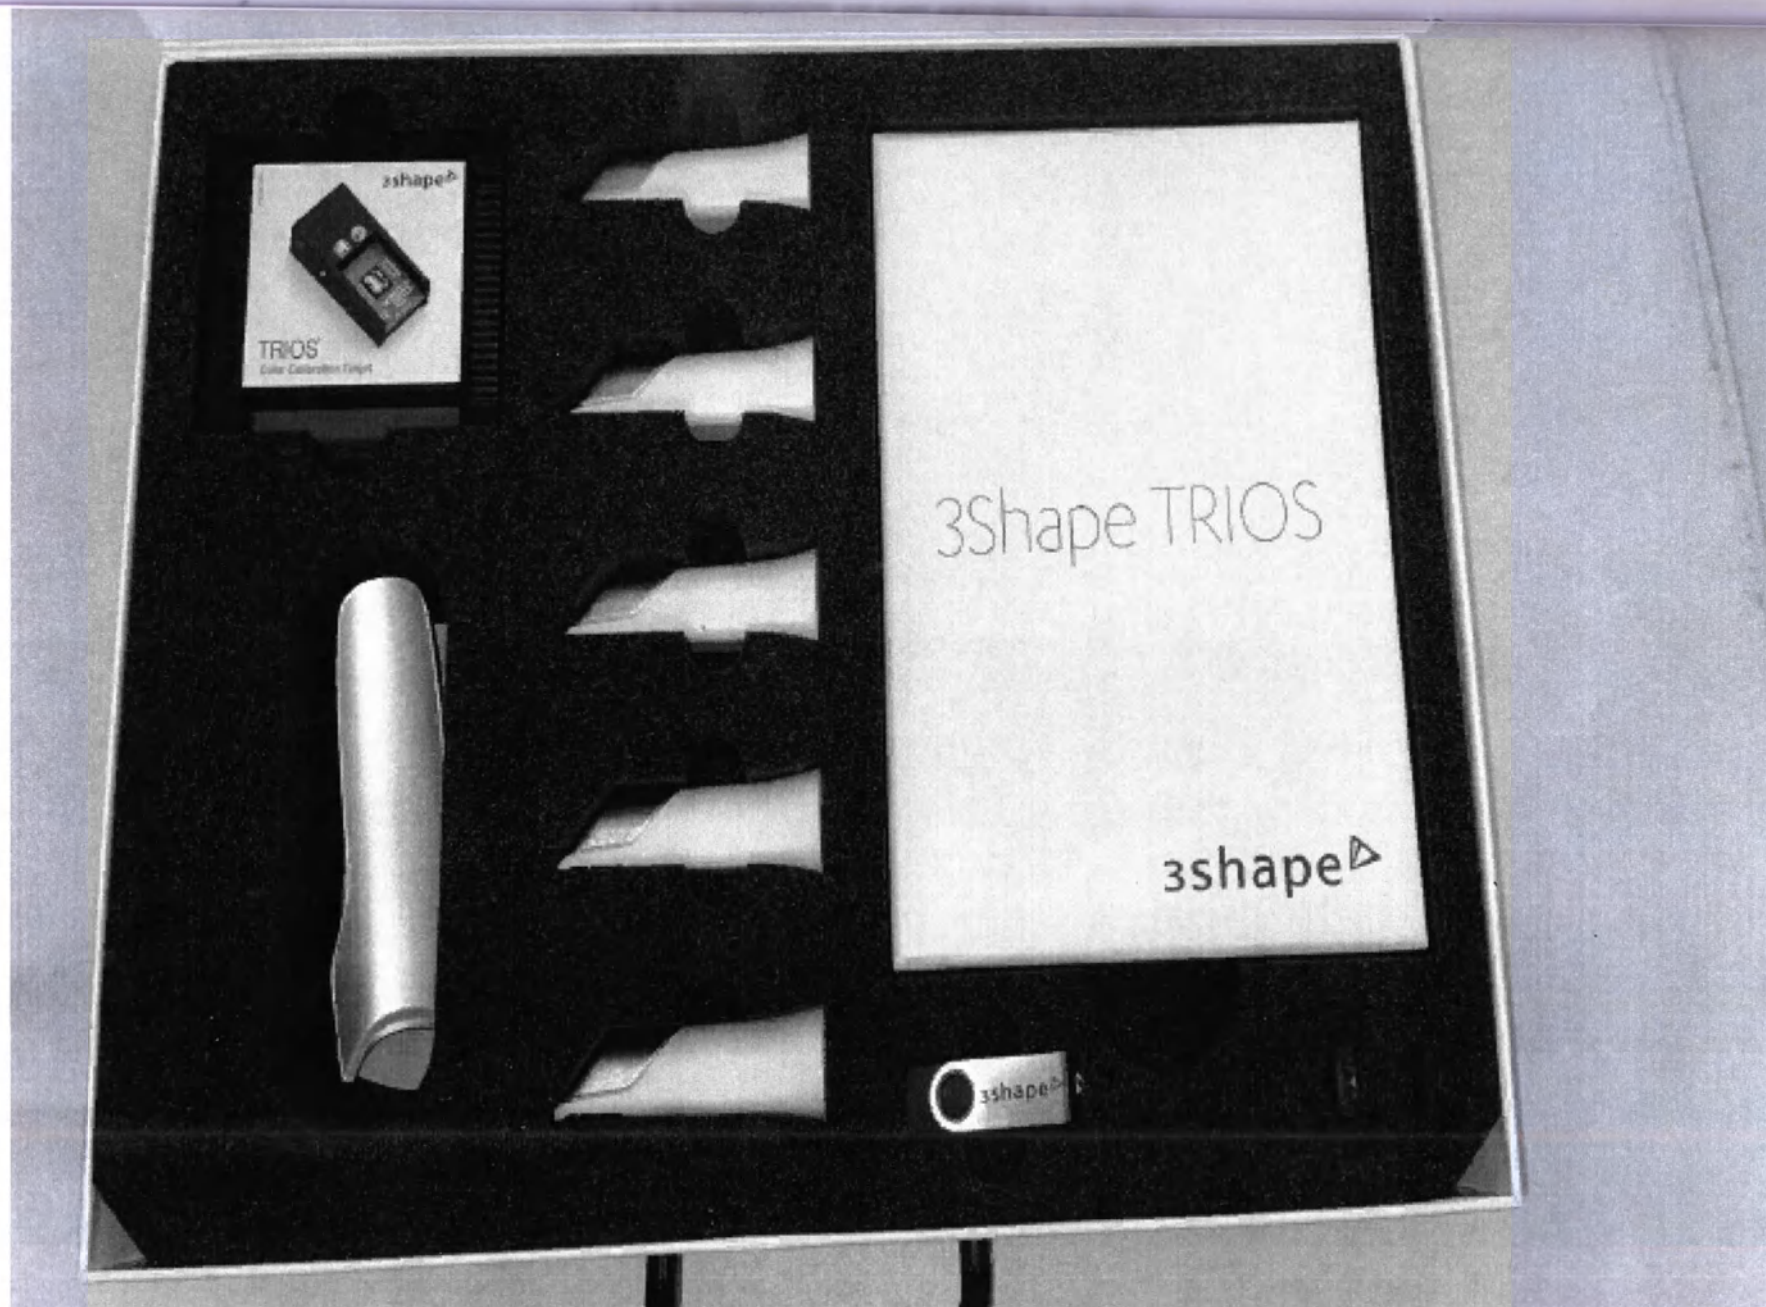

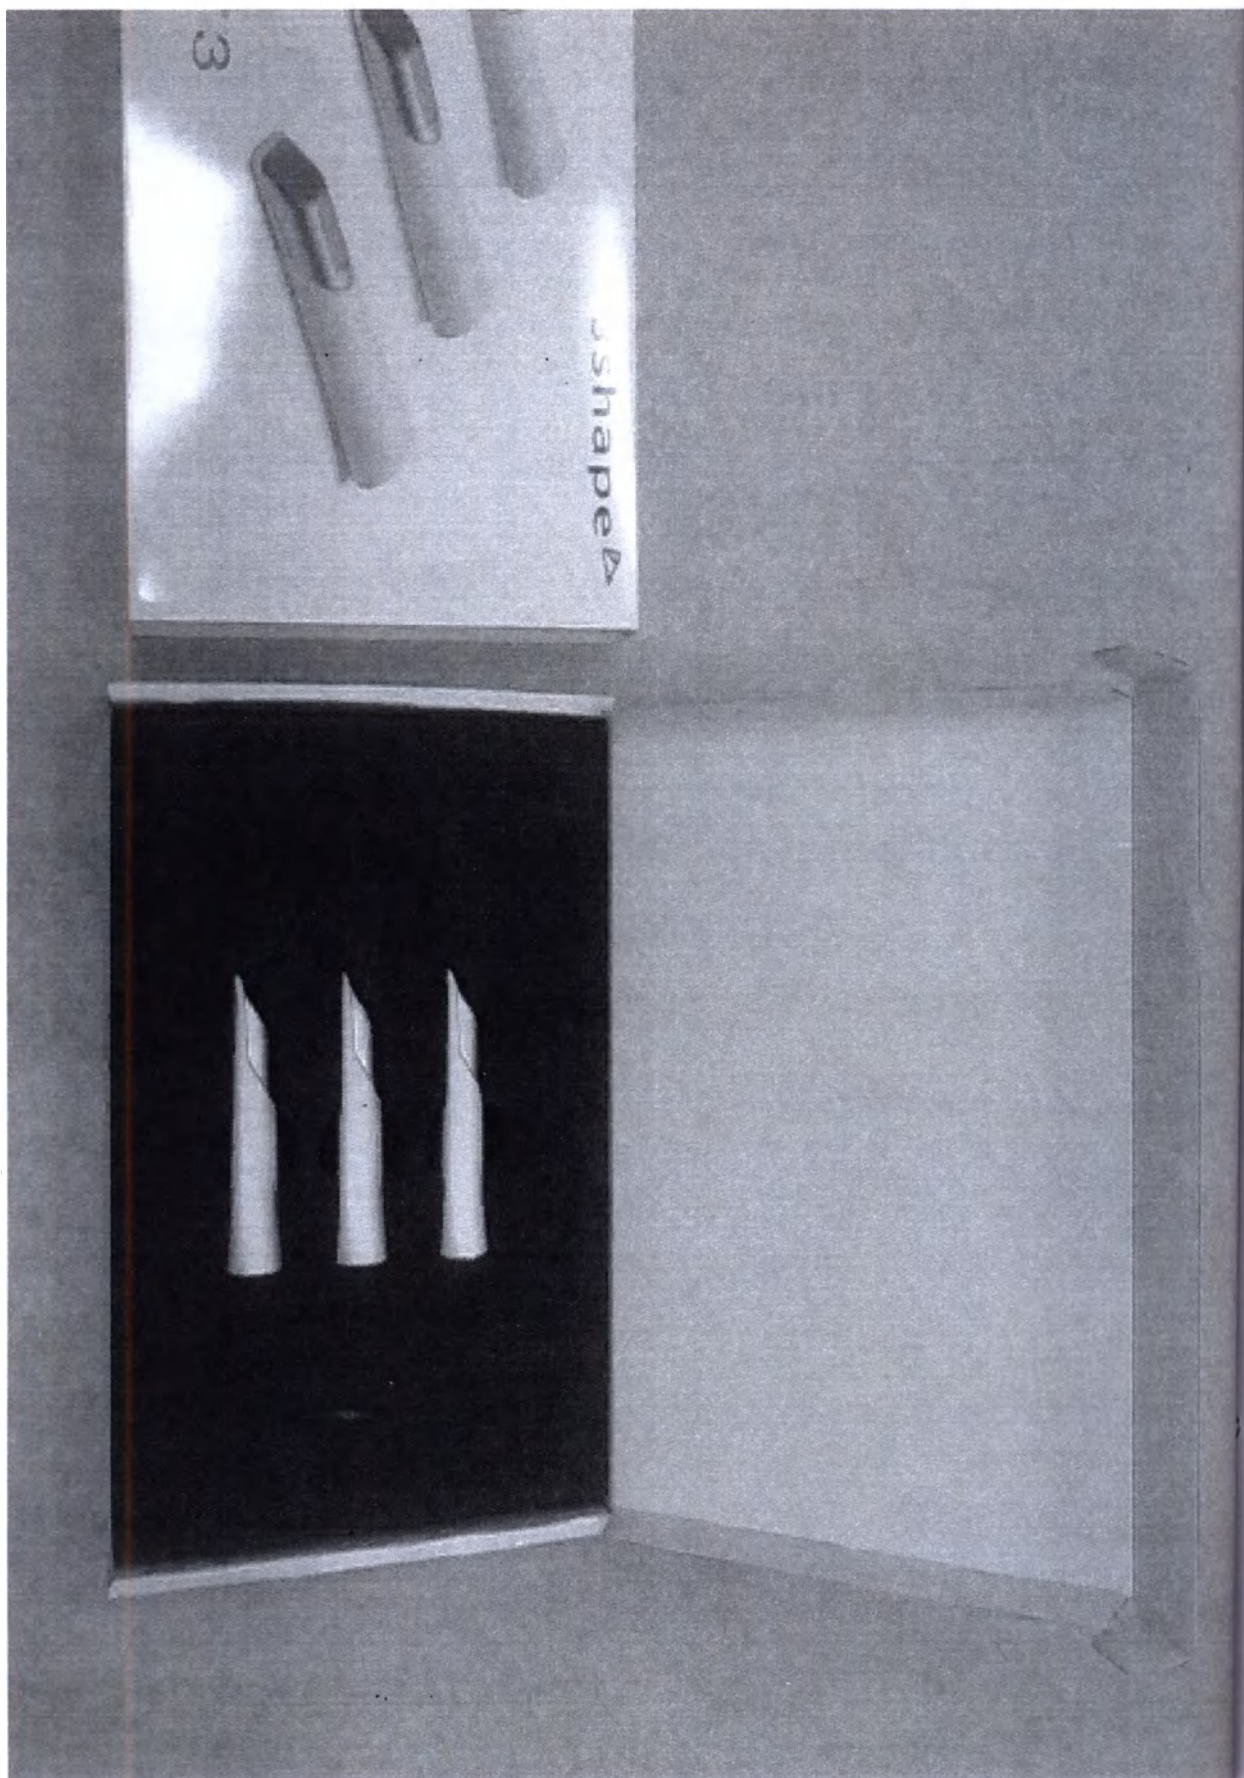


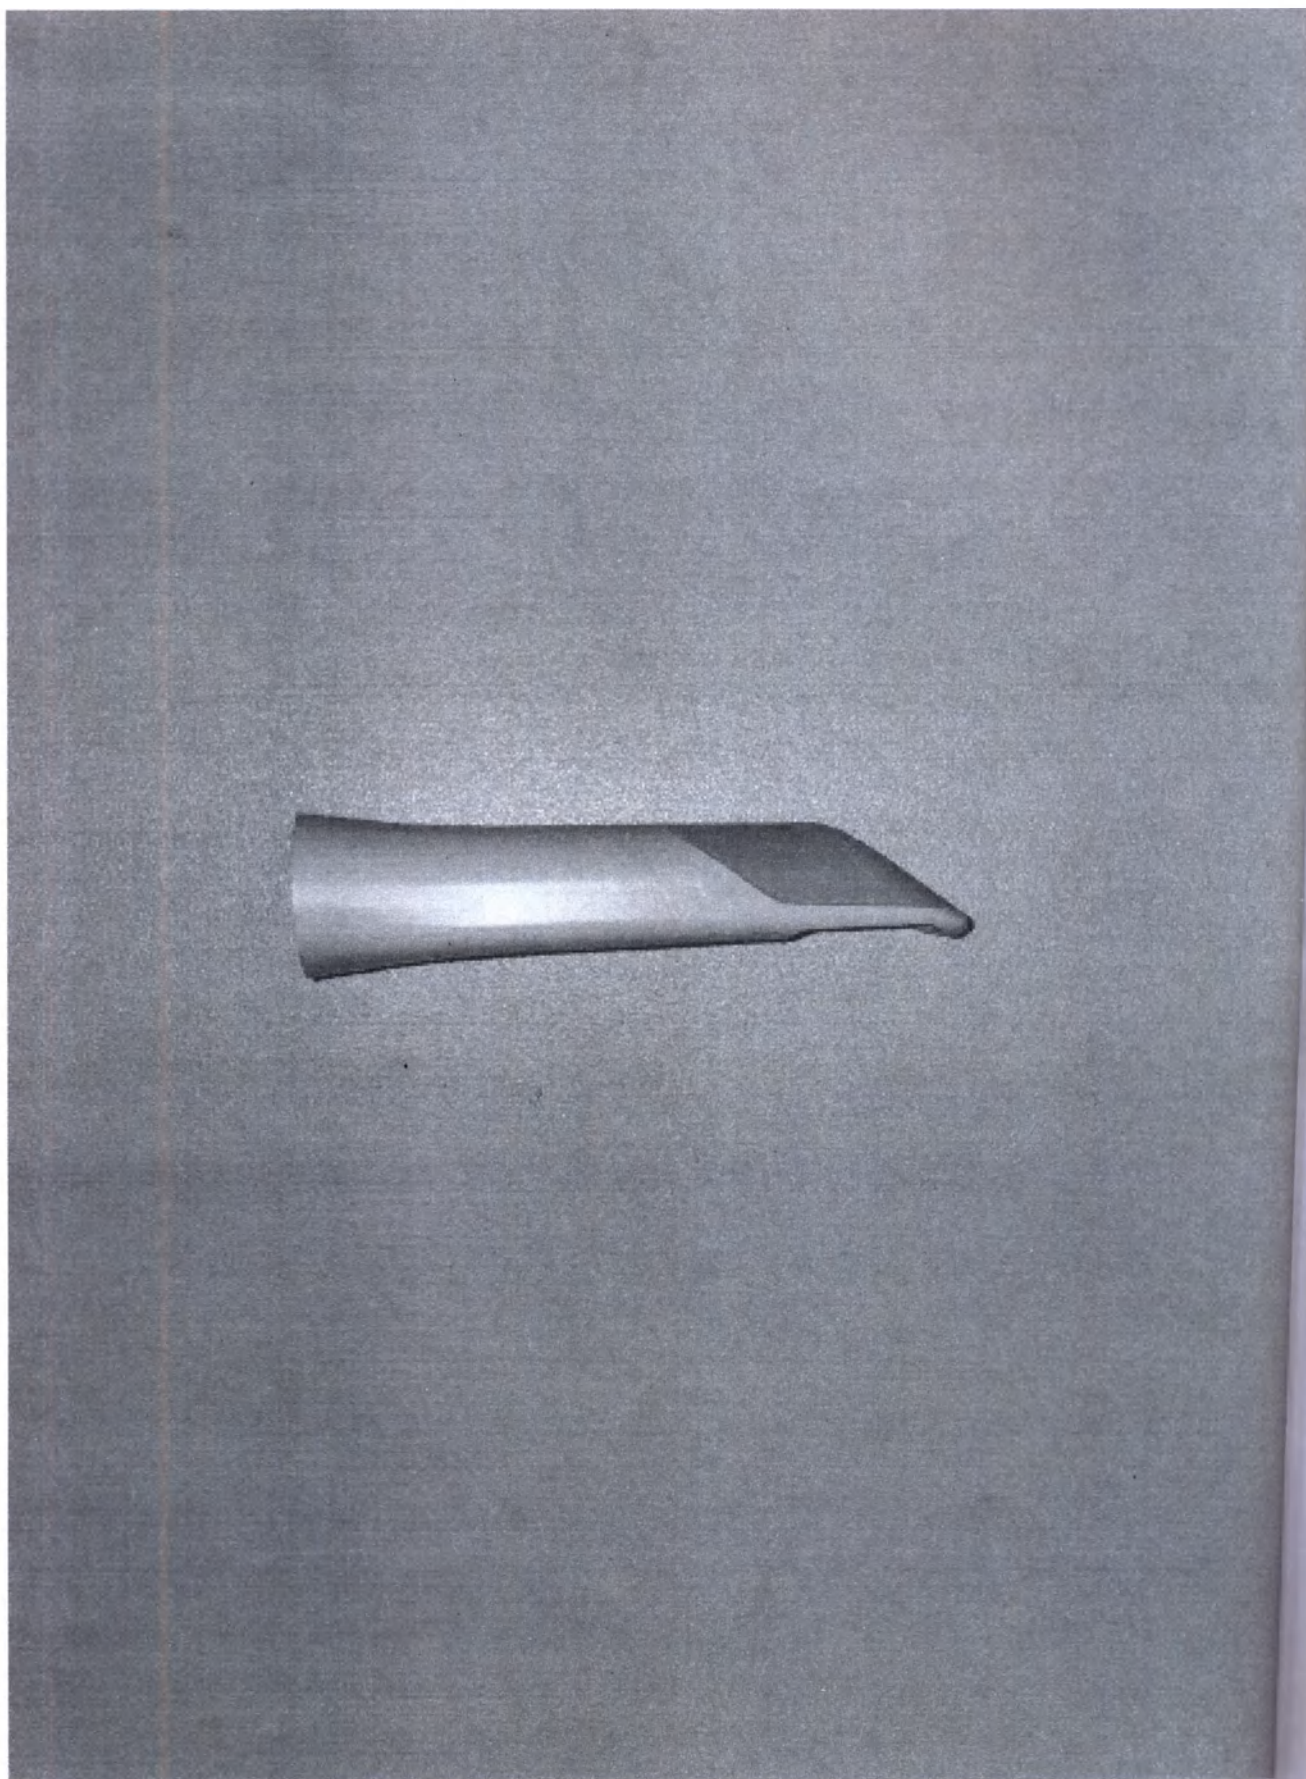

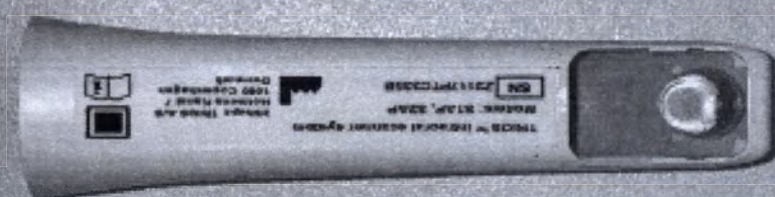





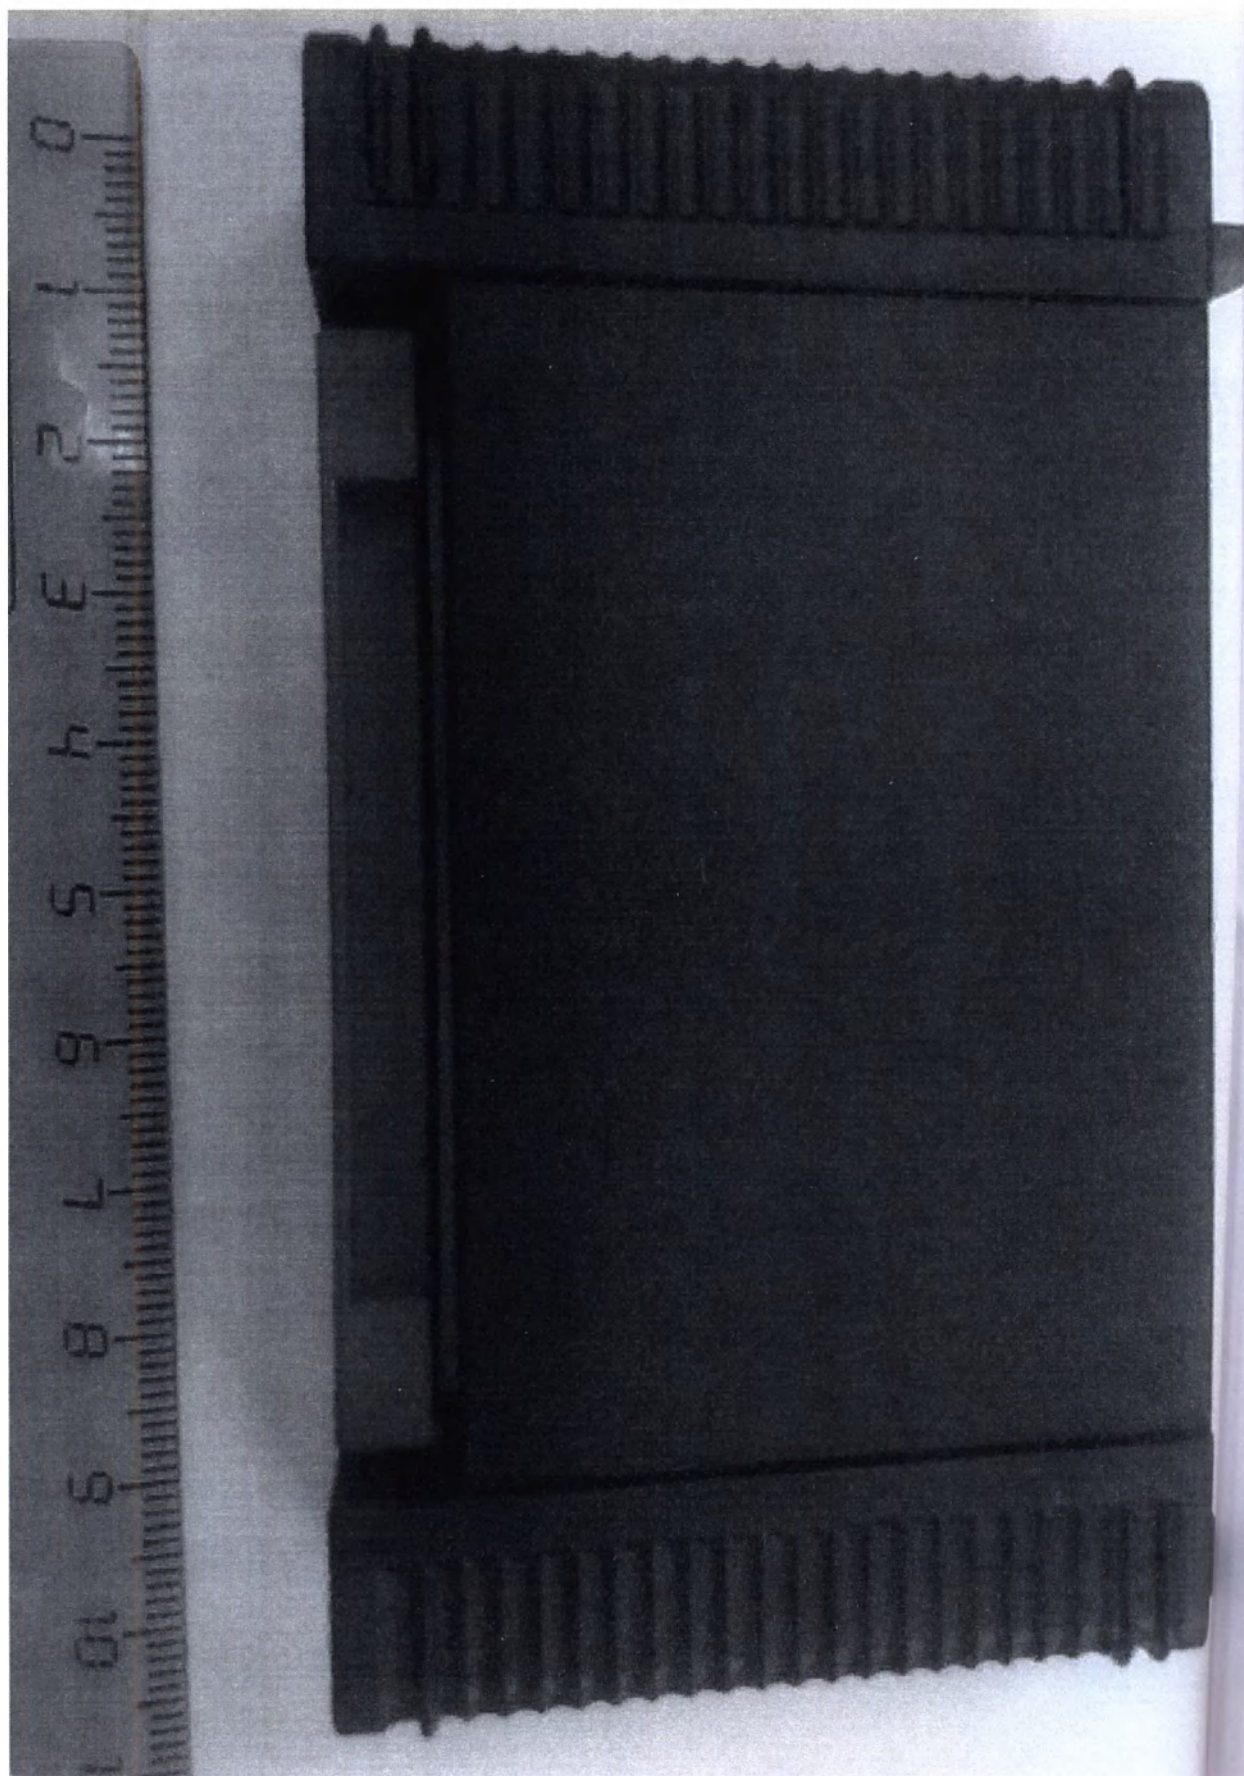

3Shape TRIOS



3shape

3Shape TRIOS



3Shape TRIOS



Всего прошнуровано и скреплено по
39 (тридцать девять) л

Кулаков И

Генеральный директор ООО «БАЛТ





«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «БАЛТТЕКС»**

В.К. Кулаков

«12» июля 2021 г.

Макет маркировки медицинского изделия на русском языке


**«Сканер интраоральный TRIOS® 3 в вариантах исполнения», производства
3Shape Trios A/S (3Шейп Триос А/С), Дания**

Сканер интраоральный TRIOS® 3 в вариантах исполнения

1. Маркировки медицинского изделия, содержащая информацию на русском языке


 3Shape TRIOS A/S Holmens Kanal 7, 1060 København K, Denmark	Адрес места производства: 3Shape Poland Sp. z o.o. ul. Południowa 27c, Szczecin 71-001, Польша
Сканер интраоральный TRIOS® 3 Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2018/7786 от 06.11.2018  Информация о безопасности и предполагаемом использовании предоставляется в руководстве по технике безопасности и настройке. Информация об условиях транспортировки и хранения приведена на упаковке и в руководстве по технике безопасности и настройке.	
Уполномоченный представитель: ООО "Балттекс" тел. +7 812 458-05-35 198095, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 31, лит. А, пом. 1-Н	

2. Упаковка Сканер интраоральный TRIOS® 3

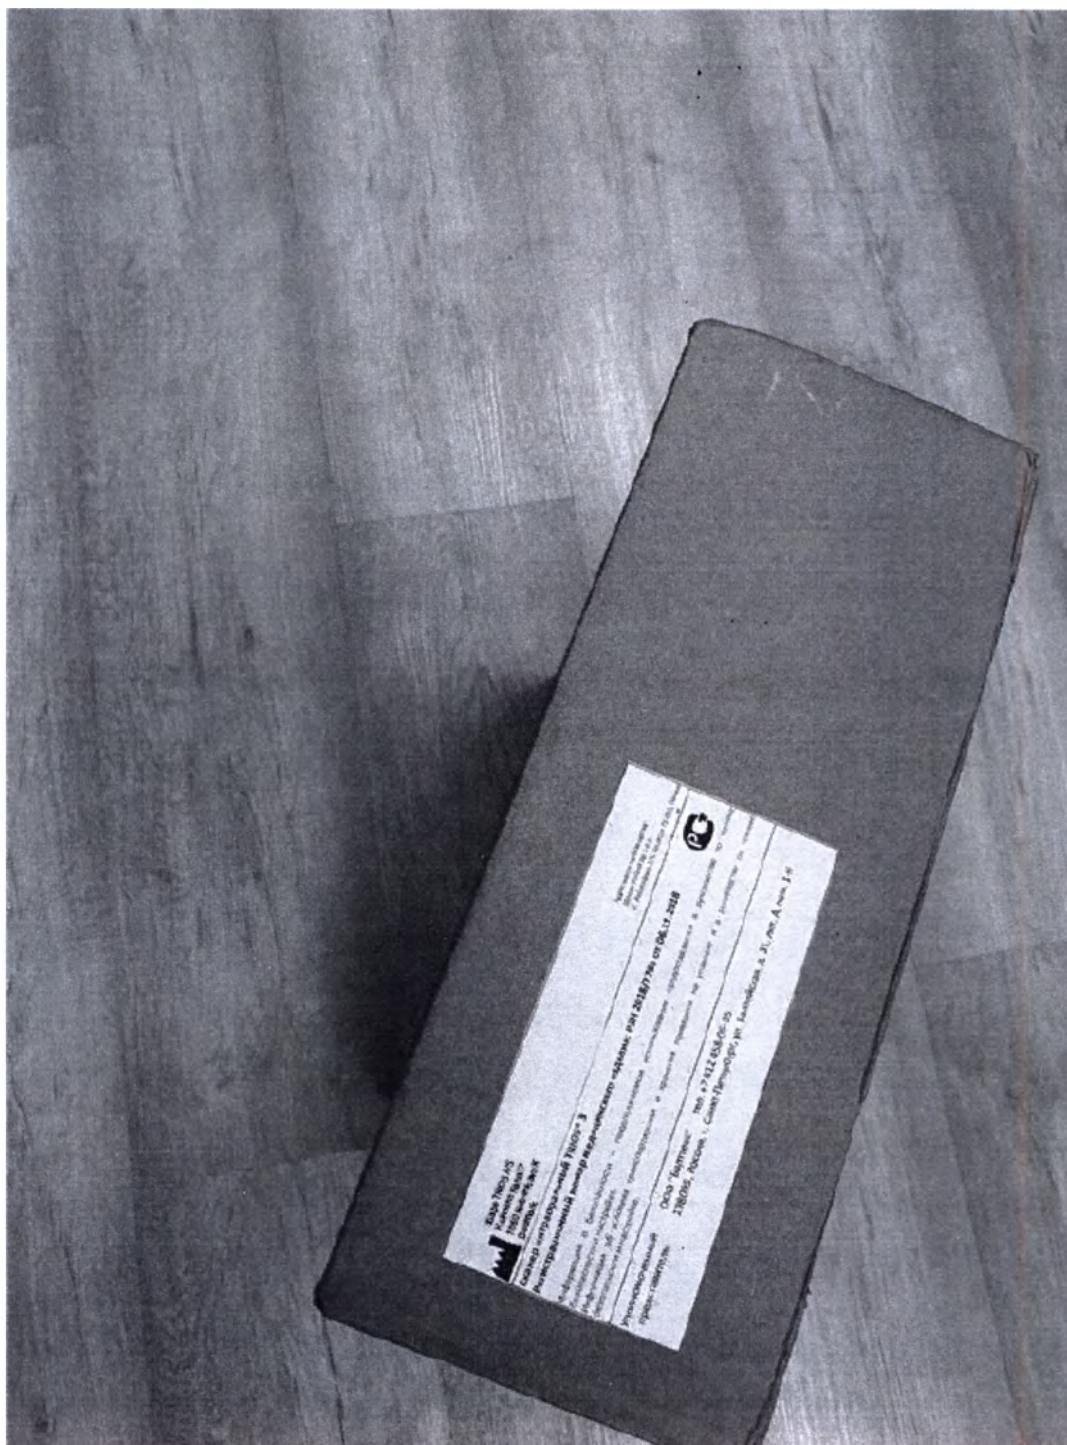



Всего прошнуровано и скреплено печатью
5 (пять) лист 06.


Кулаков В.К.
Генеральный директор ООО «БАЛТЕКС»

