

ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ТКА»

производство измерительной техники

Люксметры, Яркометры, УФ-радиометры,
Термогигрометры, Термоанемометры,
Медтехника



«TKA SCIENTIFIC INSTRUMENTS»
LIMITED

new generation of measuring technology

Luxmeters, Lightmeters, UV-Radiometers,
Thermohygrometers, Thermoanemometers
Medical Devices

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «НТП «ТКА»


К.А. Томский

2021 г.




Фотографии медицинского изделия


Прибор для диагностики инфицирования человека бактерией *Helicobacter pylori*
по содержанию аммиака в выдыхаемом воздухе «ГастроТест»
по ТУ 26.60.12-001-16796024-2019

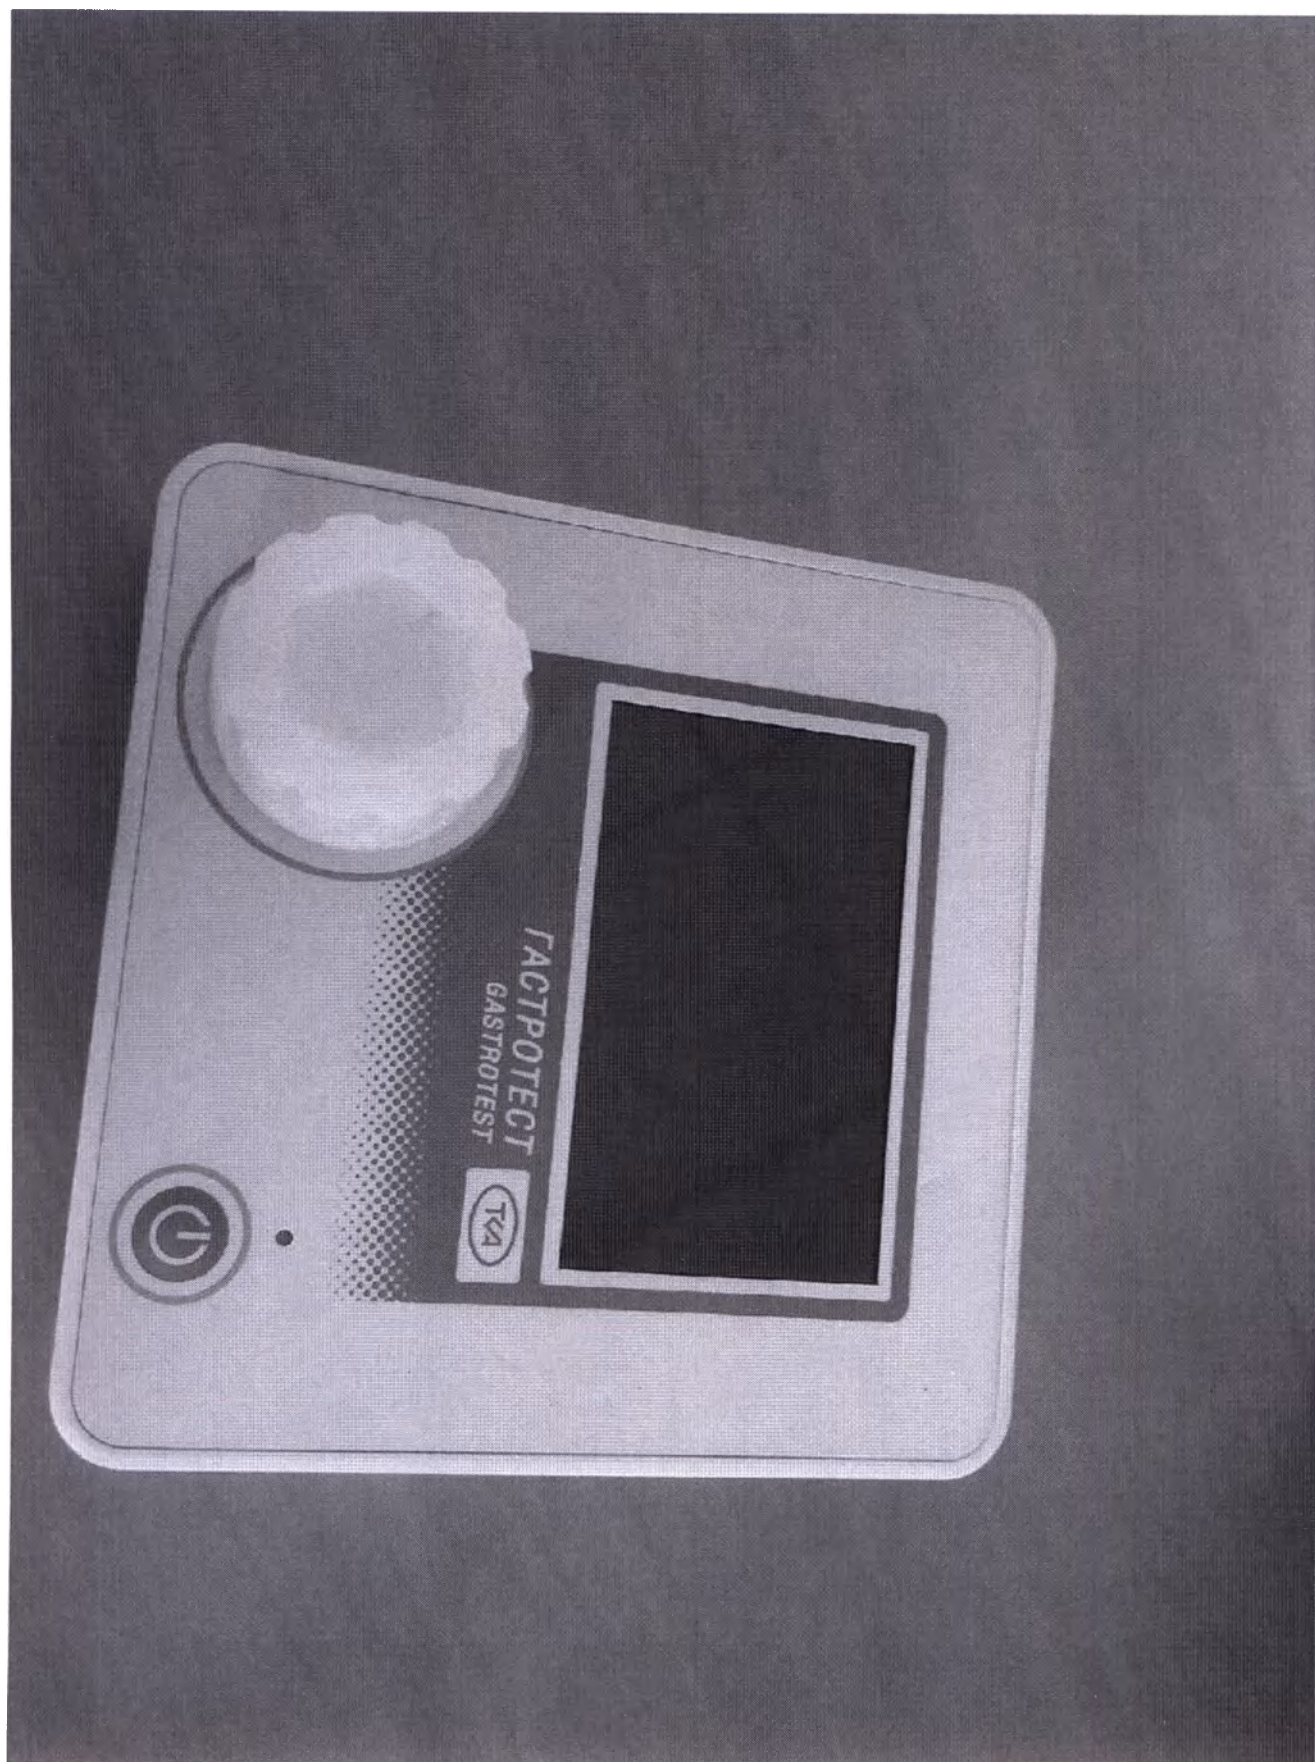


Фотографическое изображение 1. Прибор «ГастроТест»

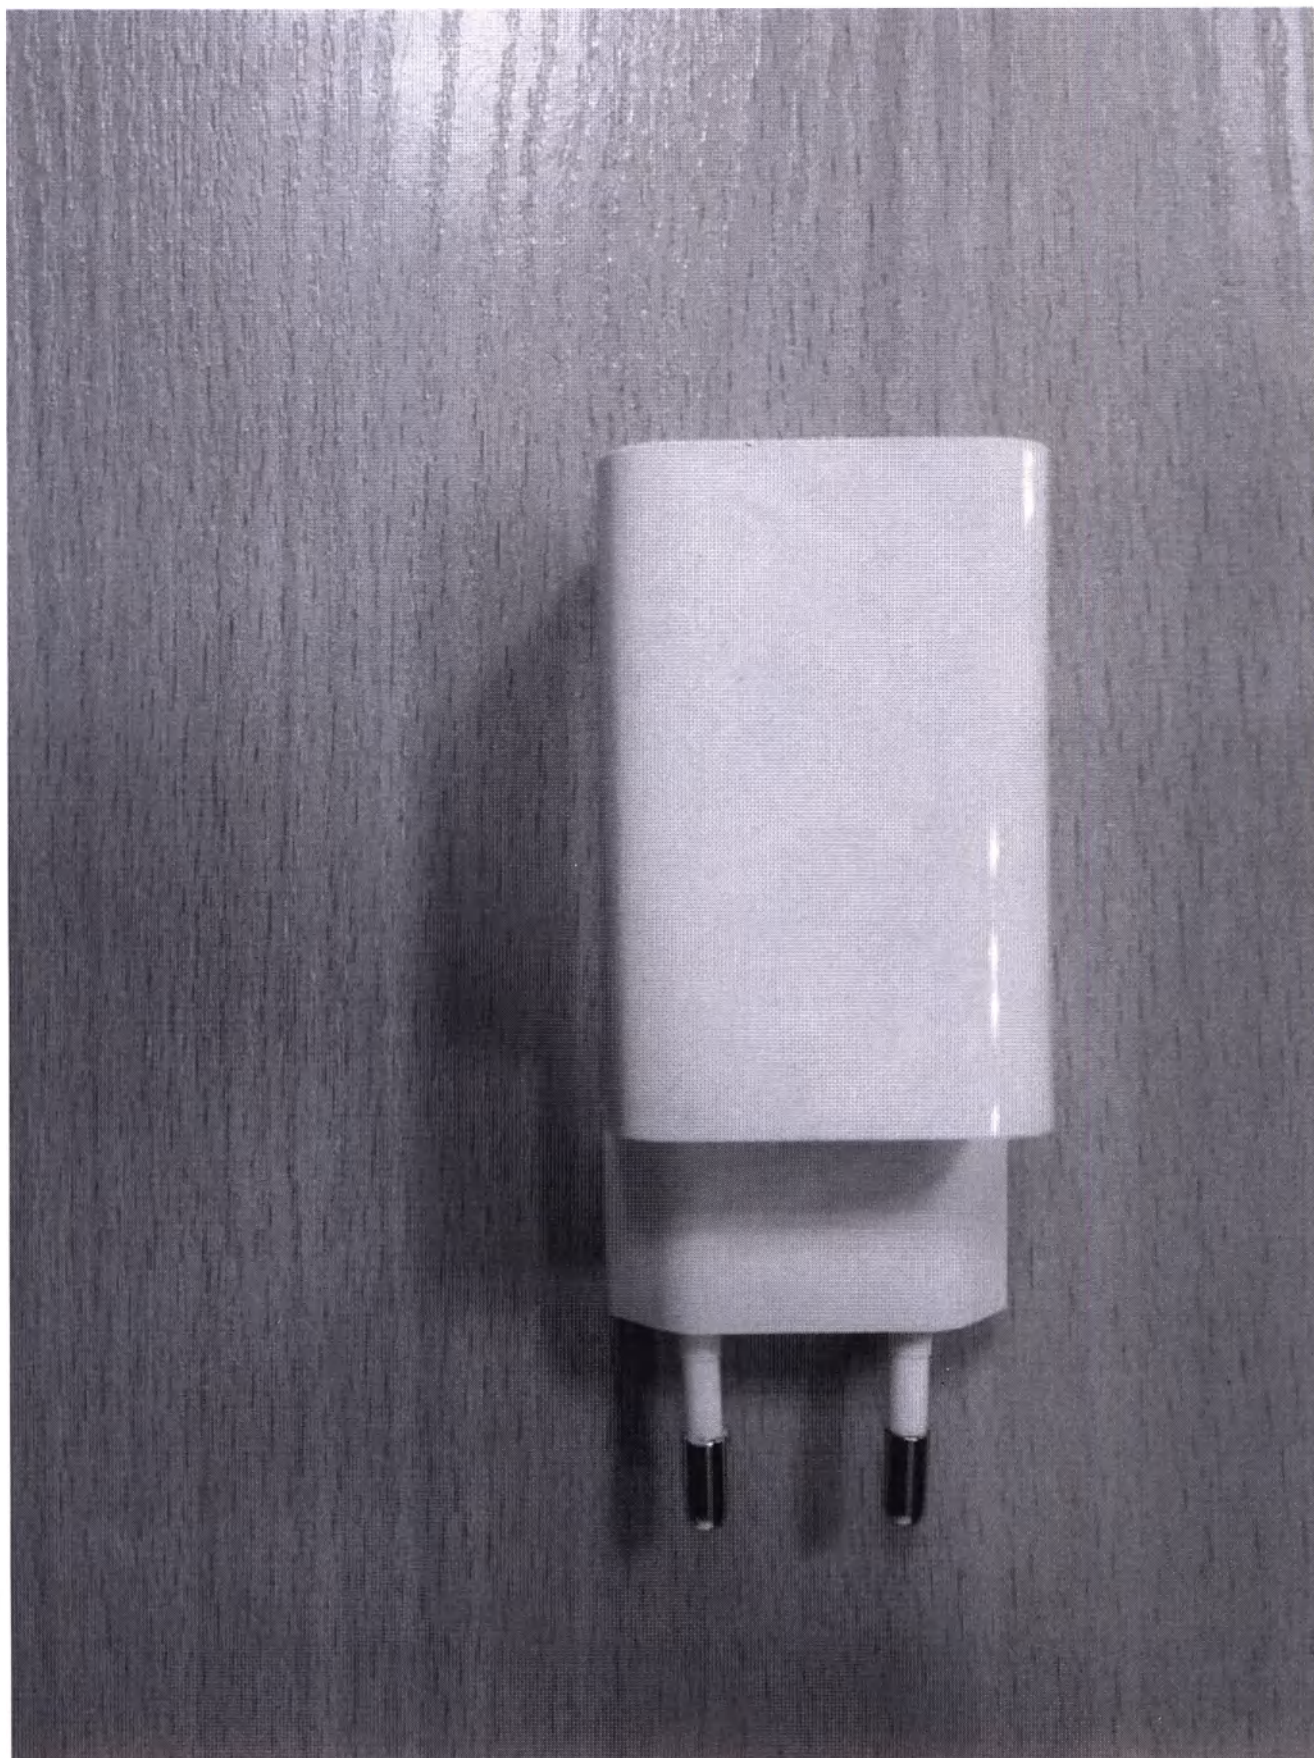

Фотографическое изображение 2. Сетевой адаптер питания

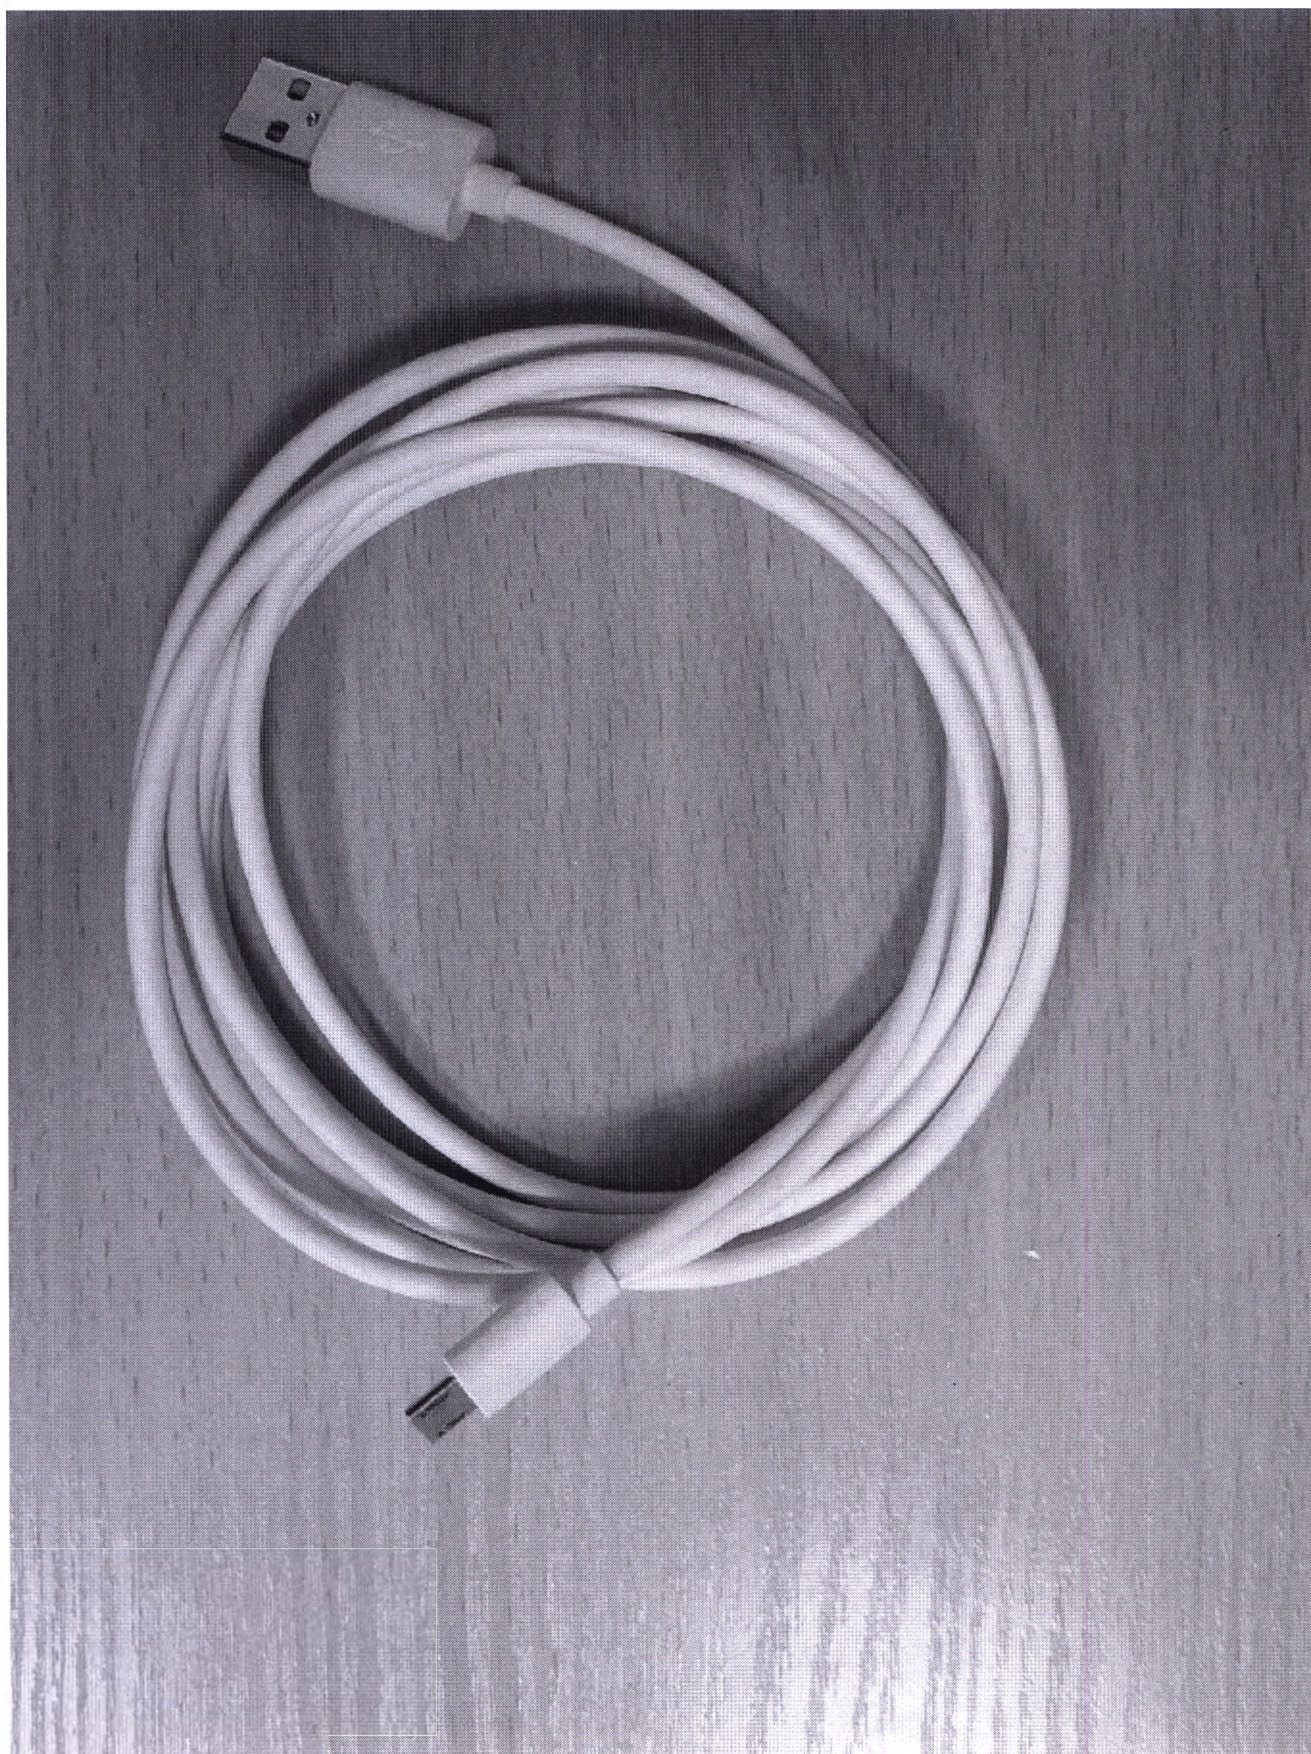


Фотографическое изображение 3. Сетевой кабель

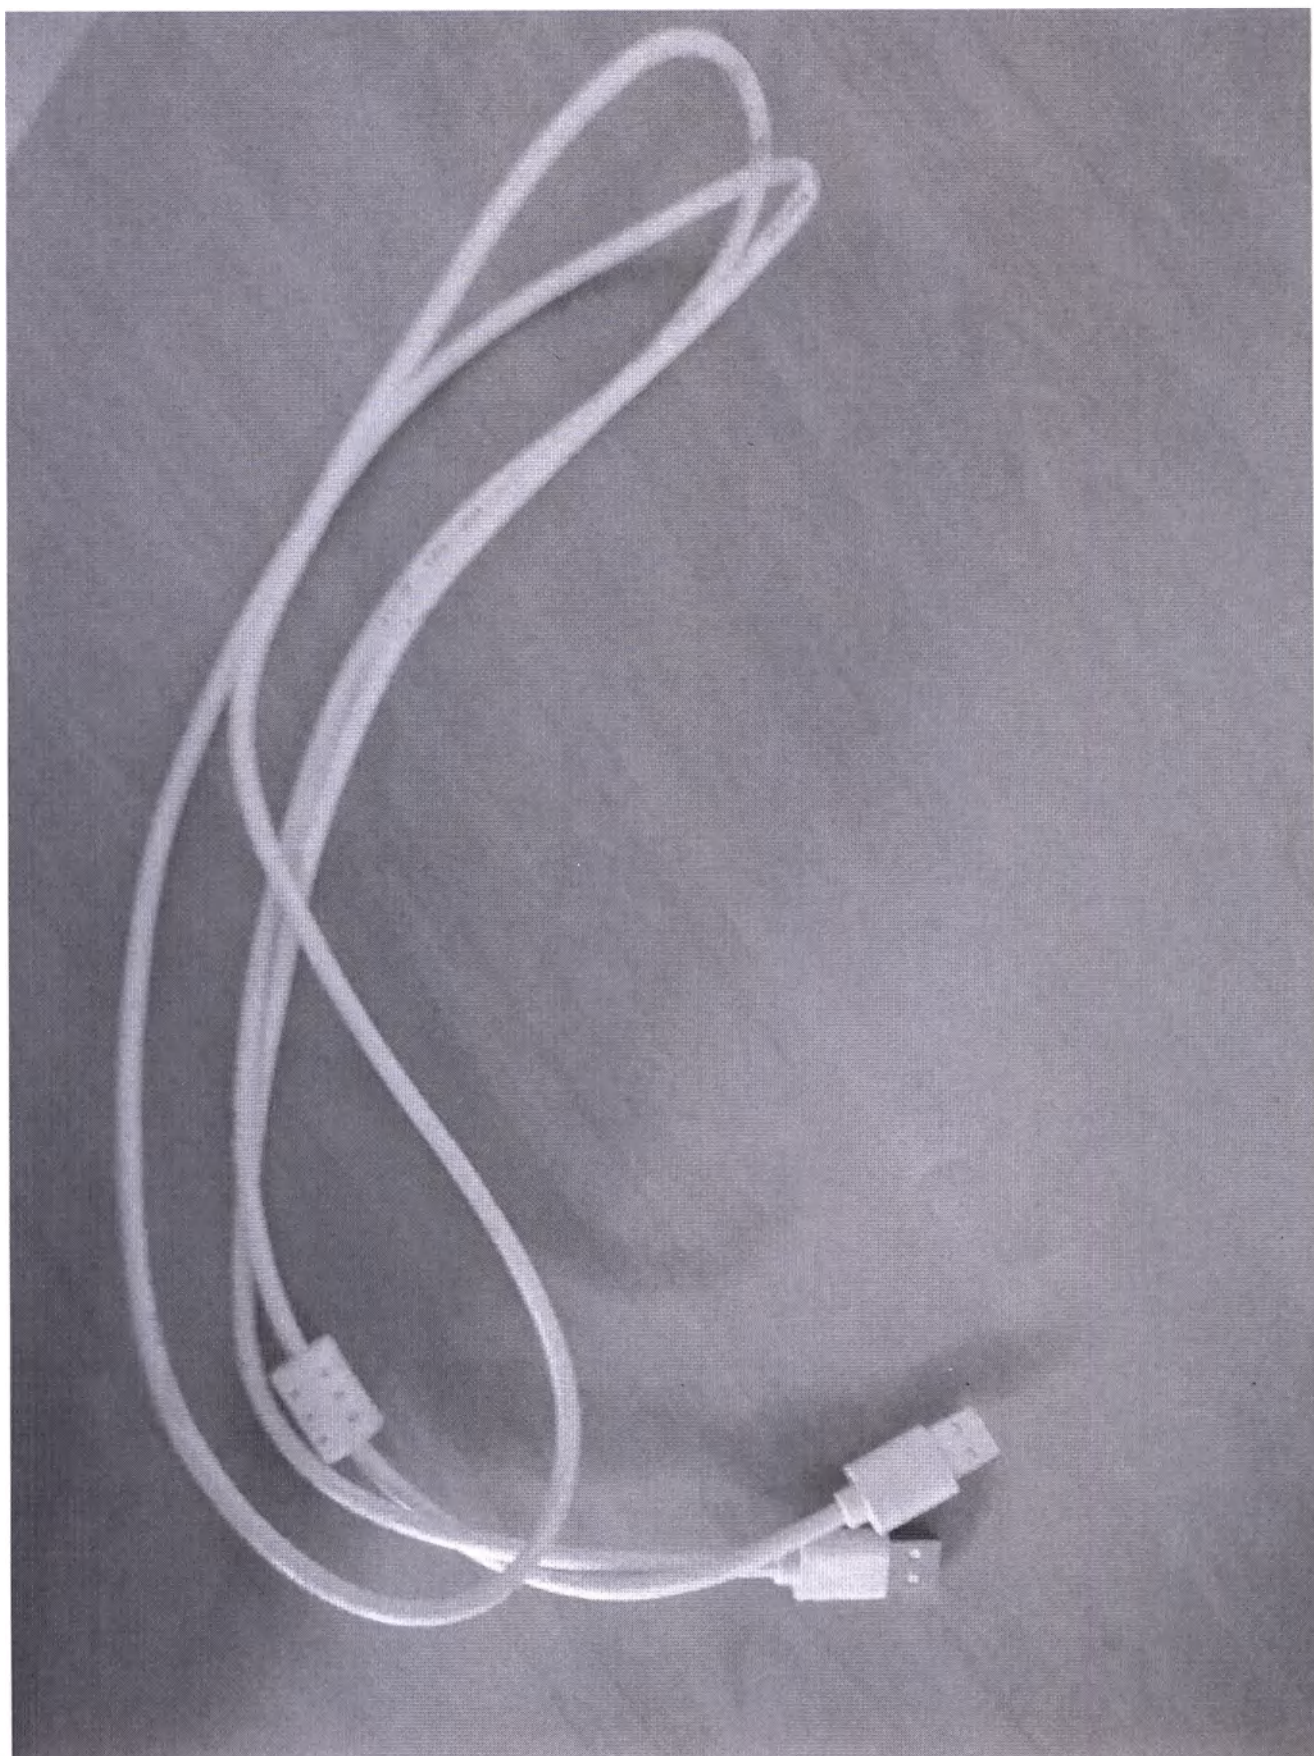

Фотографическое изображение 4. Кабель USB




Фотографическое изображение 5. Мундштук

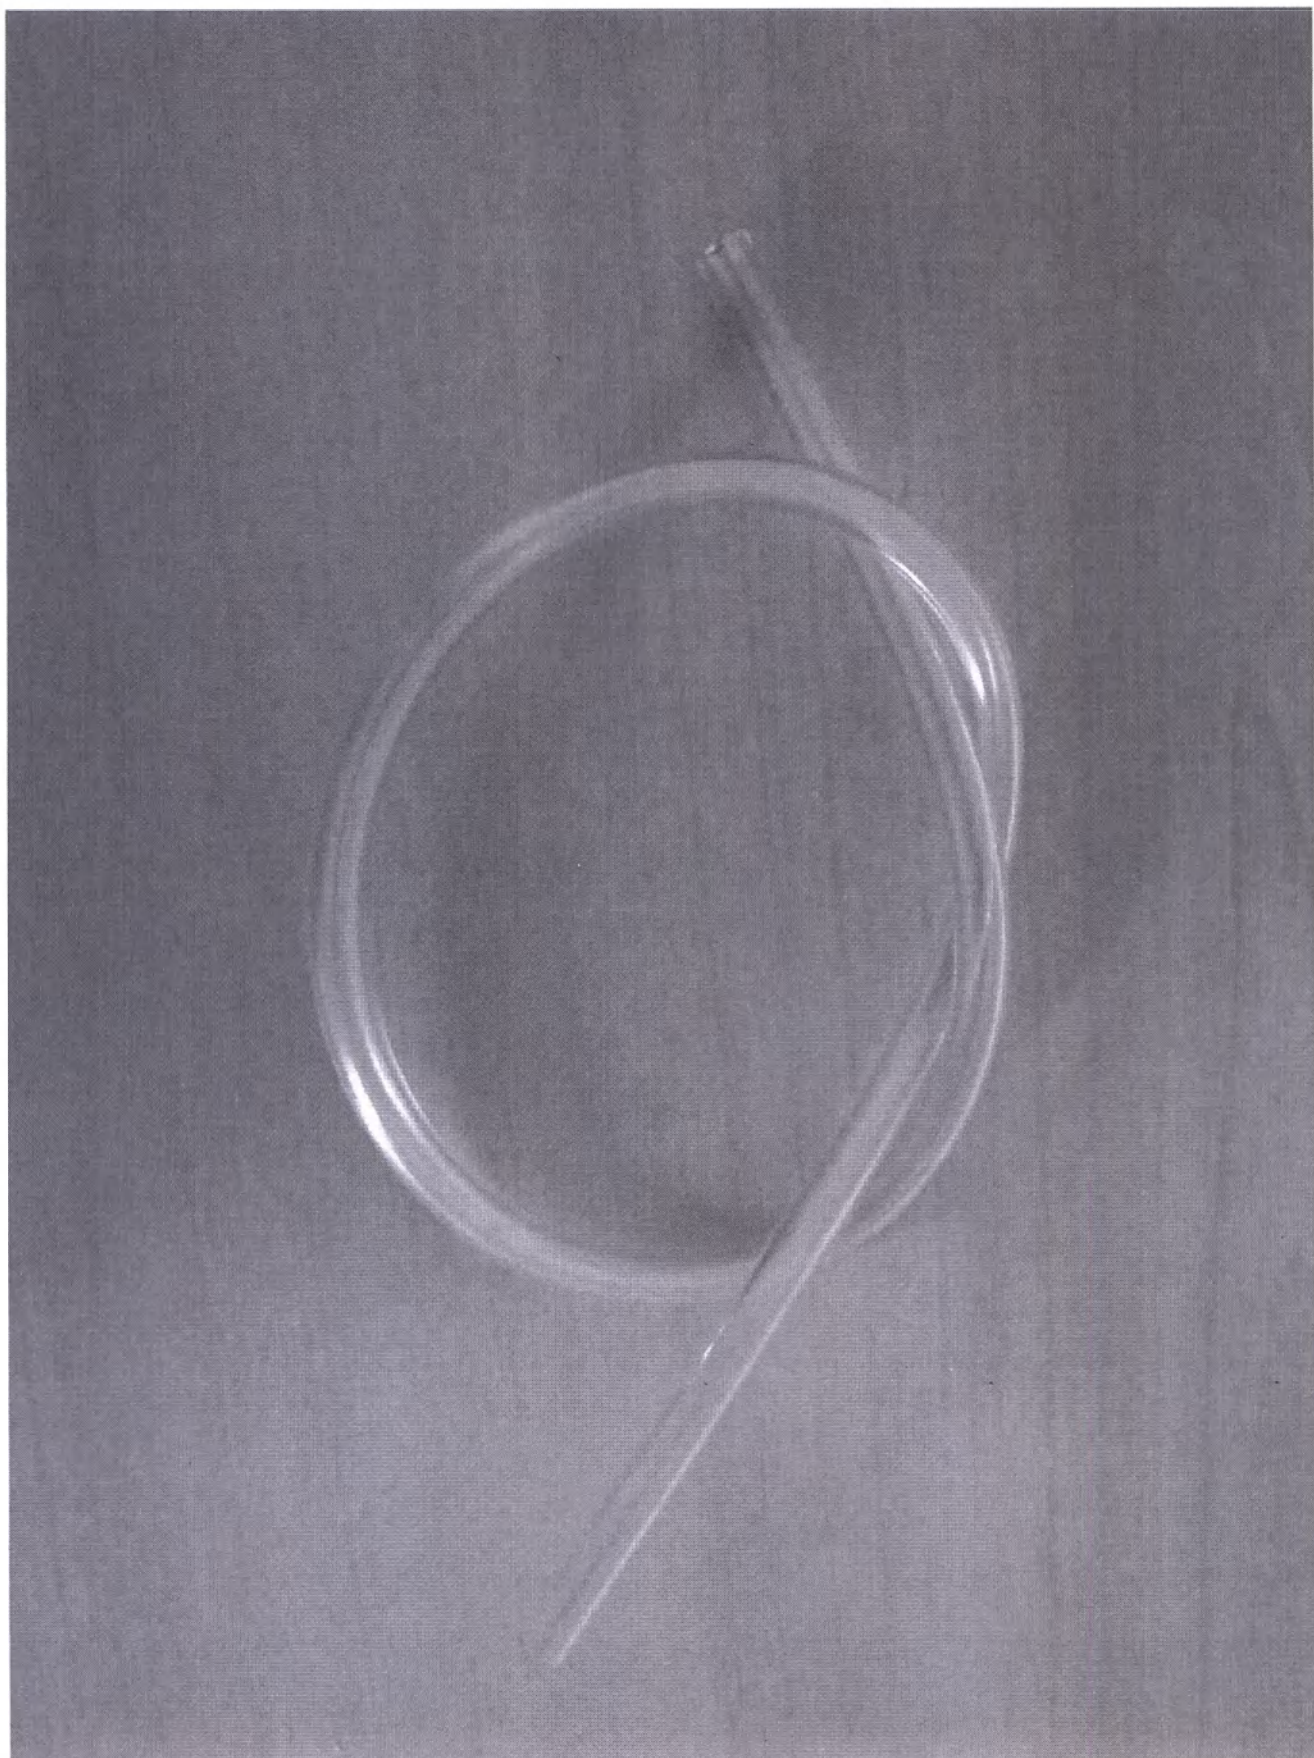


Фотографическое изображение 6. Пробозаборный капилляр



Фотографическое изображение 7. Порция карбамида

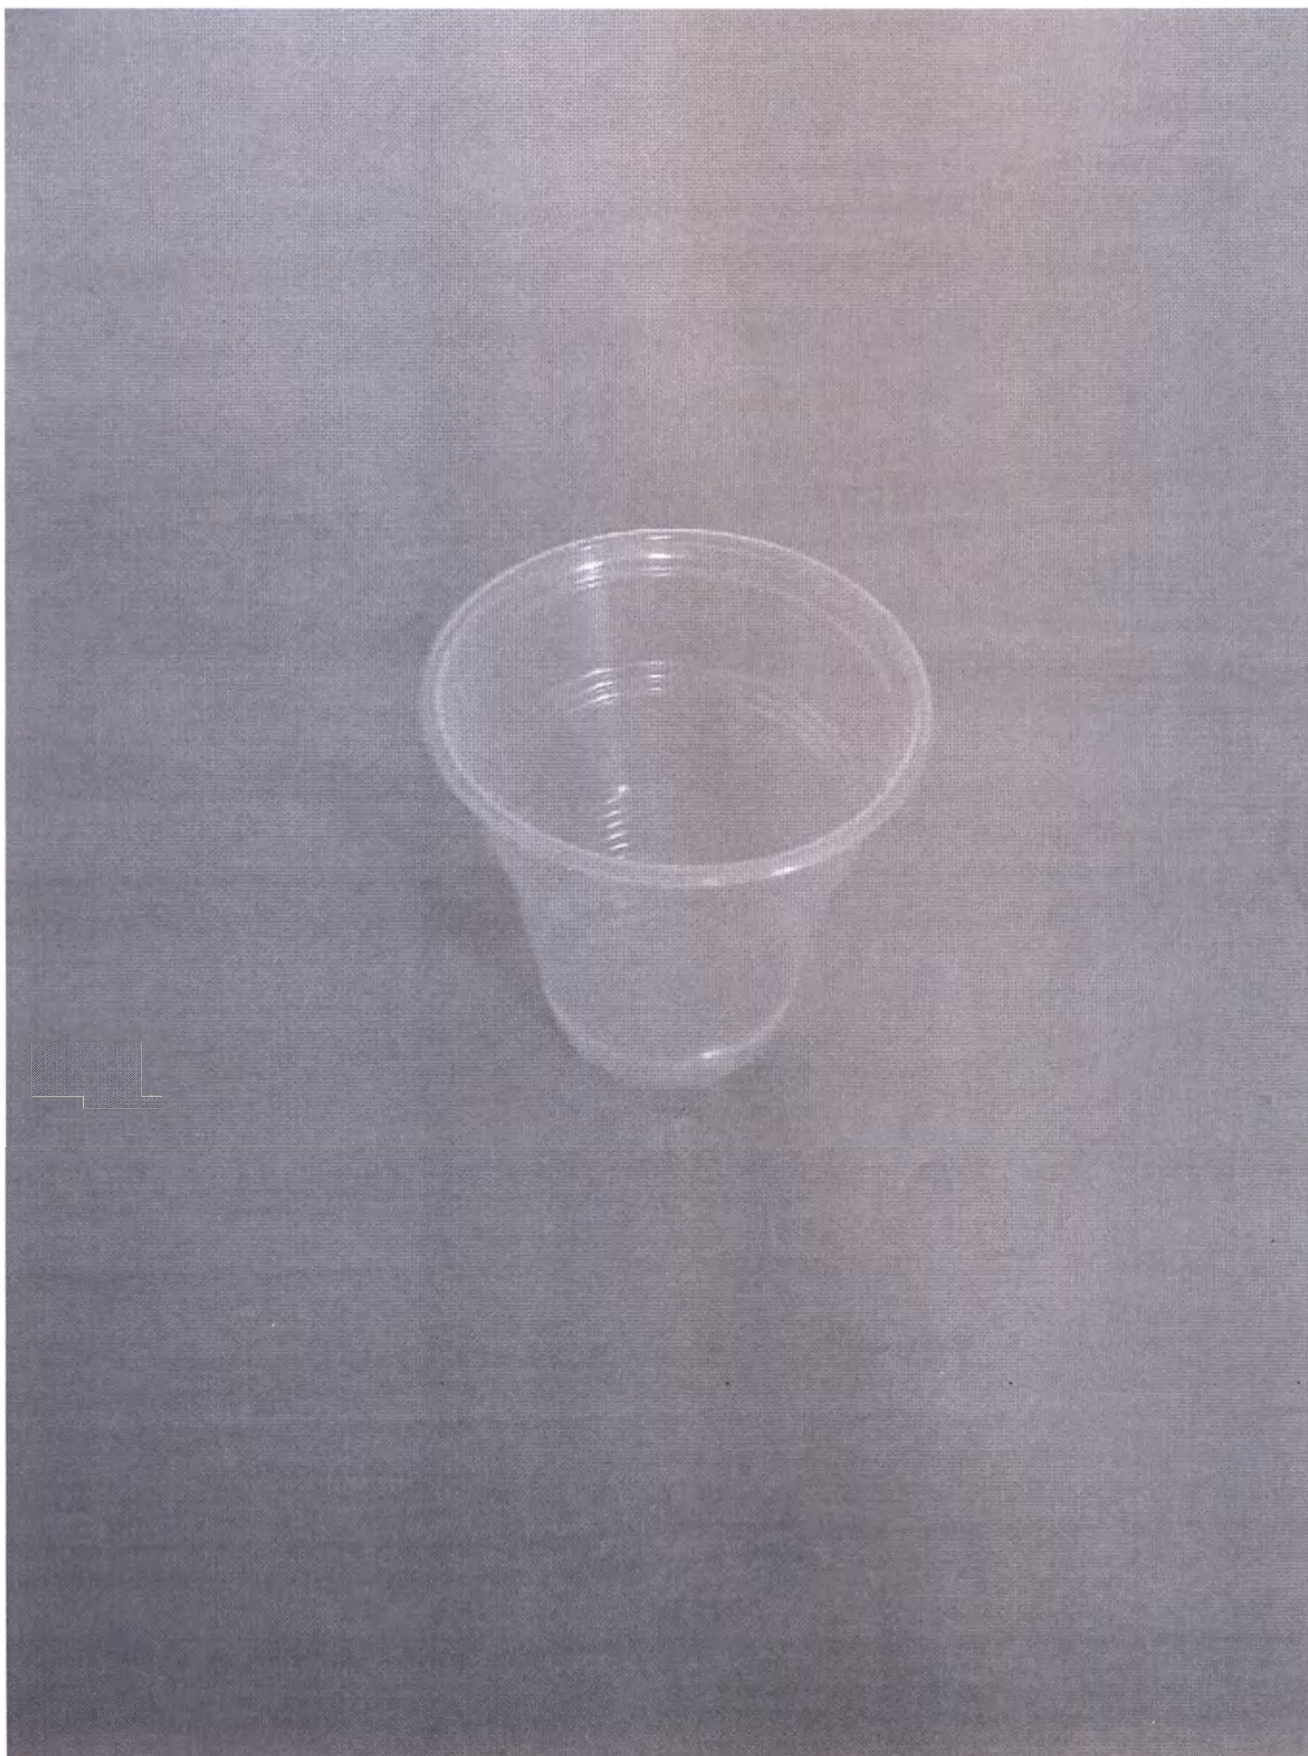

Фотографическое изображение 8. Стаканчик одноразовый

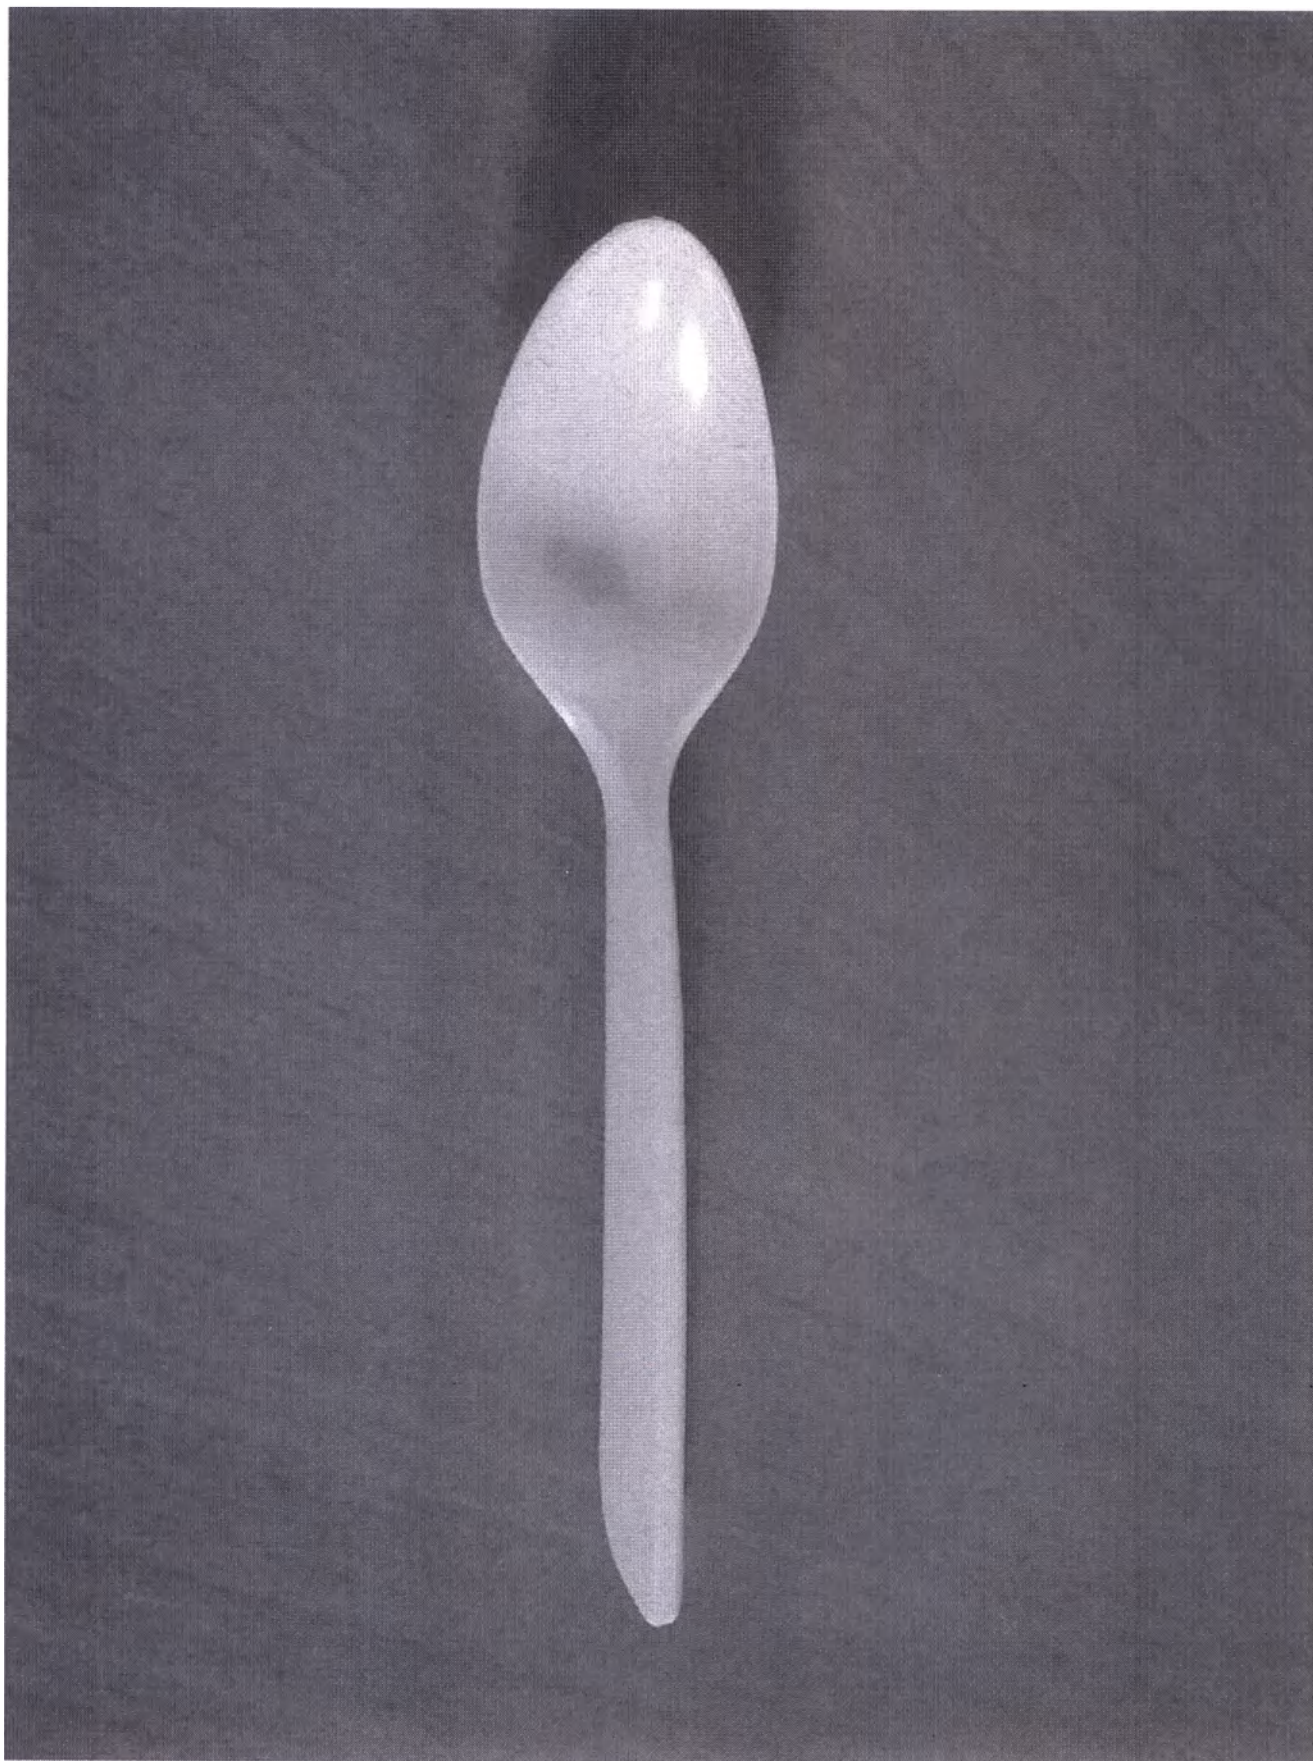


Фотографическое изображение 9. Ложка одноразовая



Фотографическое изображение 10. Стаканчик мерный



Фотографическое изображение 11. Кейс

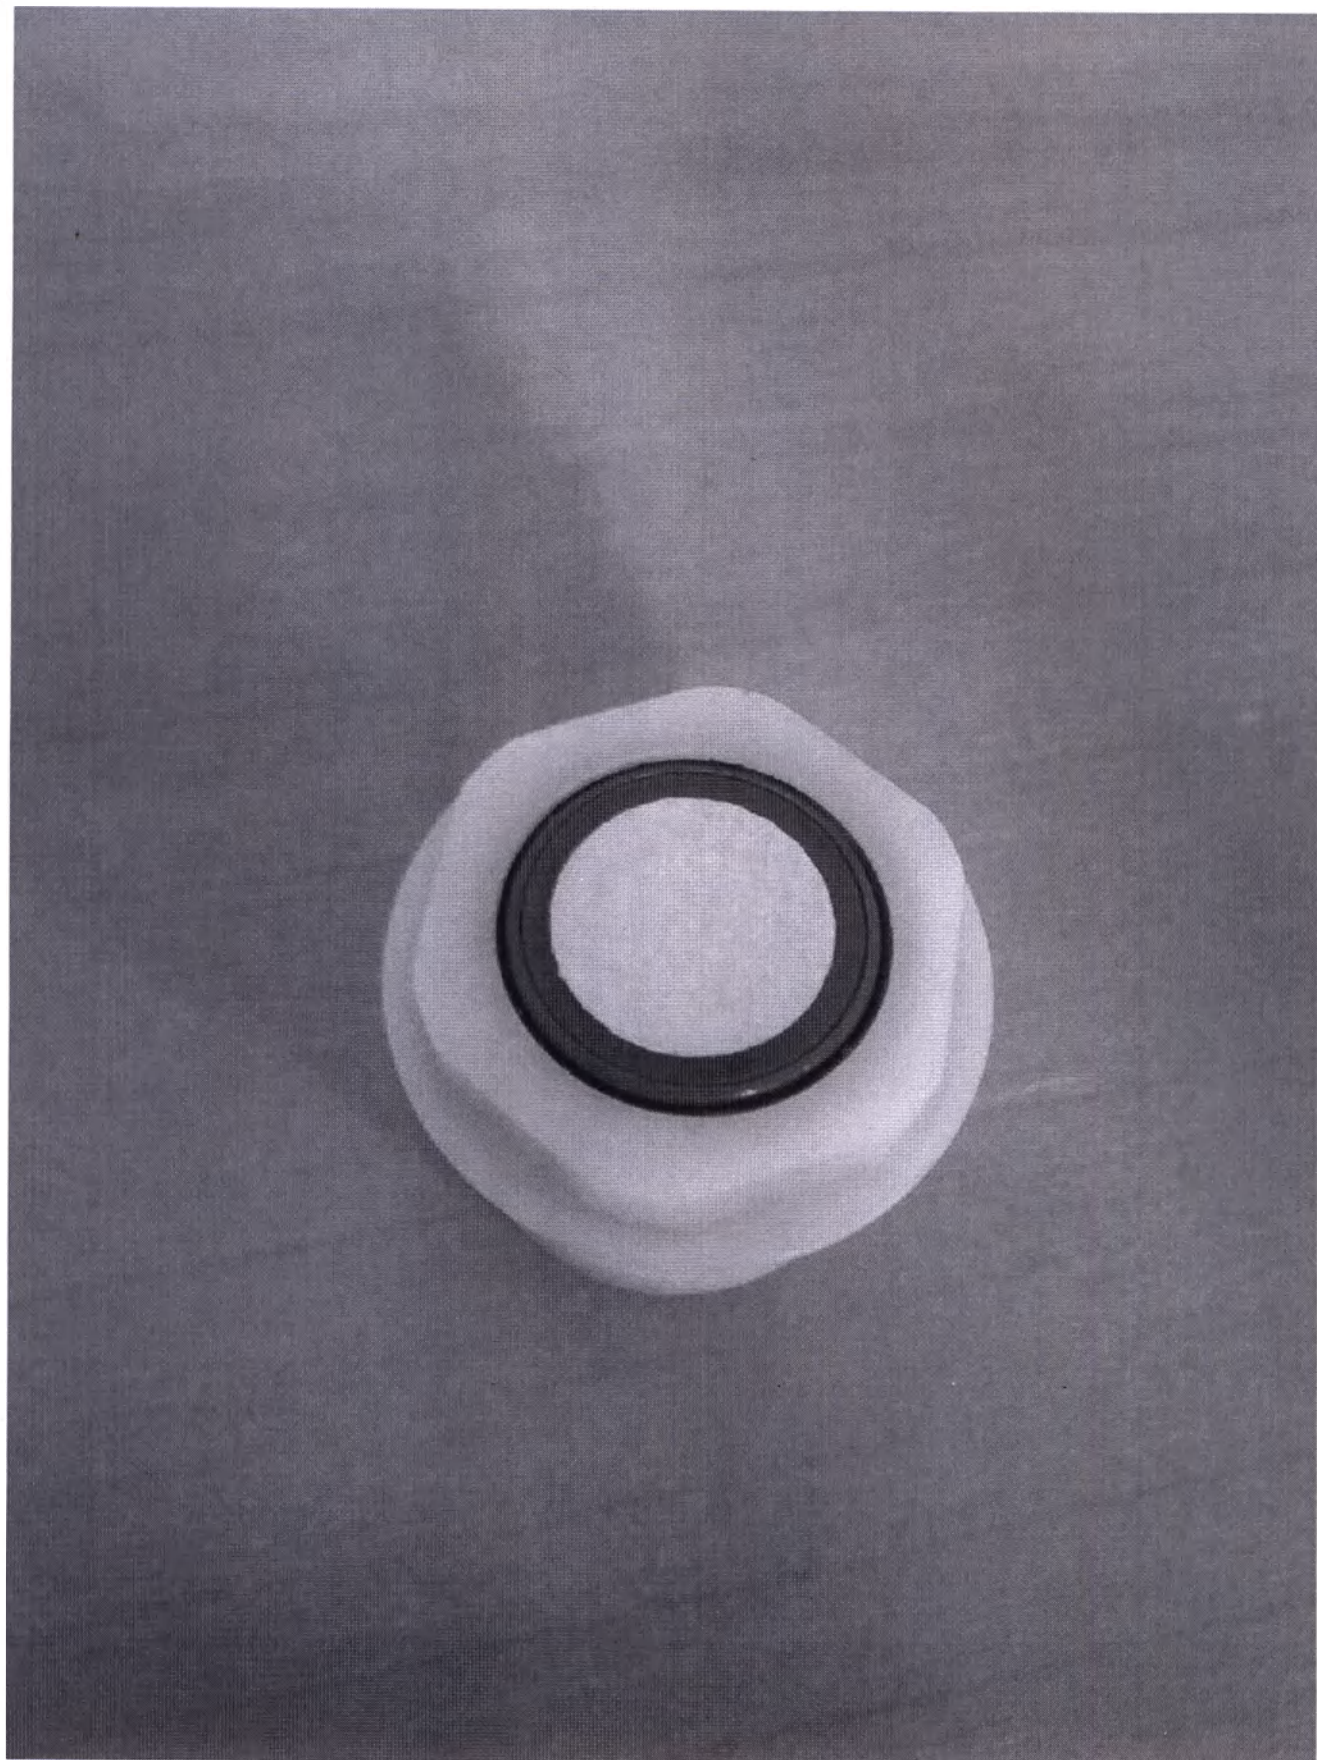

Фотографическое изображение 12. Сменный измерительный модуль

Прибор для диагностики инфицирования человека бактерией
Helicobacter pylori по содержанию аммиака в выдыхаемом
воздухе «ГастроТест» по ТУ 26.60.12-001-16796024-2019
РУ № РЗН 2021/13993 от 12.04.2021

IVD

Транспортировка по условиям хранения 5

Хранить при температуре от 5 до 40 °С

Гарантийный срок хранения 12 месяцев Дата изготовления 2021г

Вес нетто 3.9кг Вес брутто 4.2кг



ООО «НТП ТКА», 192289, Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, Грузовой проезд, д. 33, корп.1, литер Б
Тел. (812)331-19-89

Фотографическое изображение 13. Маркировка упаковки Прибора для диагностики инфицирования человека бактерией *Helicobacter pylori* по содержанию аммиака в выдыхаемом воздухе «ГастроТест» по ТУ 26.60.12-001-16796024-2019


Прибор для диагностики инфицирования
человека бактерией *Helicobacter pylori* по
содержанию аммиака в выдыхаемом воздухе
«ГастроТест» по ТУ 26.60.12-001-16796024-2019
Сменный измерительный модуль

Кол-во: 1 штук



ООО «НТП ТКА», 192289,
Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, Грузовой проезд, д. 33,
корп.1, литер Б
Тел./факс (812)331-19-81,
(812) 331-19-82

Фотографическое изображение 14. Маркировка упаковки сменного измерительного модуля

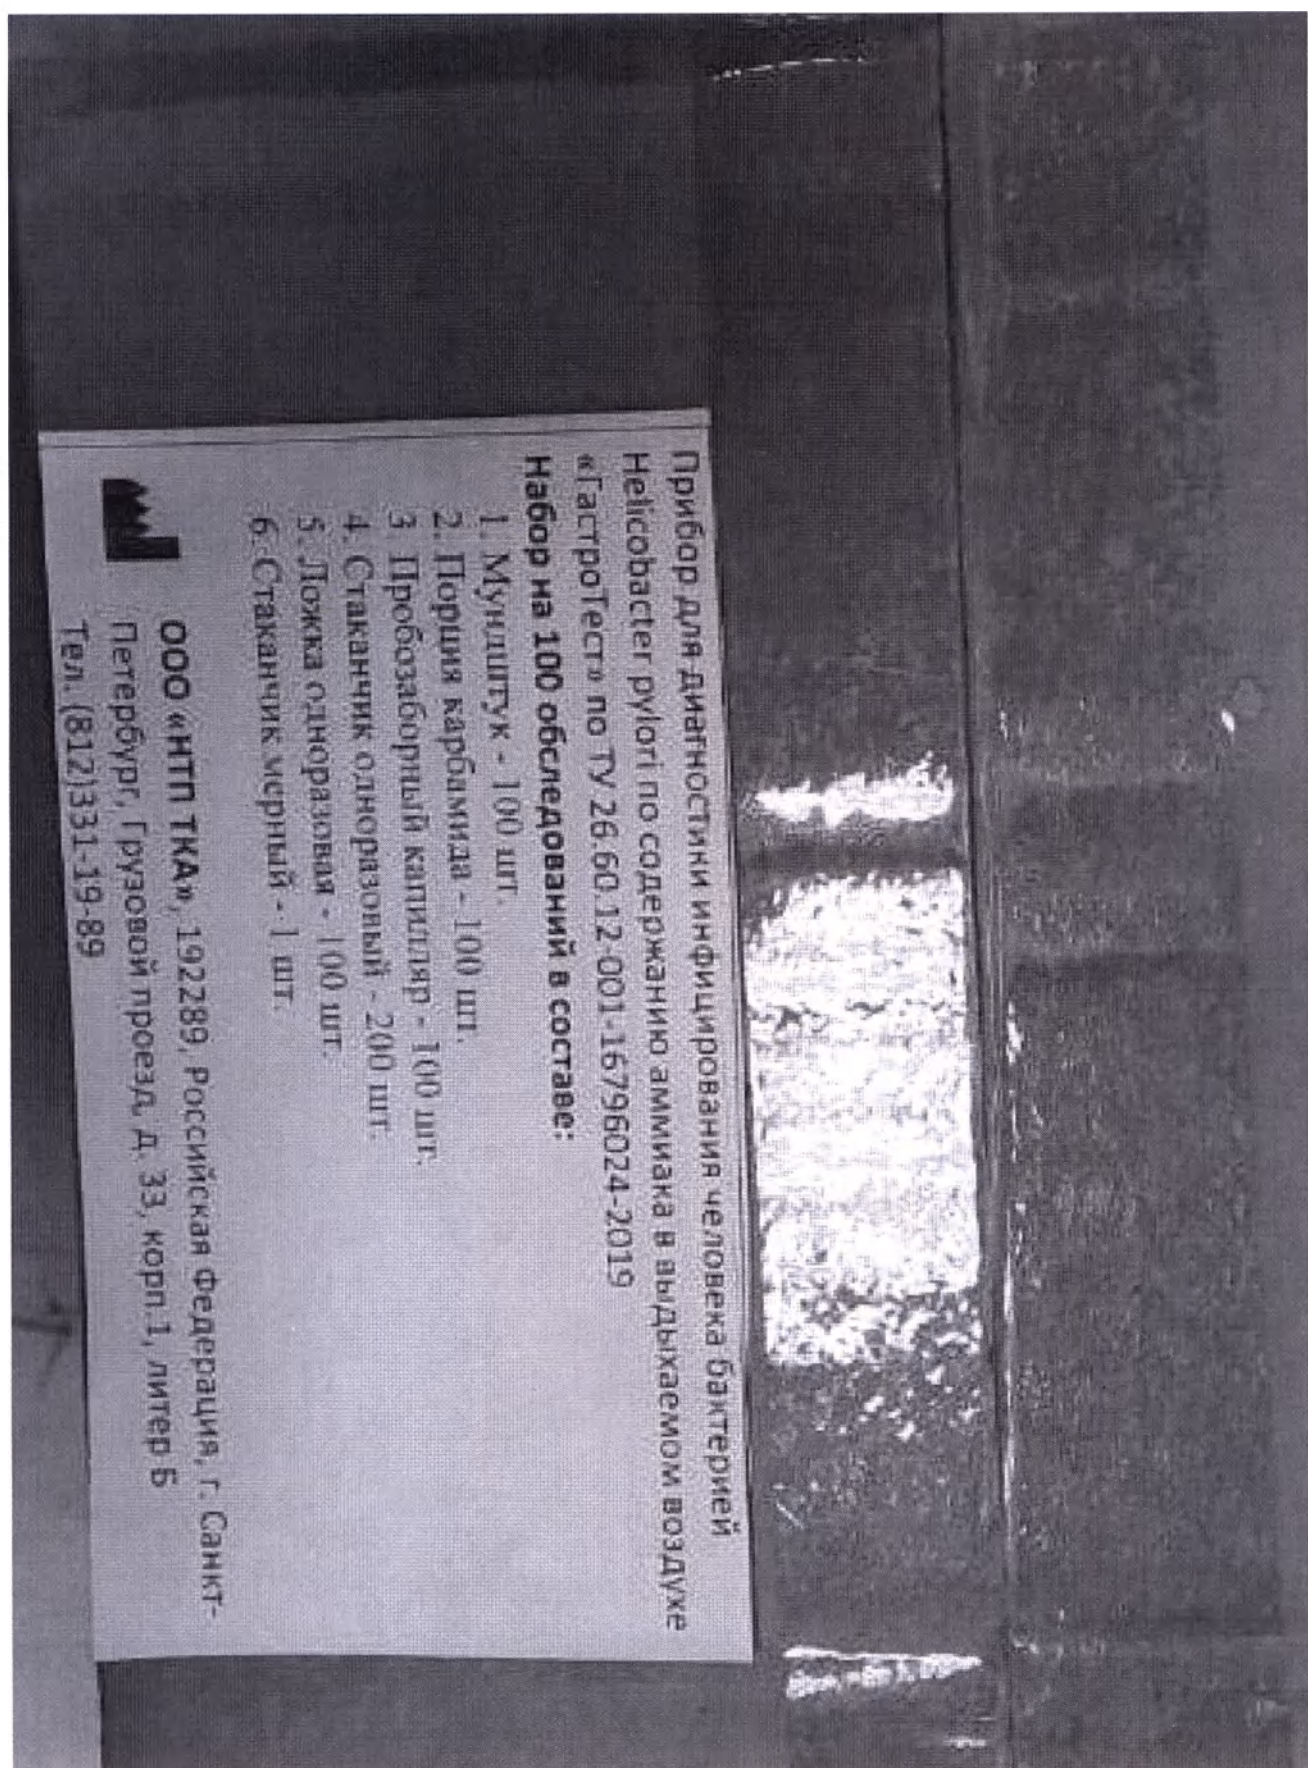


Прибор для диагностики инфицирования человека бактерией
Neisseria meningitidis по содержанию аммиака в выдыхаемом воздухе
«ГастроТест» по ТУ 26.60.12-001-16/96024-2019
Набор на 100 обследований в составе:

1. Мультишпатель - 100 шт.
2. Порция карбамидов - 100 шт.
3. Пробозаборный капилляр - 100 шт.
4. Стаканчик одноразовый - 200 шт.
5. Ложка одноразовая - 100 шт.
6. Стаканчик мерный - 1 шт.

ООО «НТП ТКД», 192289, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 33, корп. 1, литер Б
Тел. (812) 331-19-89

Фотографическое изображение 15. Маркировка упаковки набора на 100 обследований

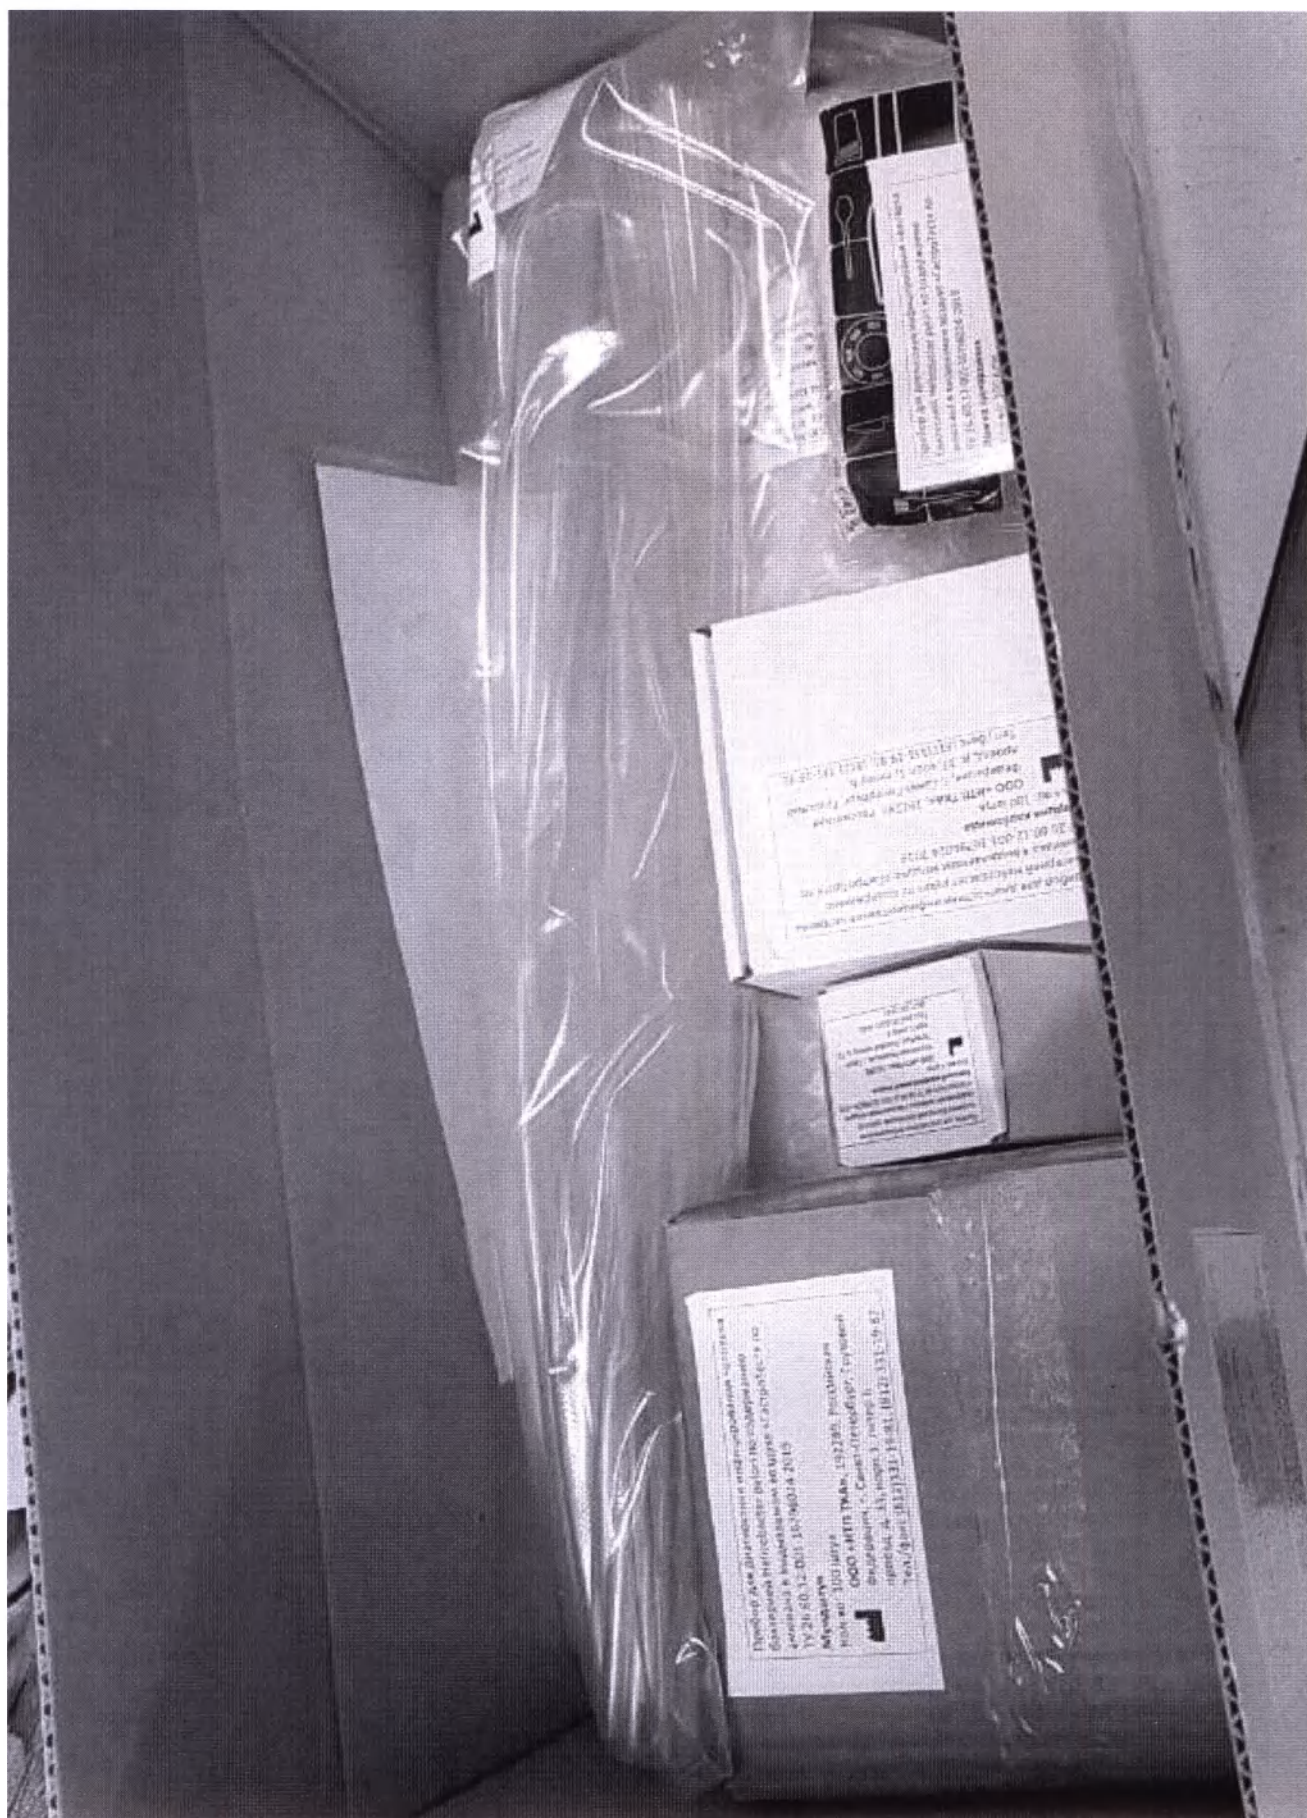

Фотографическое изображение 16. Набор на 100 обследований в упаковке

Прибор для диагностики инфицирования человека
бактерией *Helicobacter pylori* по содержанию
аммиака в выдыхаемом воздухе «ГастроТест» по
ТУ 26.60.12-001-16796024-2019


Порция карбамида

Кол-во: 100 штук



ООО «НТП ТКА», 192289, Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, Грузовой
проезд, д. 33, корп.1, литер Б
Тел./факс (812)331-19-81, (812) 331-19-82

Фотографическое изображение 17. Маркировка порции карбамида

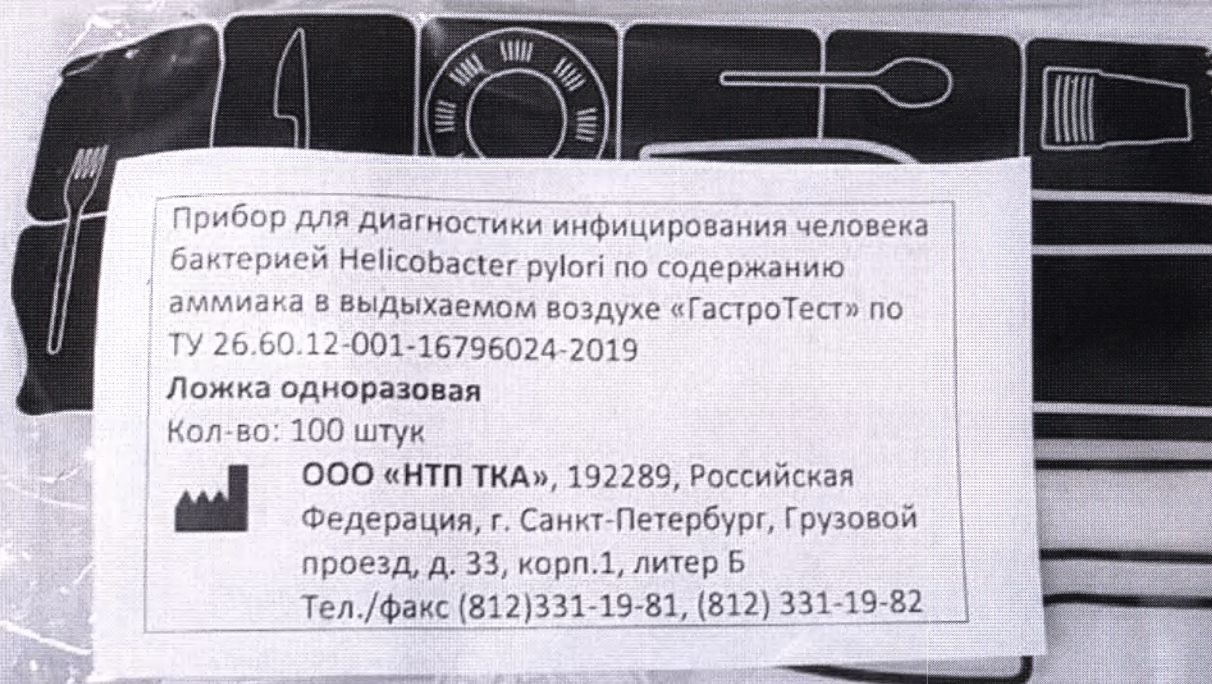

Прибор для диагностики инфицирования человека
бактерией *Helicobacter pylori* по содержанию
аммиака в выдыхаемом воздухе «ГастроТест» по
ТУ 26.60.12-001-16796024-2019

Ложка одноразовая

Кол-во: 100 штук



ООО «НТП ТКА», 192289, Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, Грузовой
проезд, д. 33, корп.1, литер Б
Тел./факс (812)331-19-81, (812) 331-19-82

Фотографическое изображение 18. Маркировка ложки одноразовой

Прибор для диагностики инфицирования человека
бактерией *Helicobacter pylori* по содержанию
аммиака в выдыхаемом воздухе «ГастроТест» по
ТУ 26.60.12-001-16796024-2019

Стаканчик мерный

Кол-во: 1 штук



ООО «НТП ТКА», 192289, Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, Грузовой
проезд, д. 33, корп.1, литер Б
Тел./факс (812)331-19-81, (812) 331-19-82

Фотографическое изображение 19. Маркировка стаканчика мерного


Прибор для диагностики инфицирования человека
бактерией *Helicobacter pylori* по содержанию
аммиака в выдыхаемом воздухе «ГастроТест» по
ТУ 26.60.12-001-16796024-2019

Мундштук

Кол-во: 100 штук



ООО «НТП ТКА», 192289, Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, Грузовой
проезд, д. 33, корп.1, литер Б
Тел./факс (812)331-19-81, (812) 331-19-82

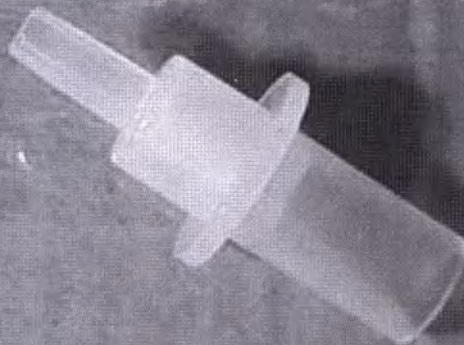

Фотографическое изображение 20. Маркировка мундштука


Прибор для диагностики инфицирования человека
бактерией *Helicobacter pylori* по содержанию
аммиака в выдыхаемом воздухе «ГастроТест» по
ТУ 26.60.12-001-16796024-2019

Пробозаборный капилляр

Кол-во: 100 штук




ООО «НТП ТКА», 192289, Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, Грузовой
проезд, д. 33, корп.1, литер Б
Тел./факс (812)331-19-81, (812) 331-19-82

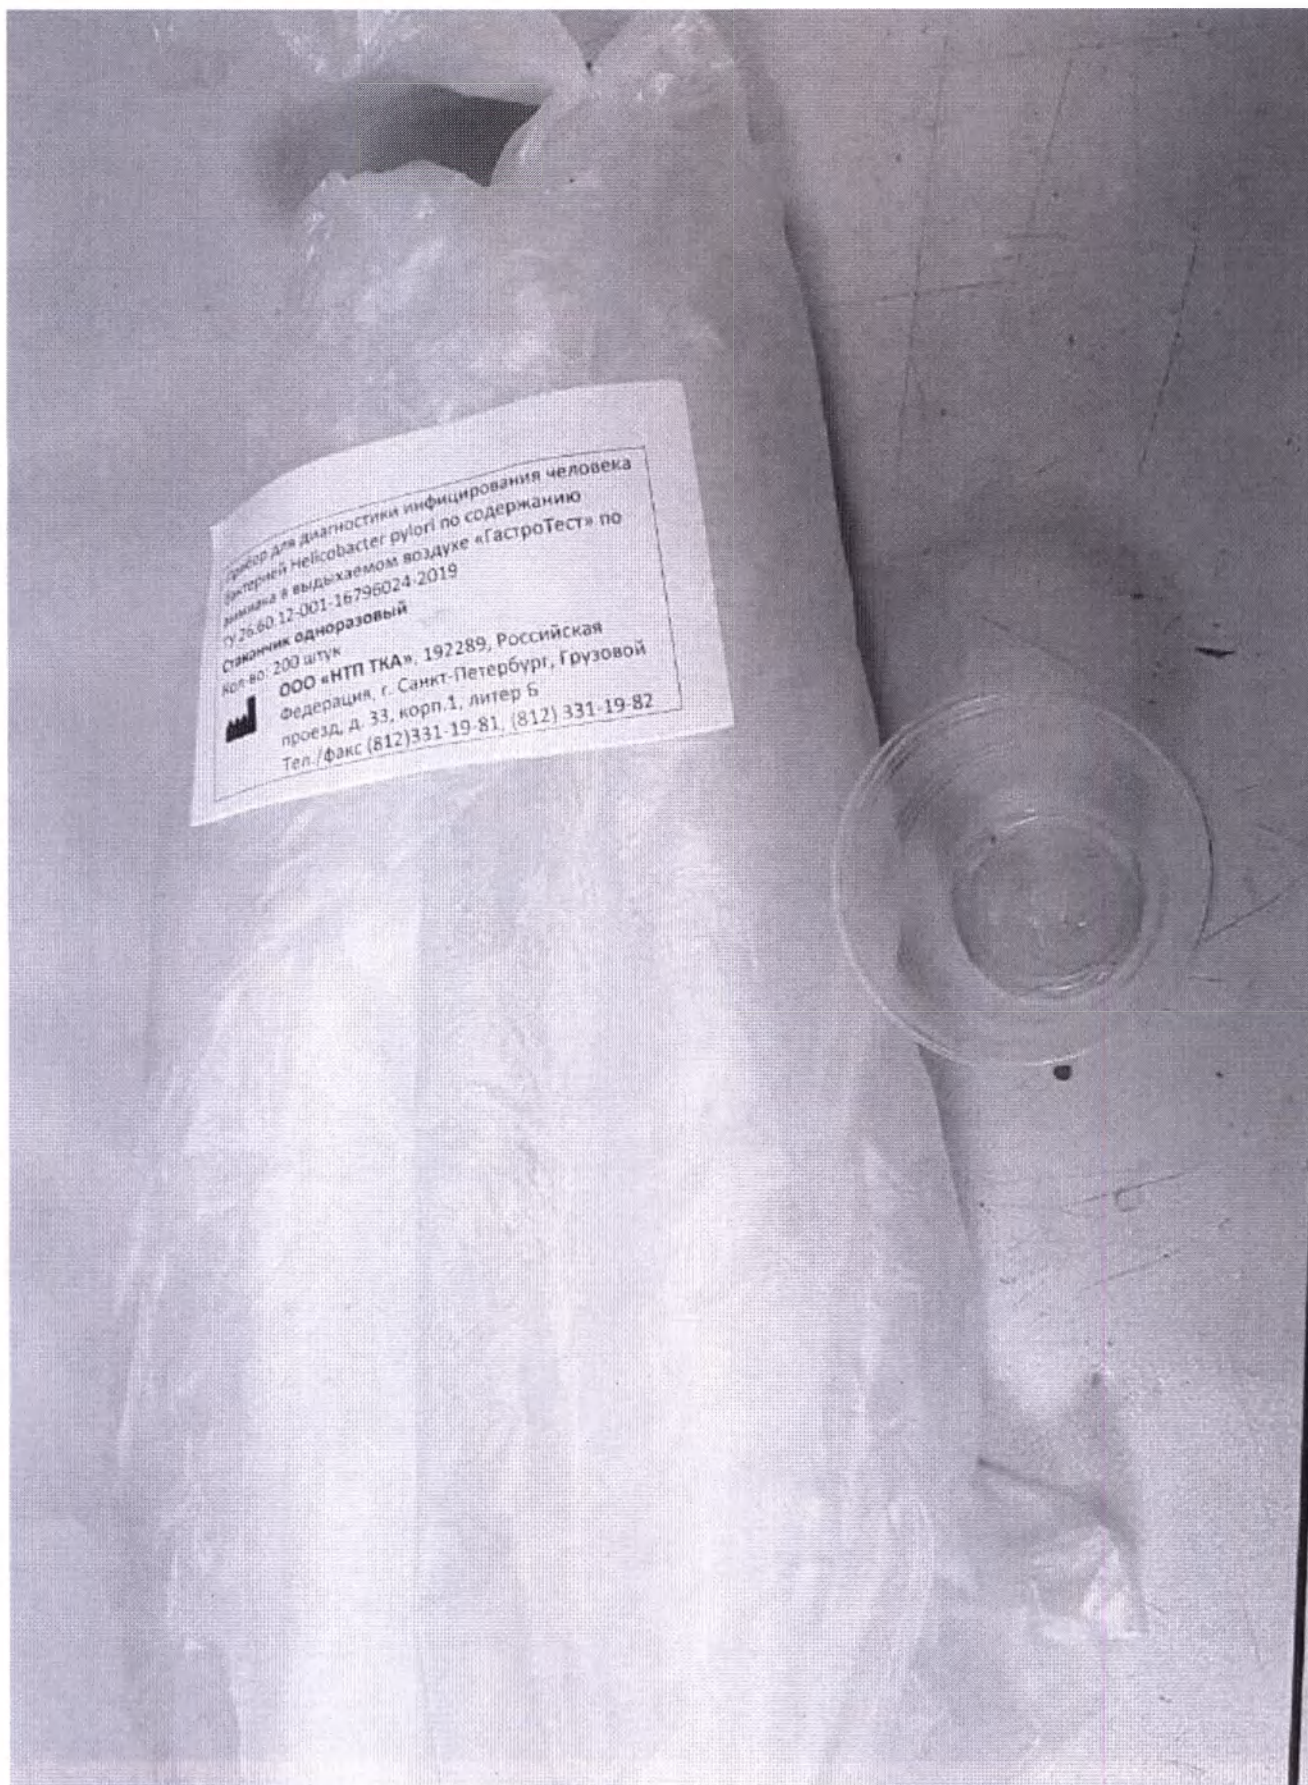


Фотографическое изображение 22. Маркировка стаканчика одноразового



Фотографическое изображение 23. Маркировка портов для подключения кабелей на изделии

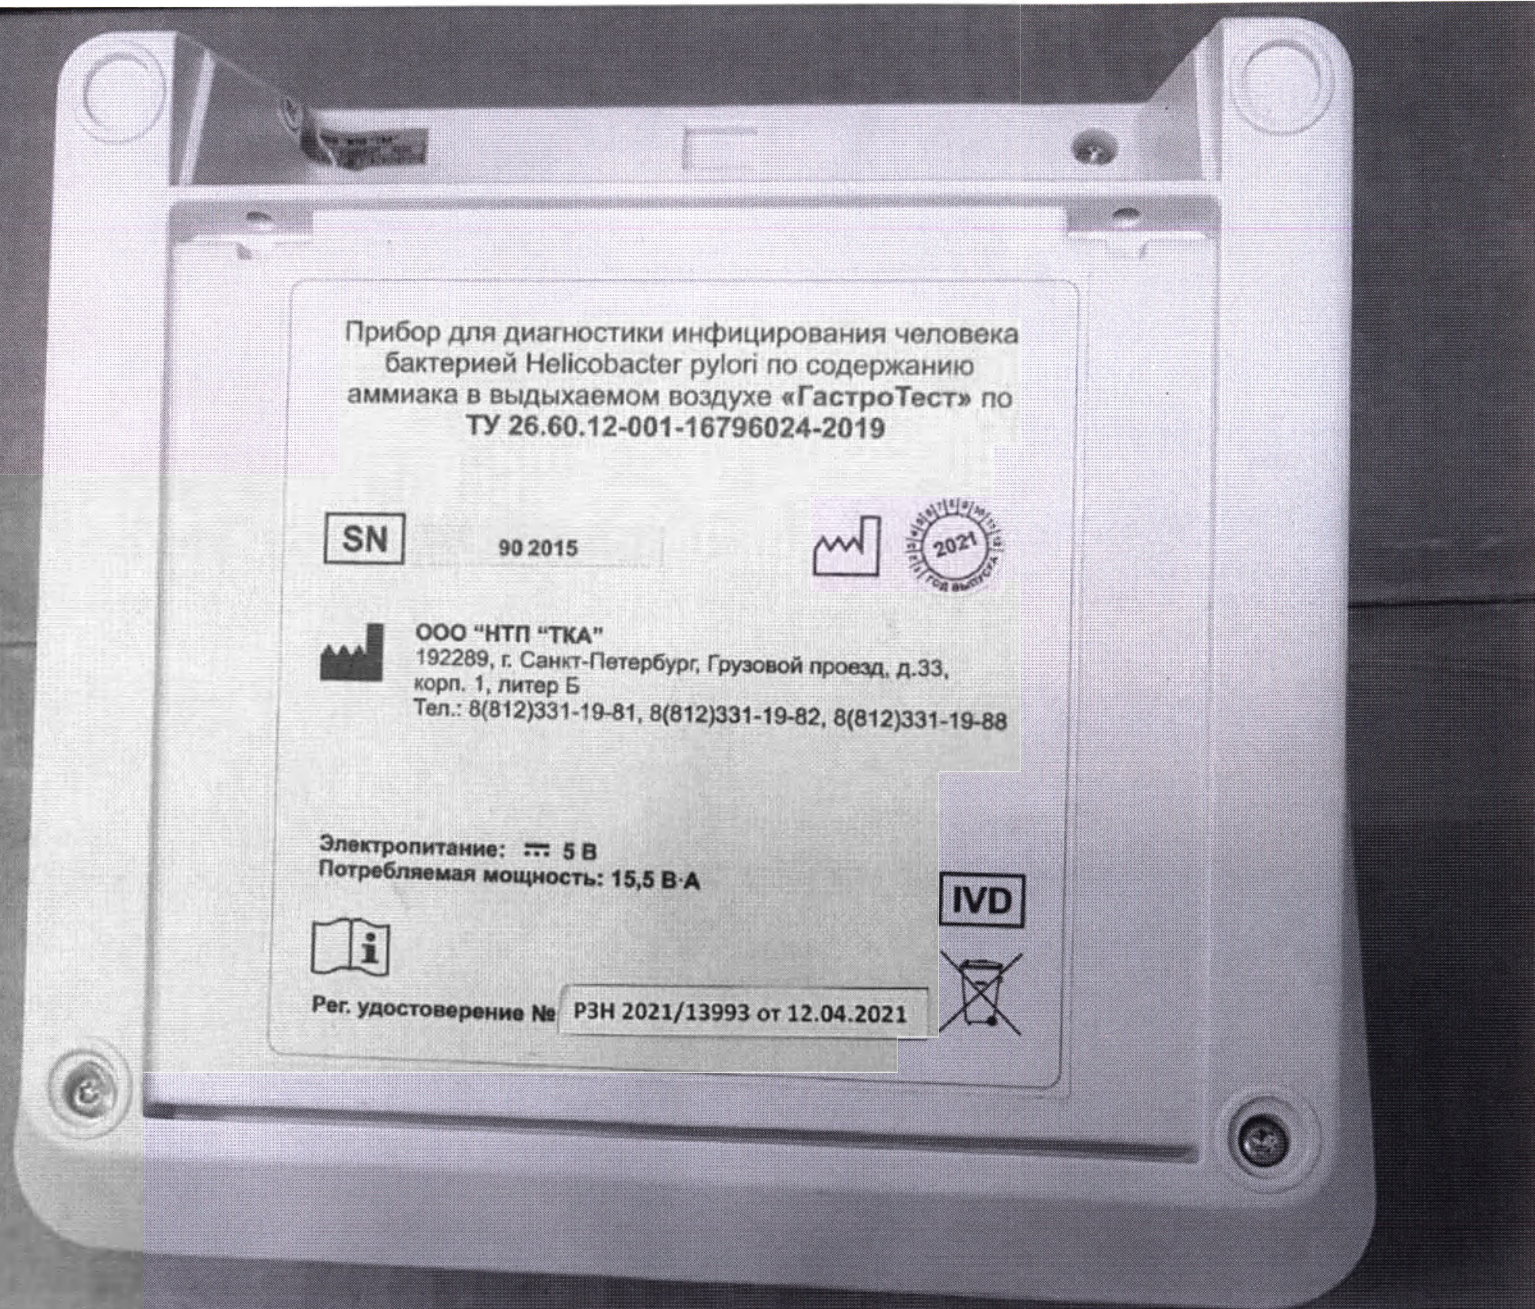

Фотографическое изображение 24. Маркировка изделия

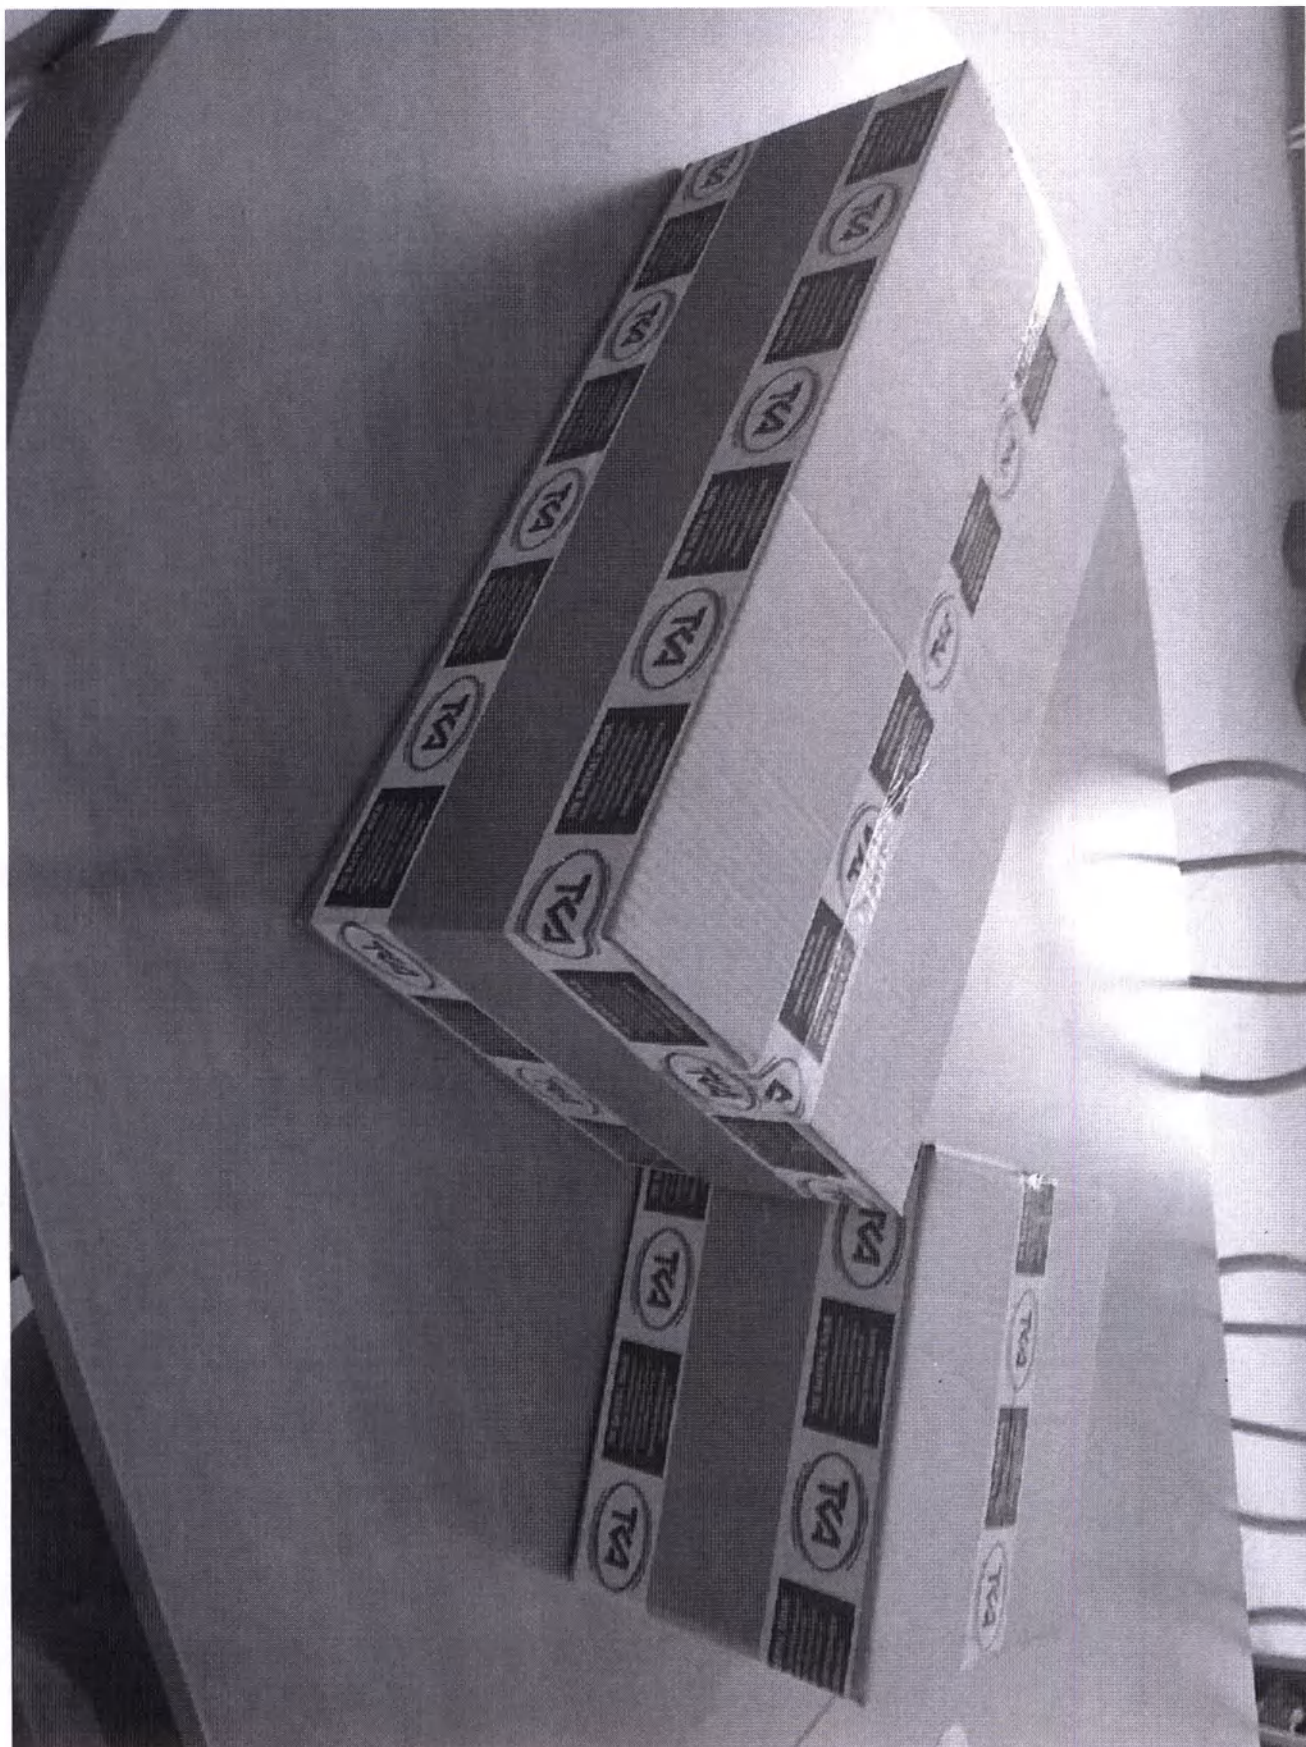

Фотографическое изображение 25. Упаковка изделия

В настоящем документе
прошито и пронумеровано

(25) листов

Генеральный директор
ООО «НТП «ТКА» _____ В.А. Томский

