

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор,
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова
« 27 » июля 2021



М.П. ХИНА Ю.Ю.

ДОВЕРЕННОСТИ
№ 77 АГ 5987517

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Обеспечение программное медицинское Myrian® для медицинских
изображений стандарта DICOM
INTRASENSE (Интрасенсе), Франция

2021

Рисунок 1 Внешний вид рабочего пространства

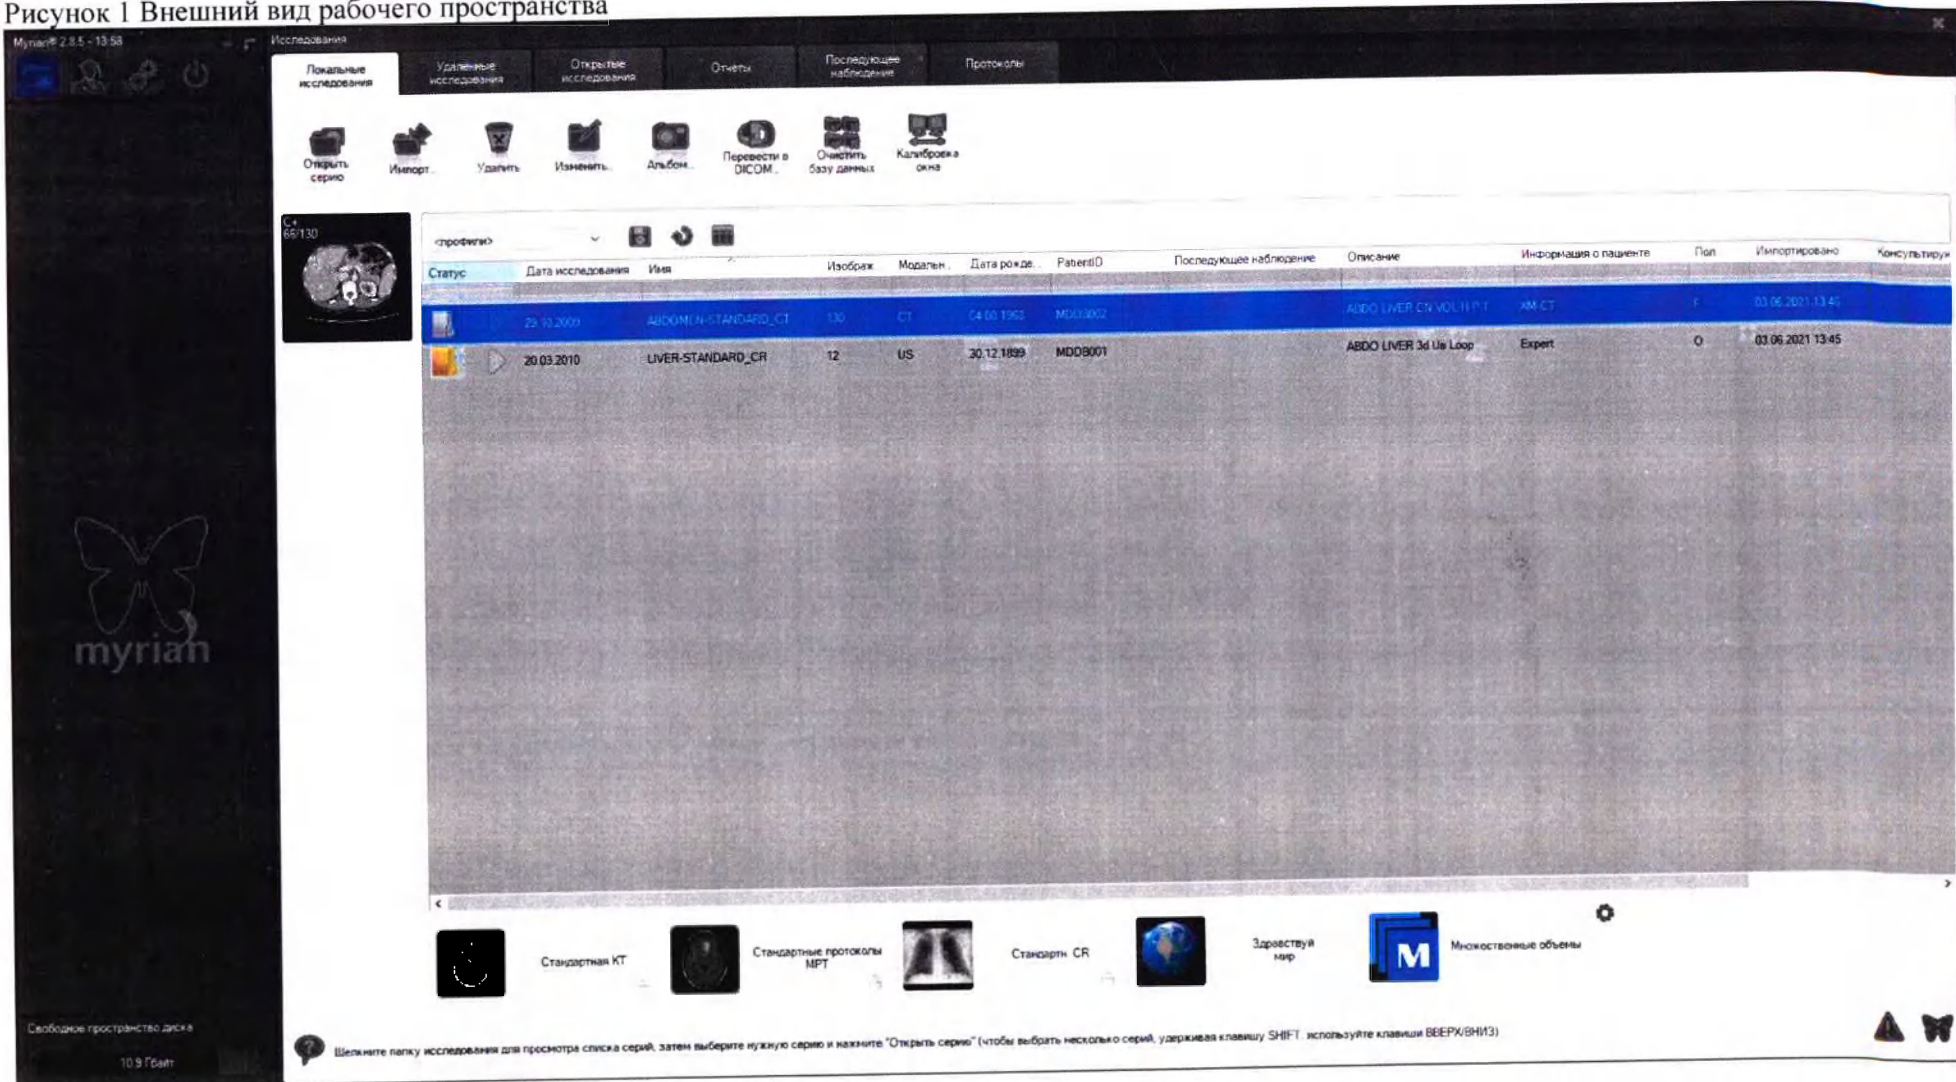


Рисунок 2 Внешний вид Вкладки «Удаленно исследование»

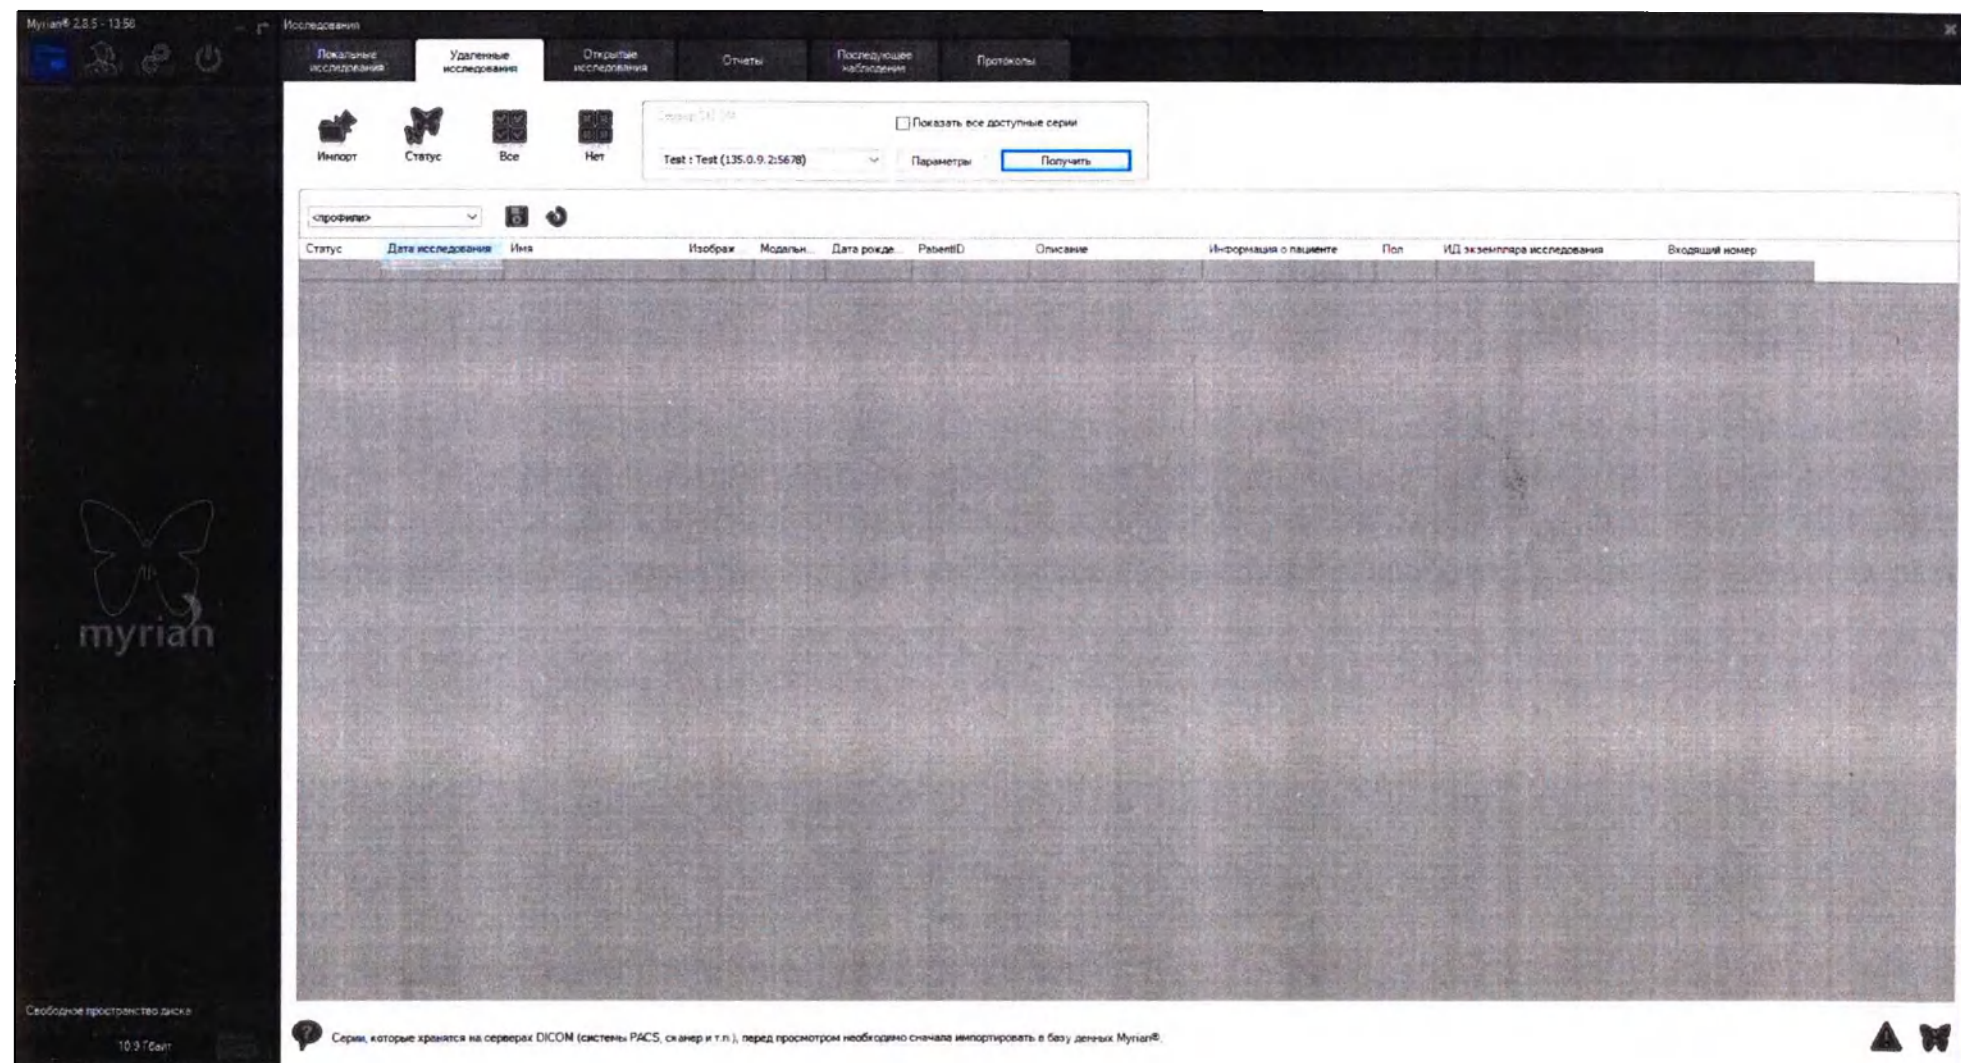


Рисунок 3 Внешний вид Вкладки «Открытие исследования»

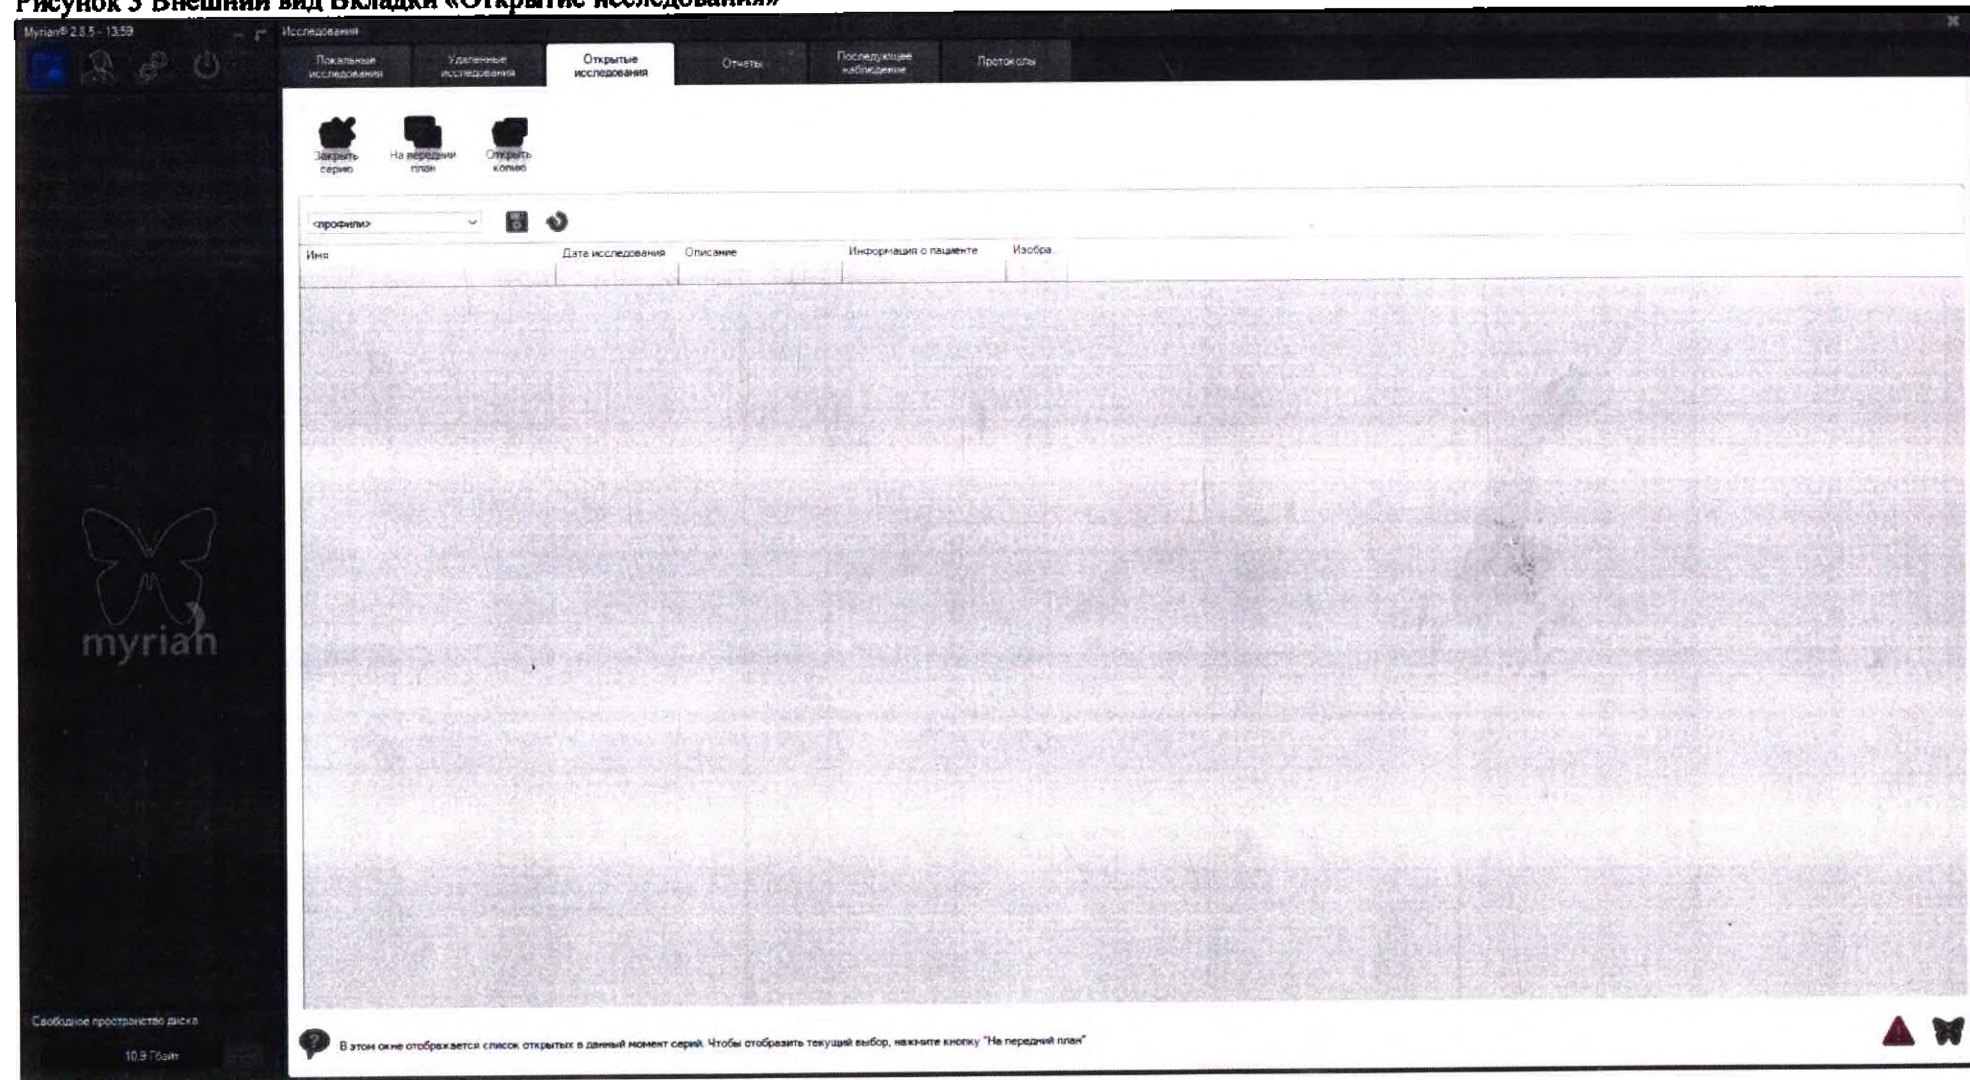


Рисунок 4 Внешний вид Вкладки «Отчеты»

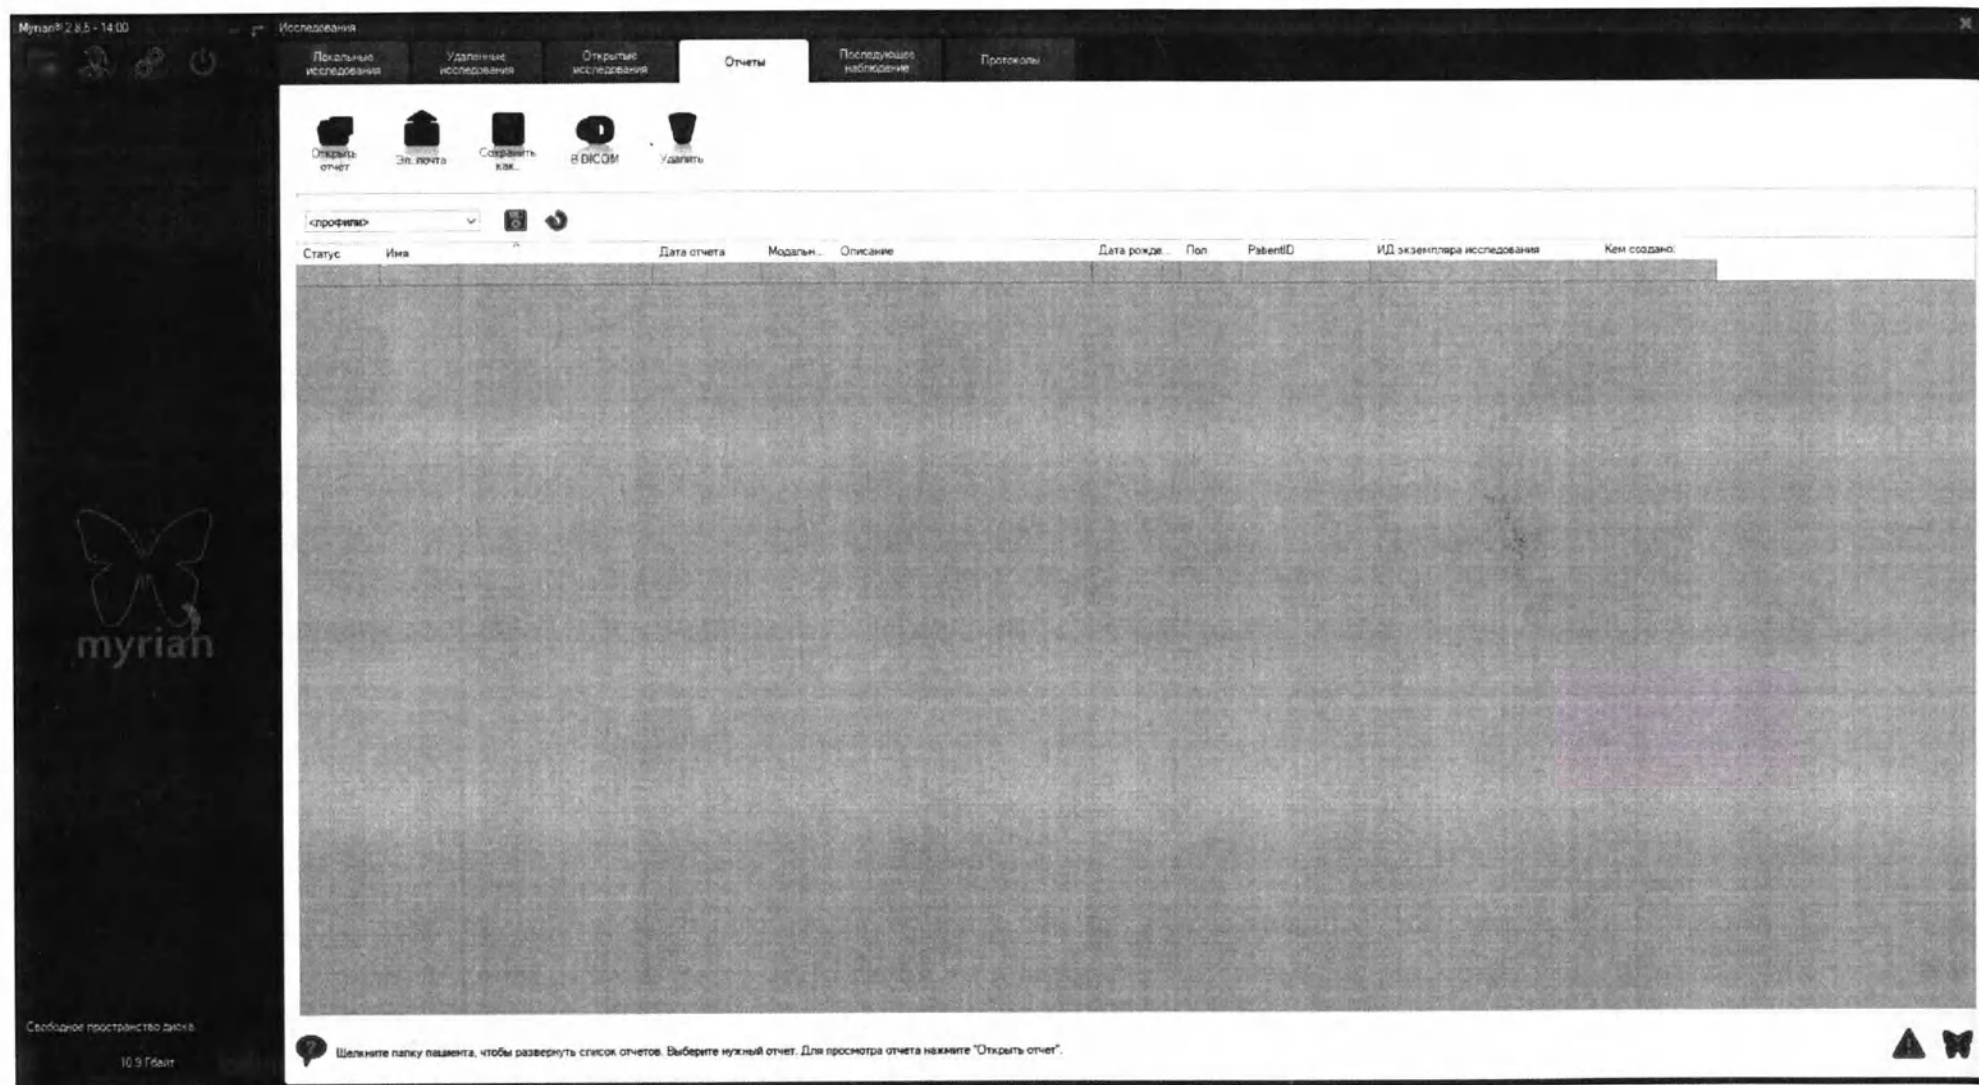


Рисунок 5 Внешний вид Вкладки «Последующие отчеты»

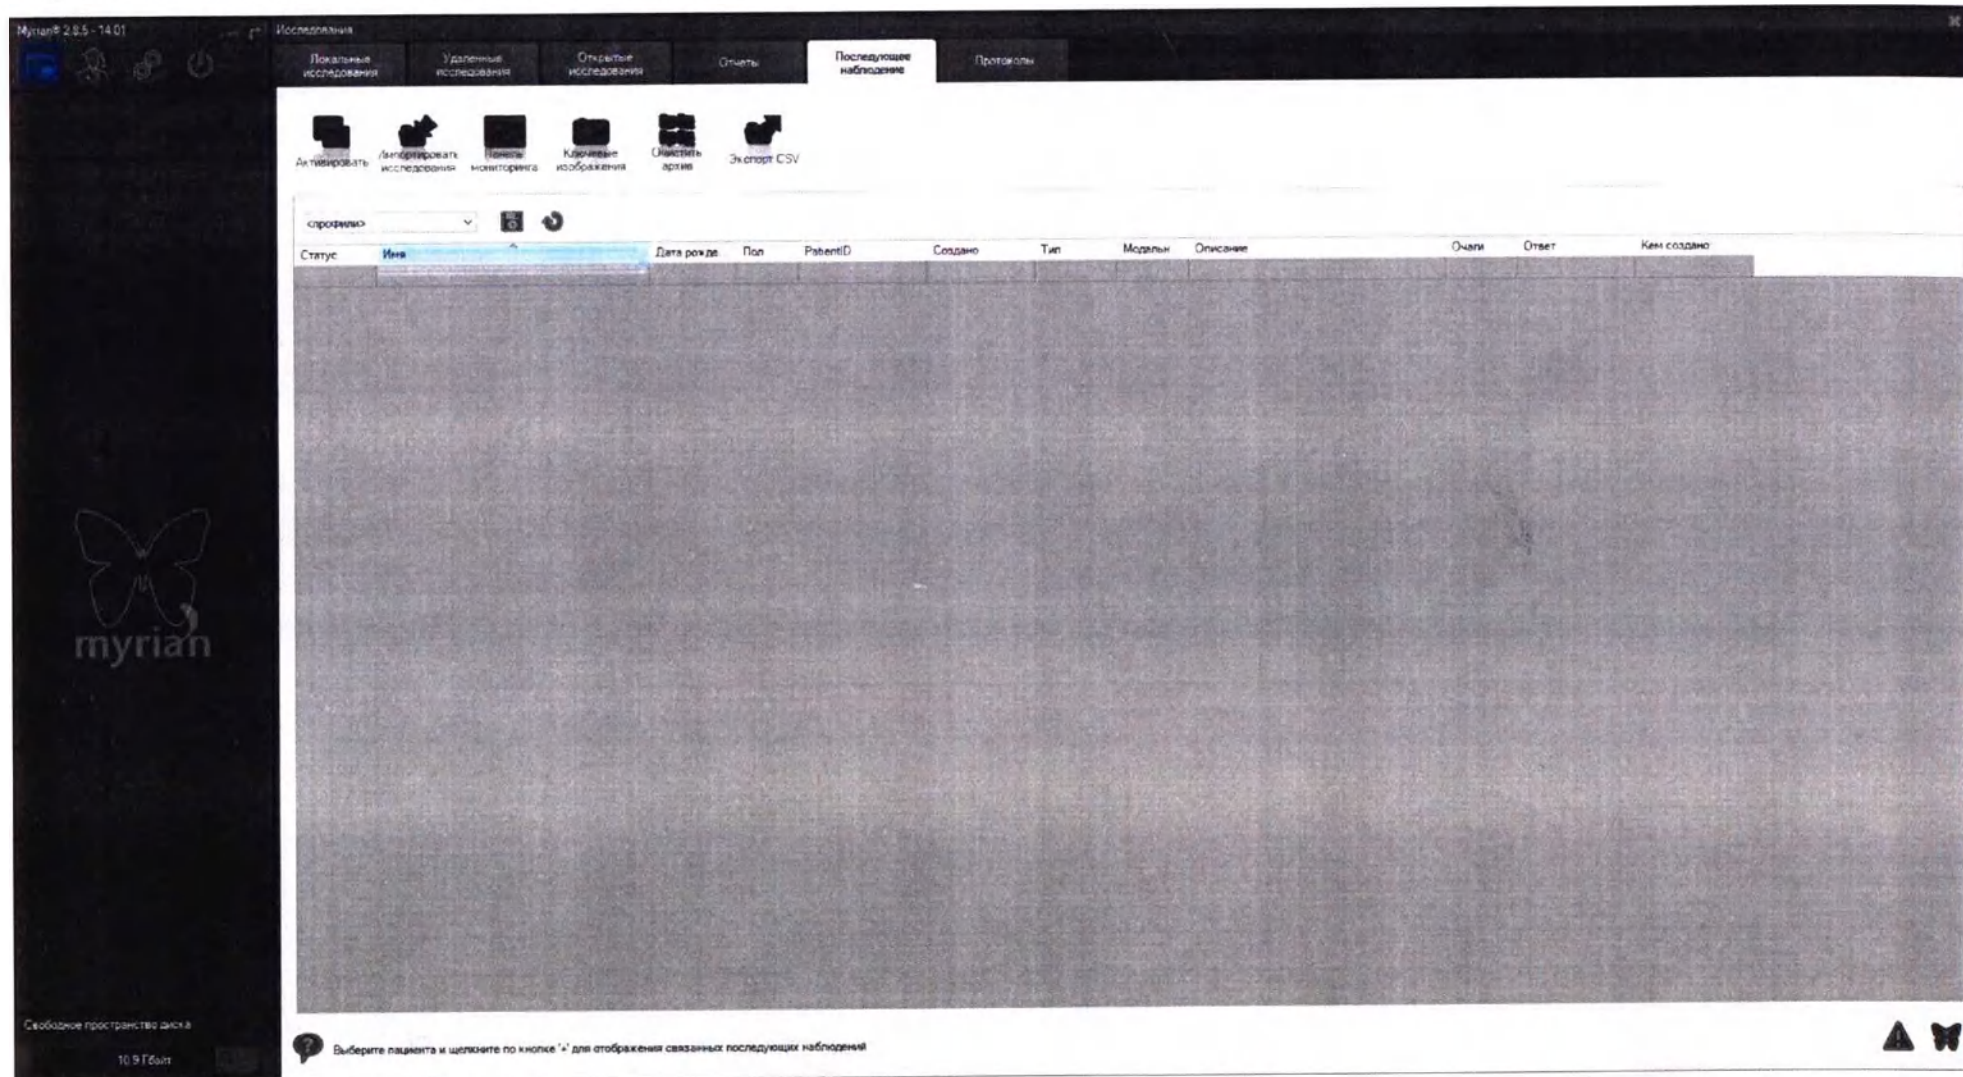


Рисунок 6 Внешний вид вкладки «Протоколы»

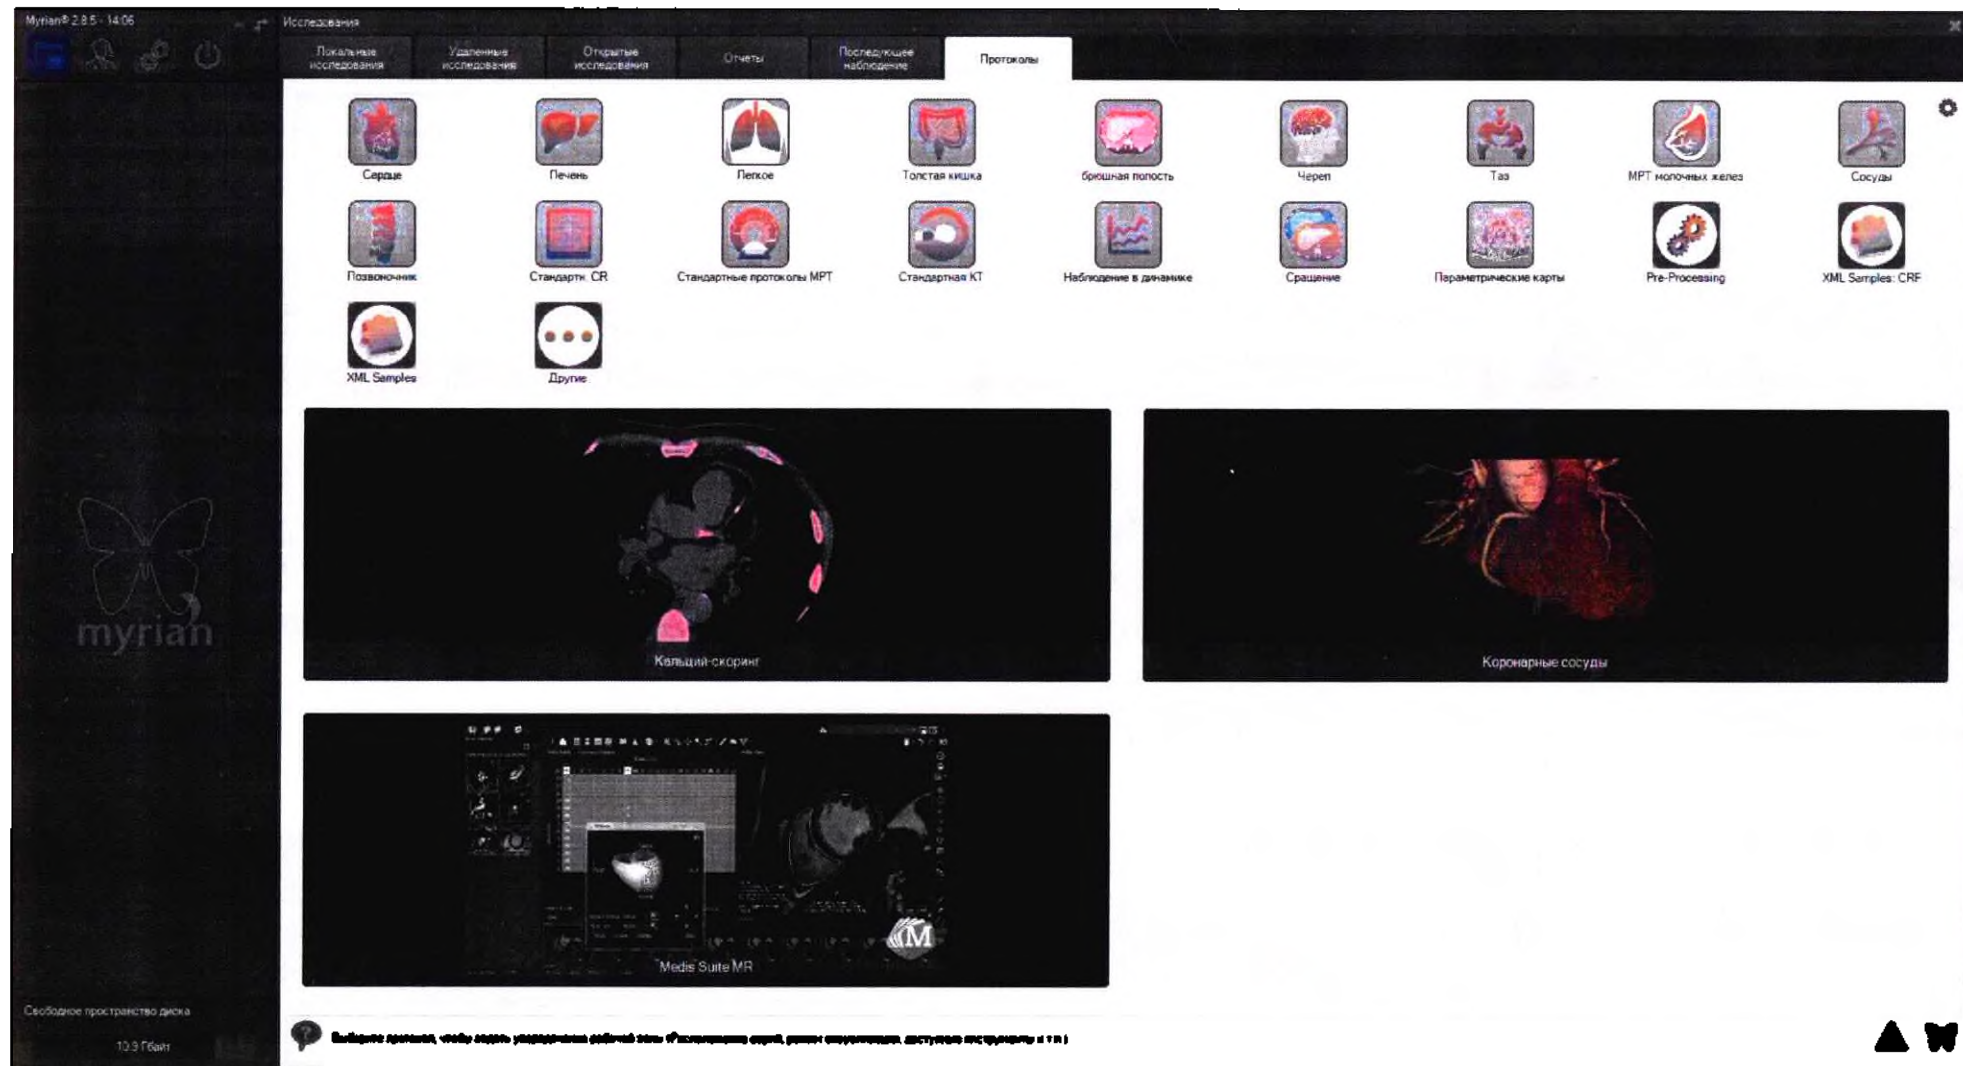


Рисунок 7. Внешний вид вкладки «Текст» кнопки «QuizCreator»

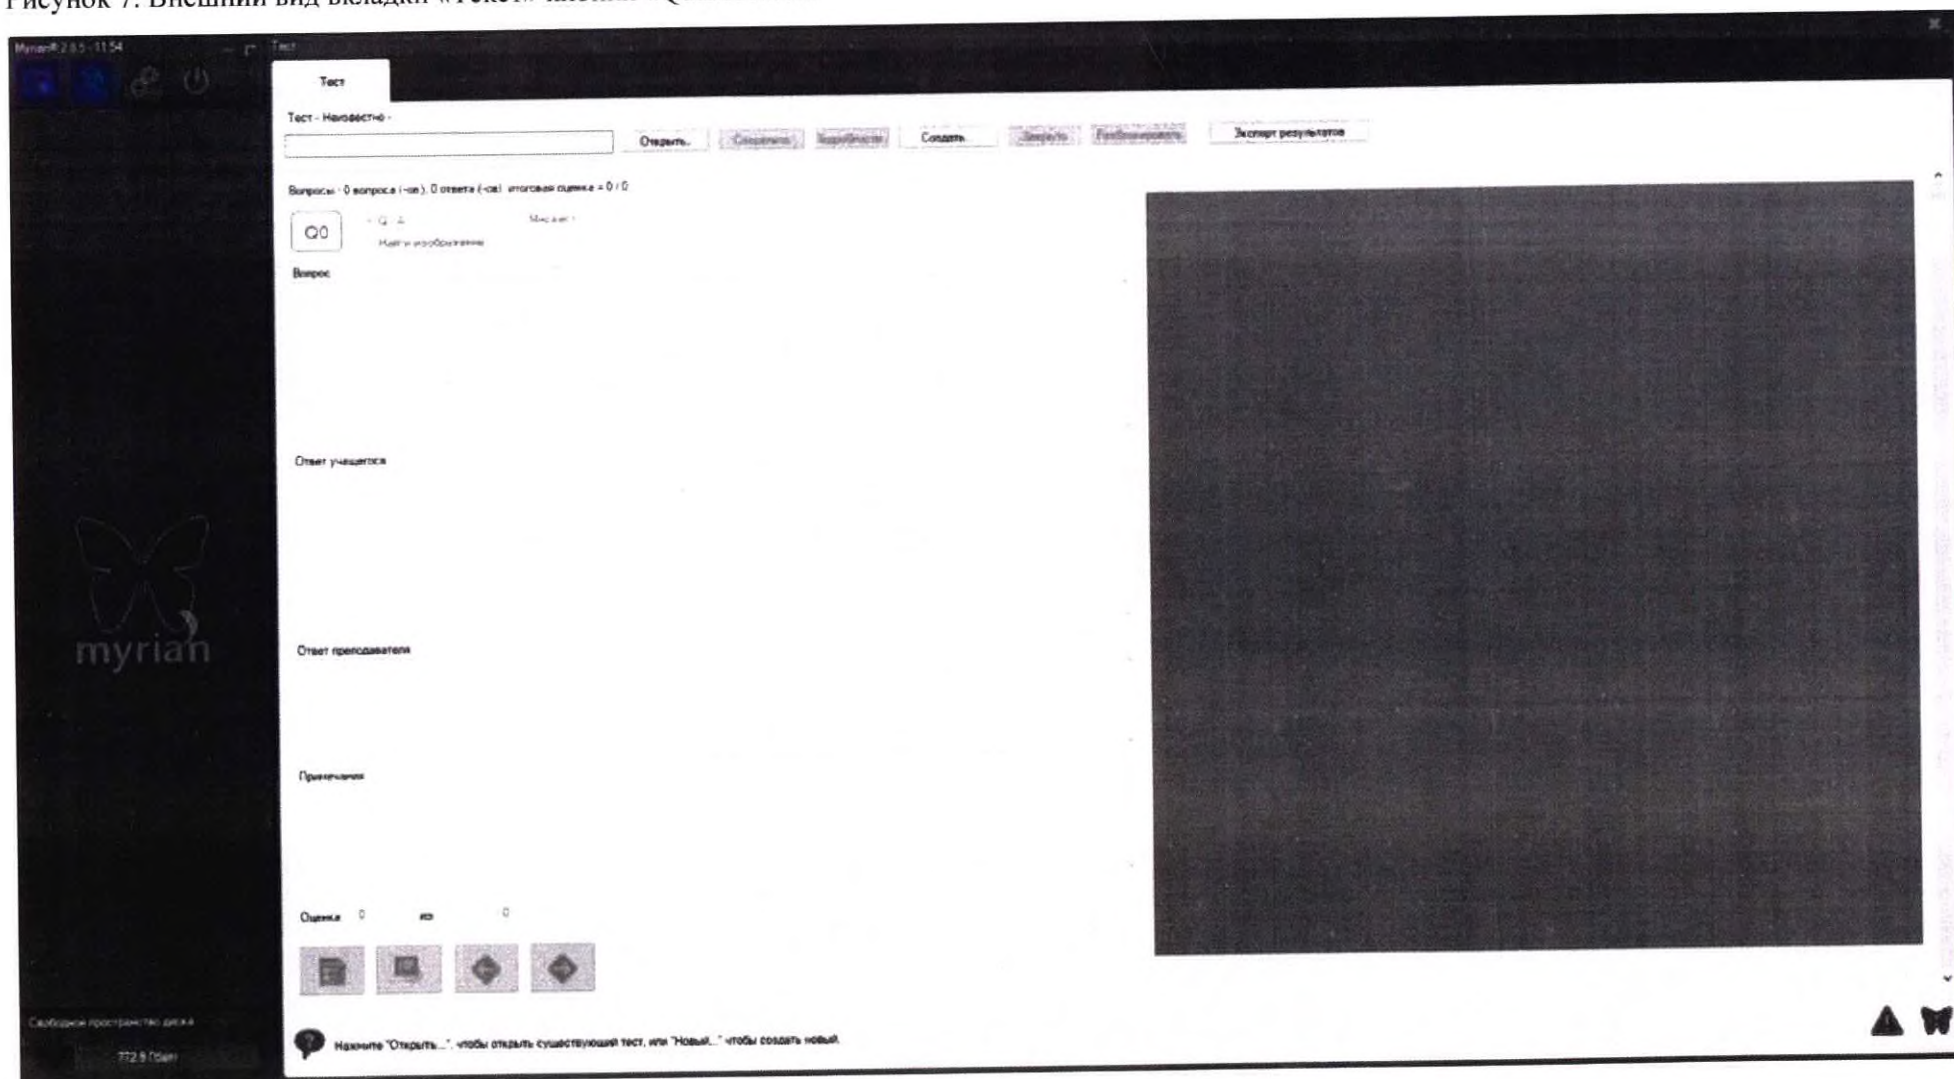


Рисунок 8 Внешний вид вкладки «DICOM» кнопки «Настройки»

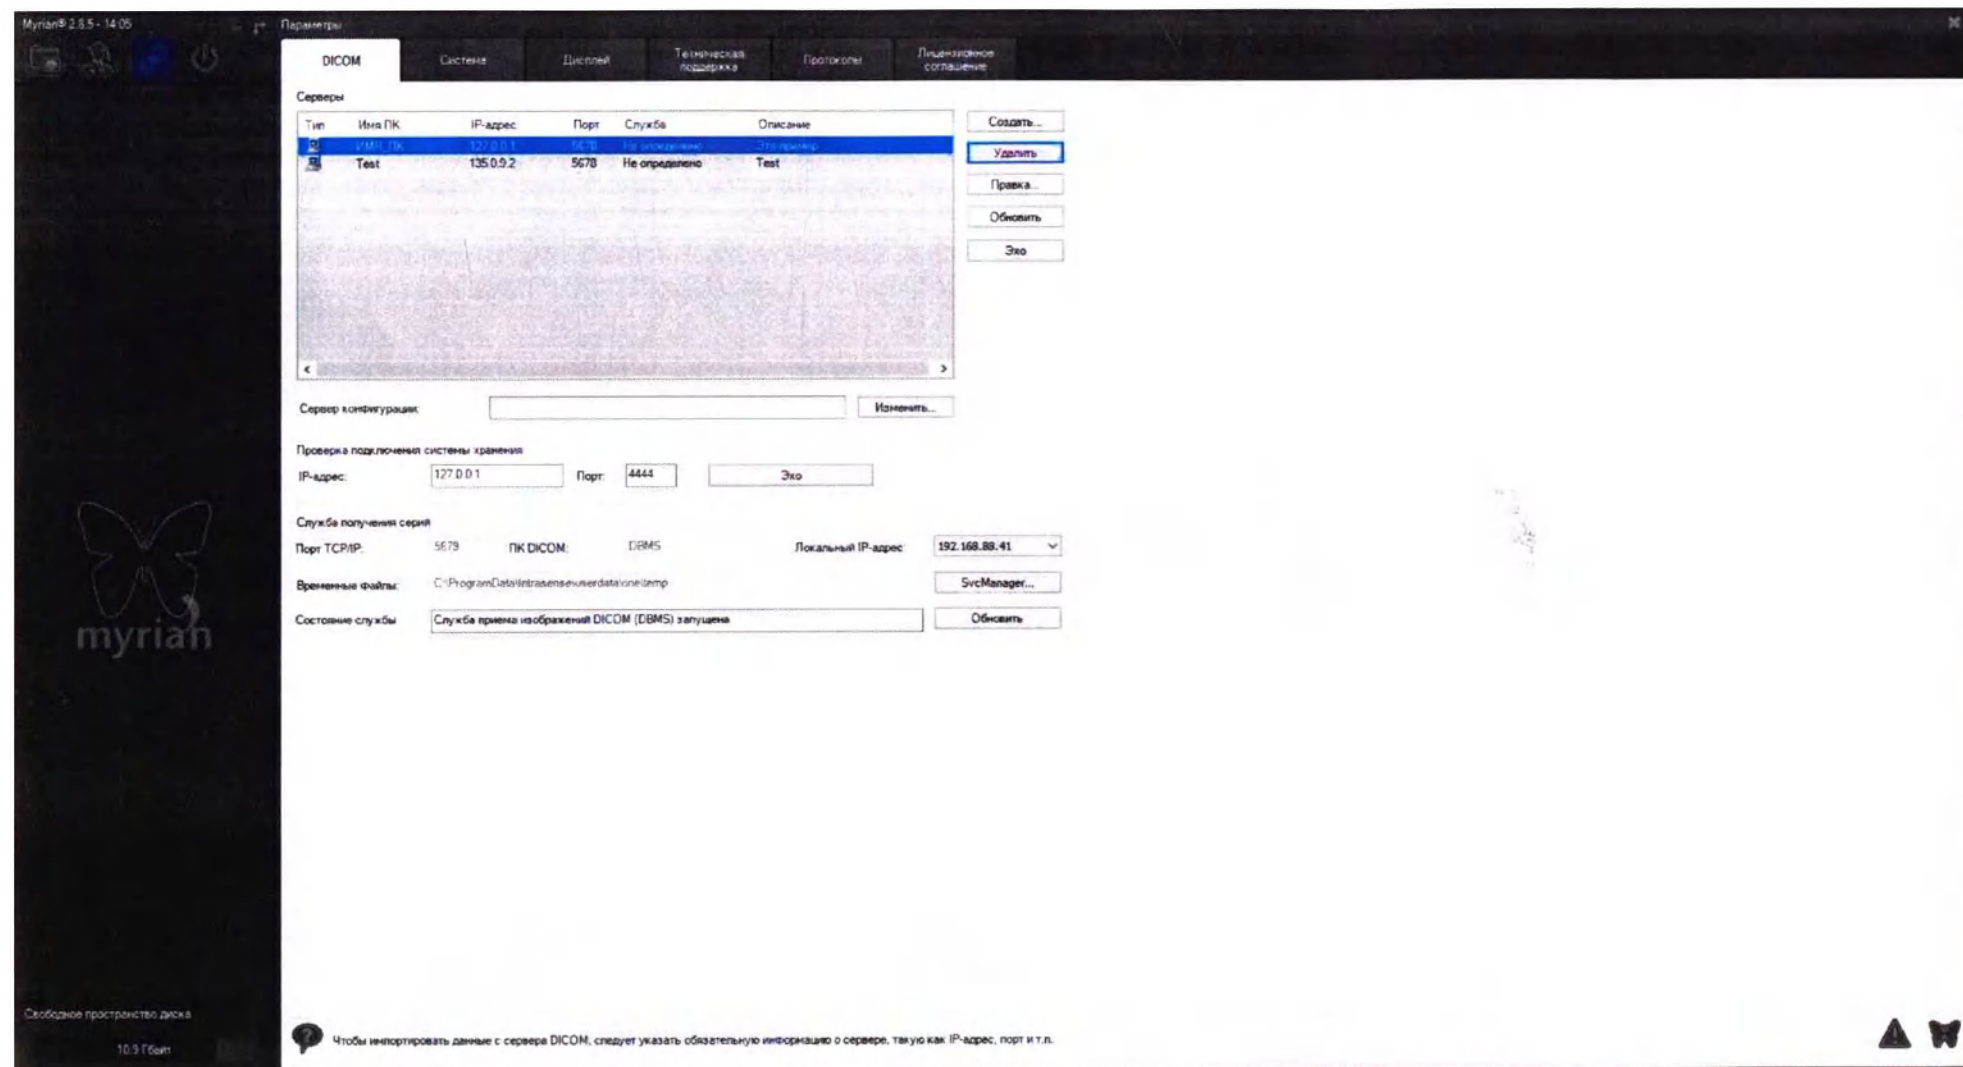


Рисунок 9 Внешний вид Внешний вид вкладки «Система» кнопки «Настройки» окна «Система»

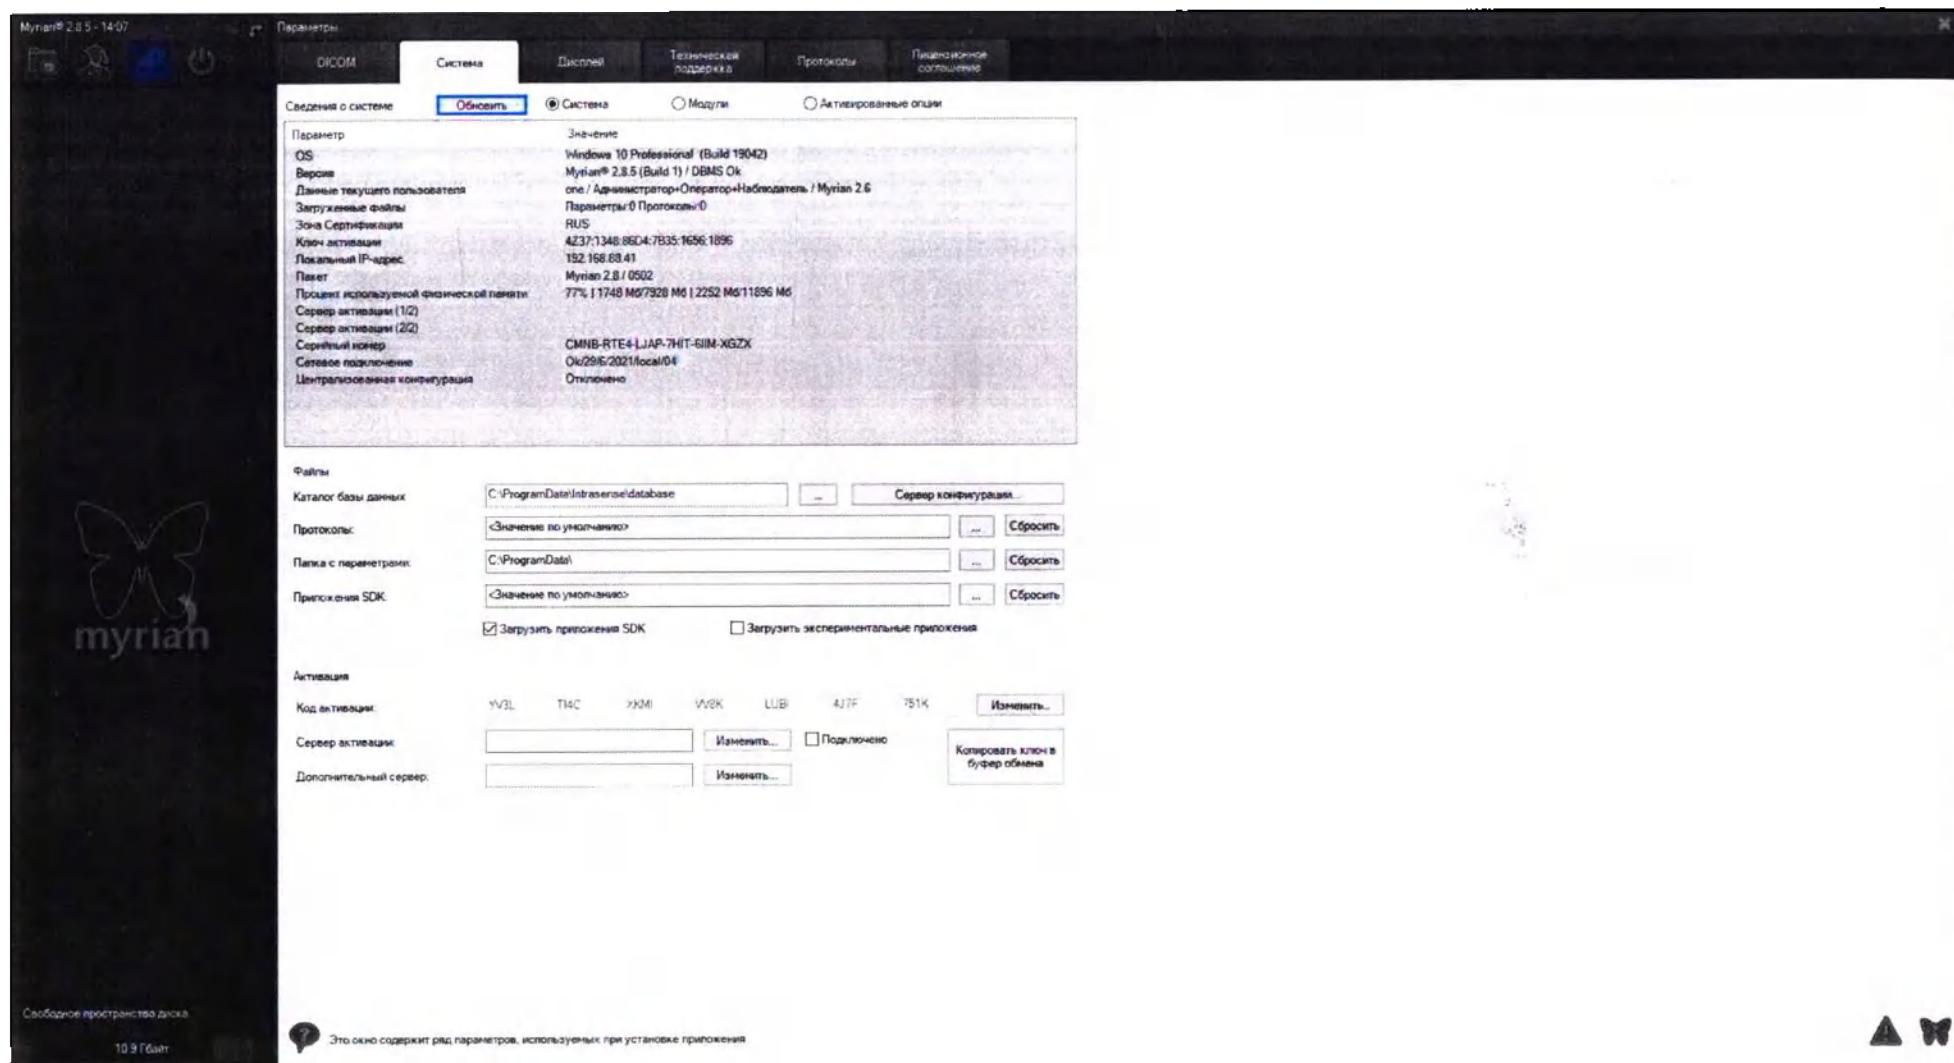


Рисунок 11 Внешний вид вкладки «Система» кнопки «Настройки» окна «Активированные опции»

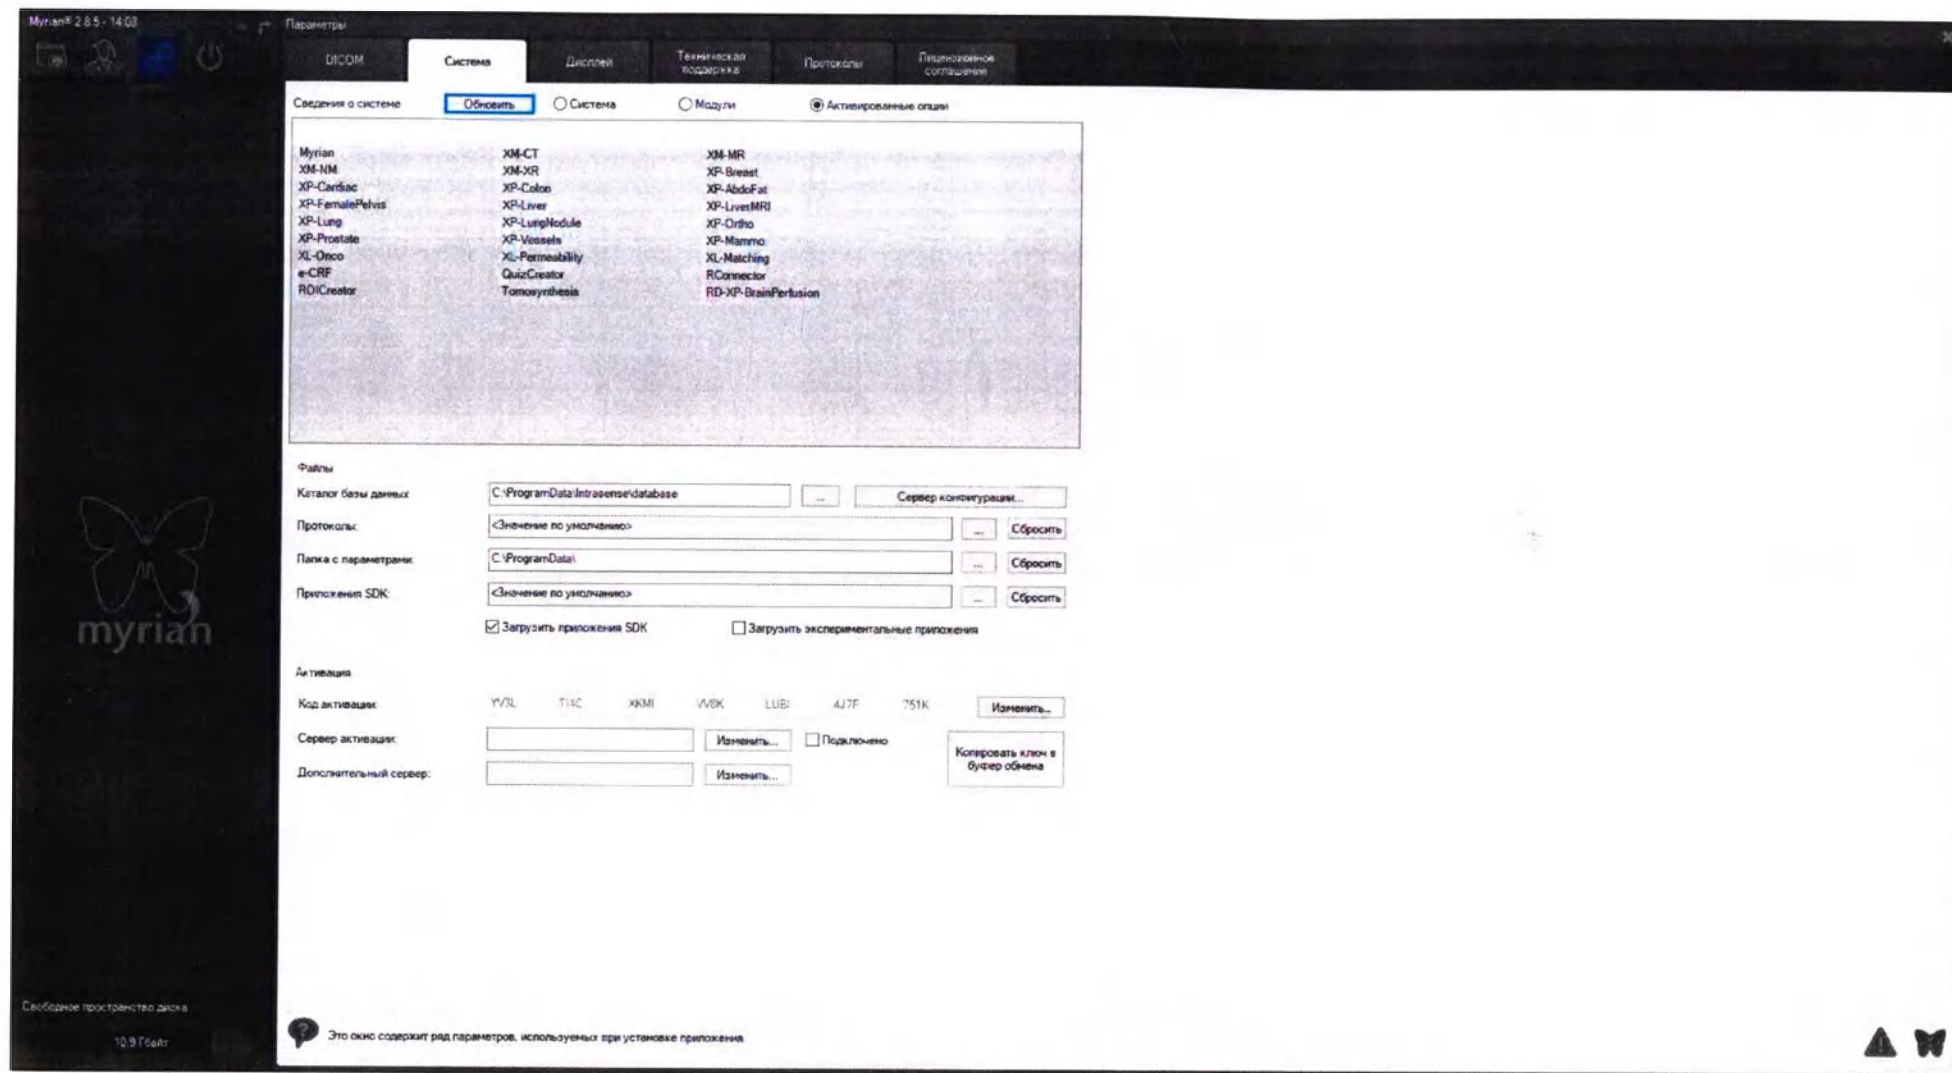


Рисунок 10. Внешний вид вкладки «Система» кнопки «Настройки» окна «Модули»

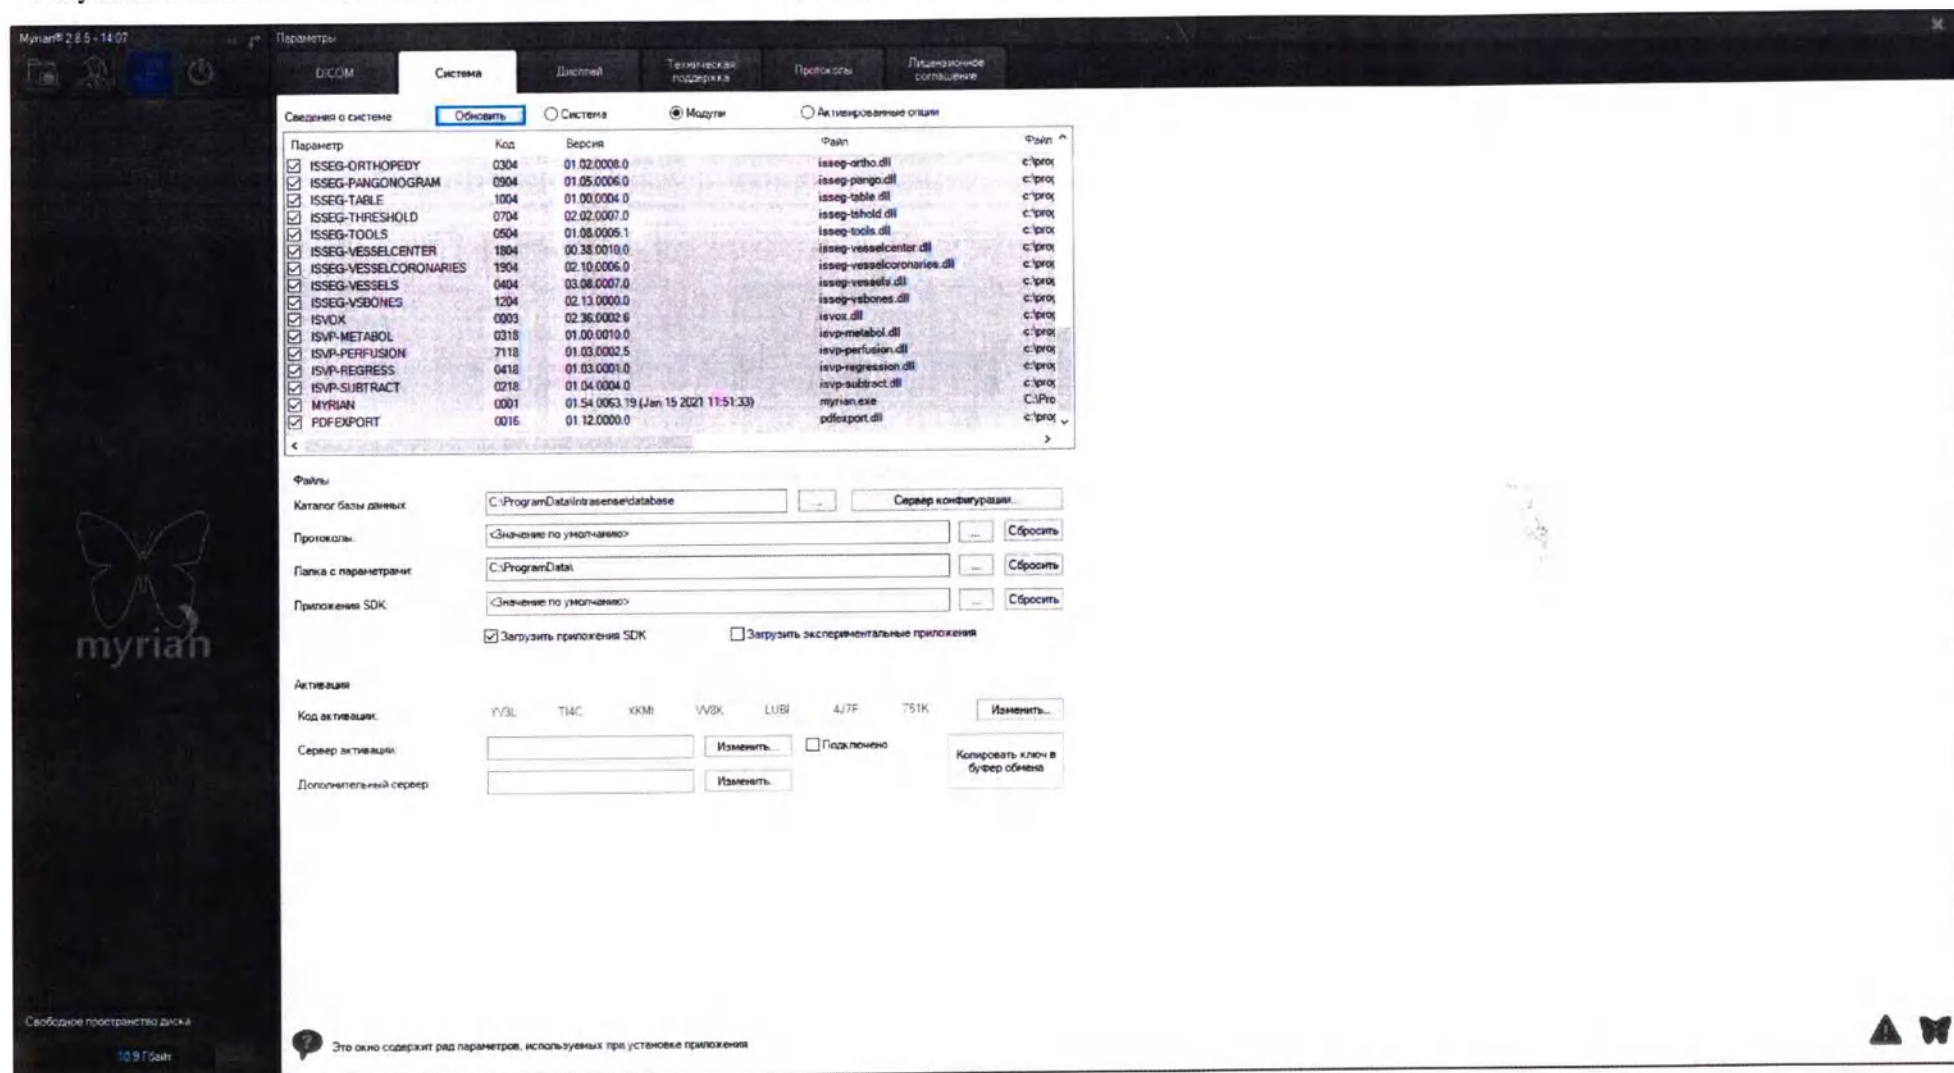


Рисунок 12 Внешний вид вкладки «Дисплей» кнопки «Настройки»

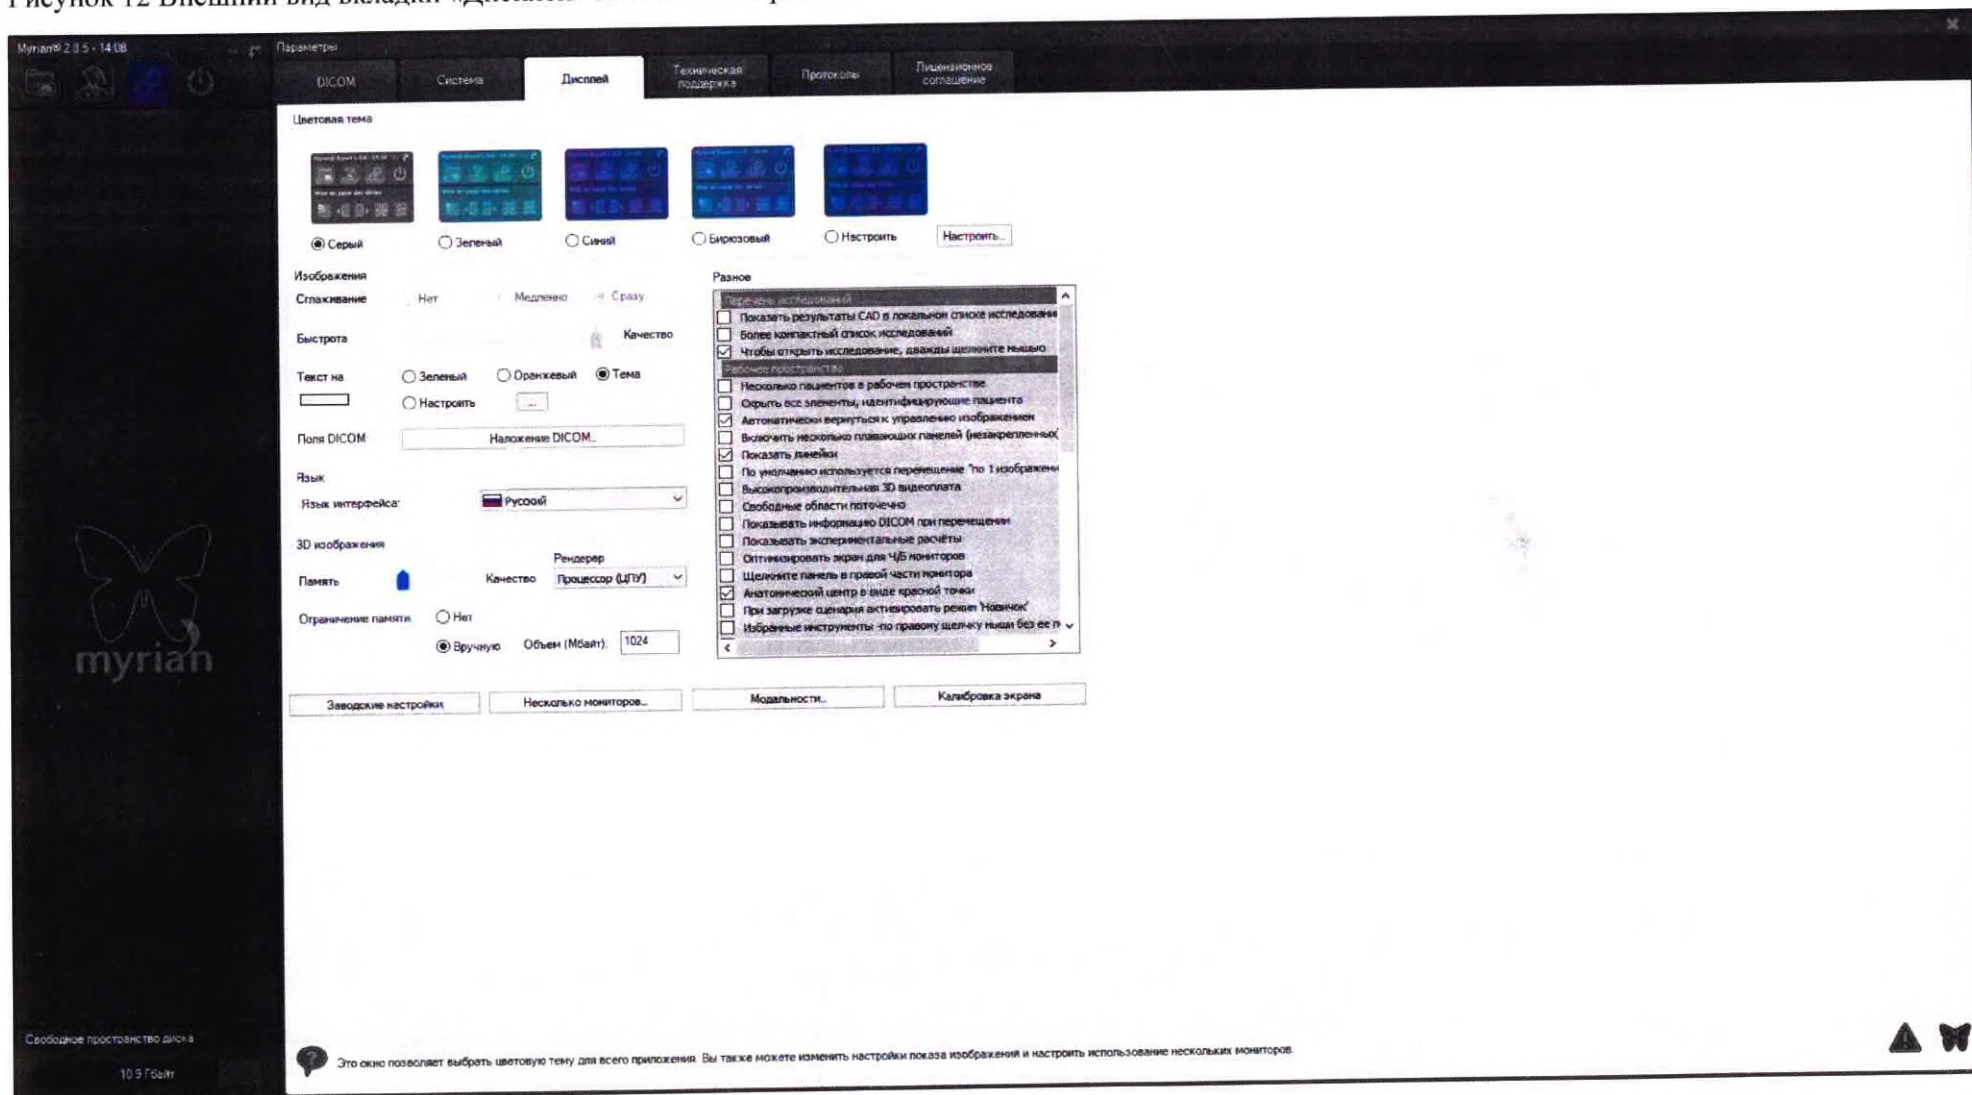


Рисунок 13. Внешний вид вкладки «Техническая поддержка» кнопки «Настройки»

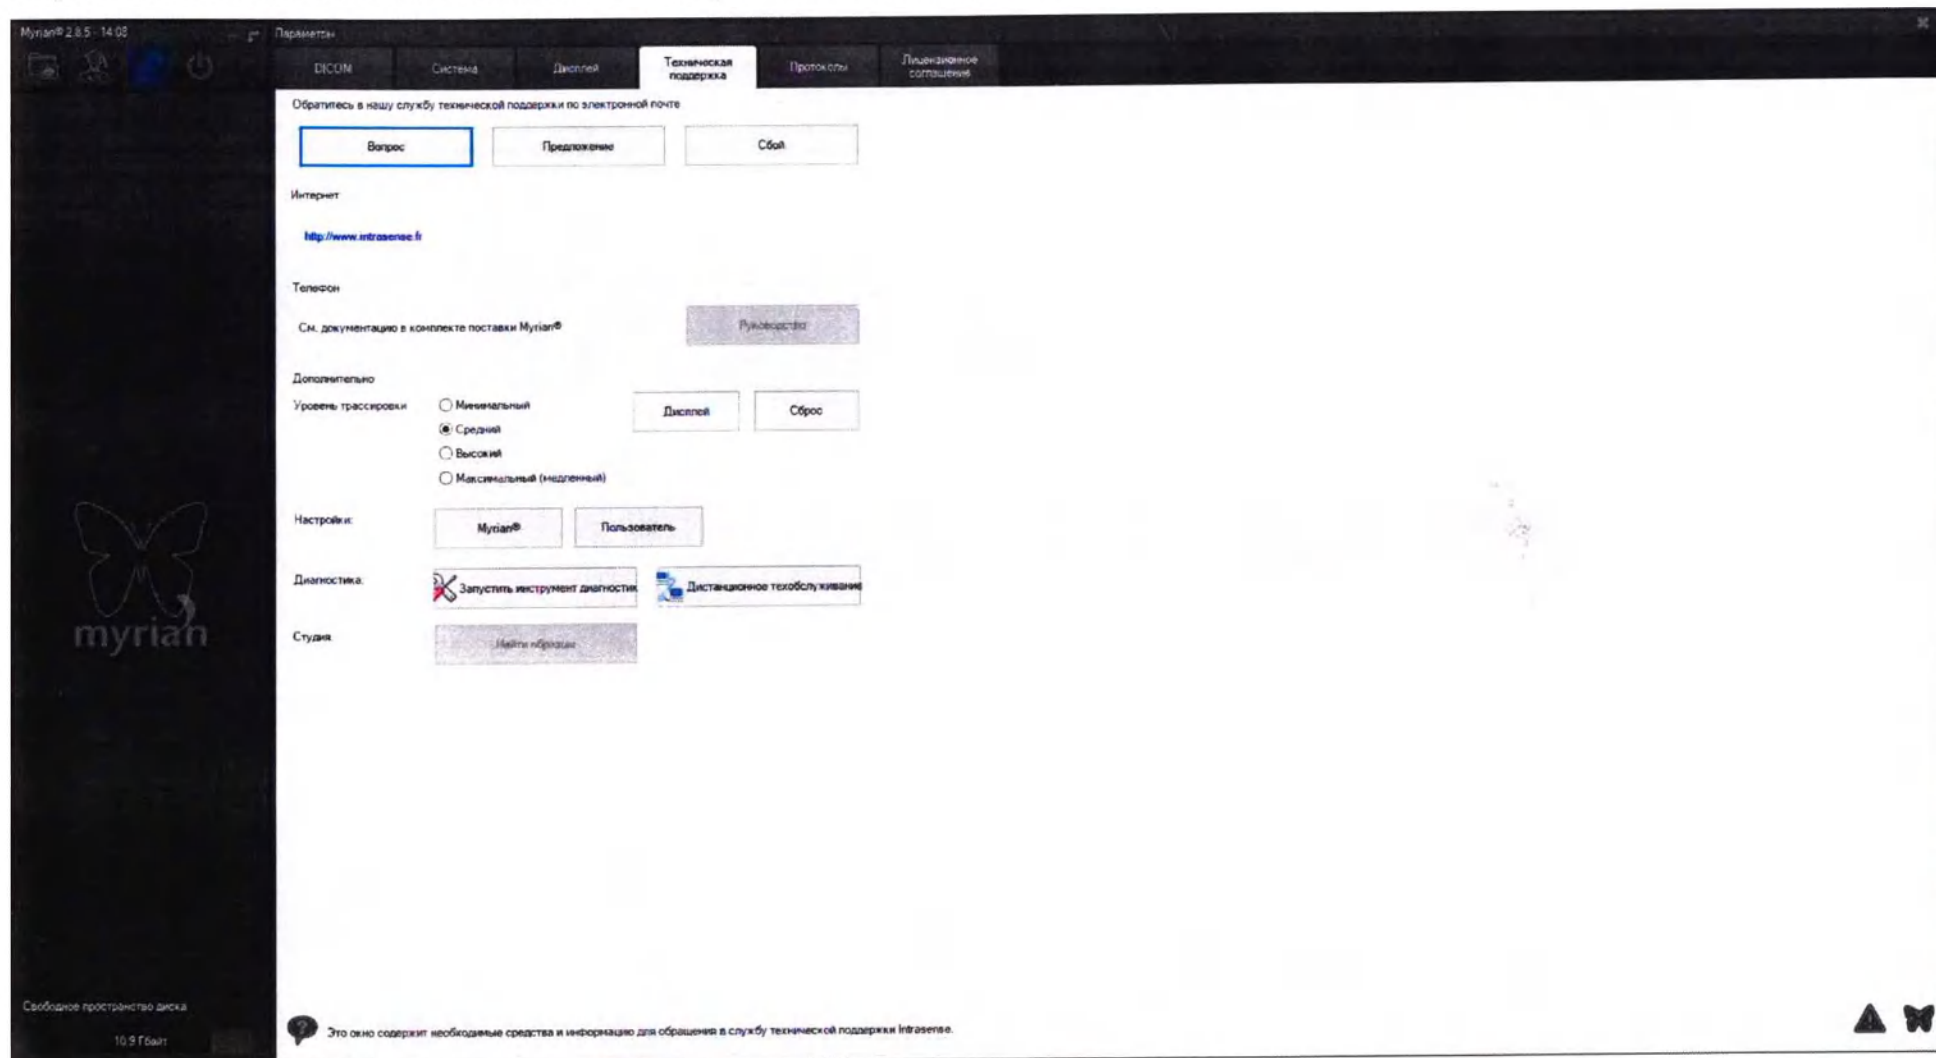


Рисунок 14 Внешний вид вкладки «Протоколы» кнопки «Настройки»


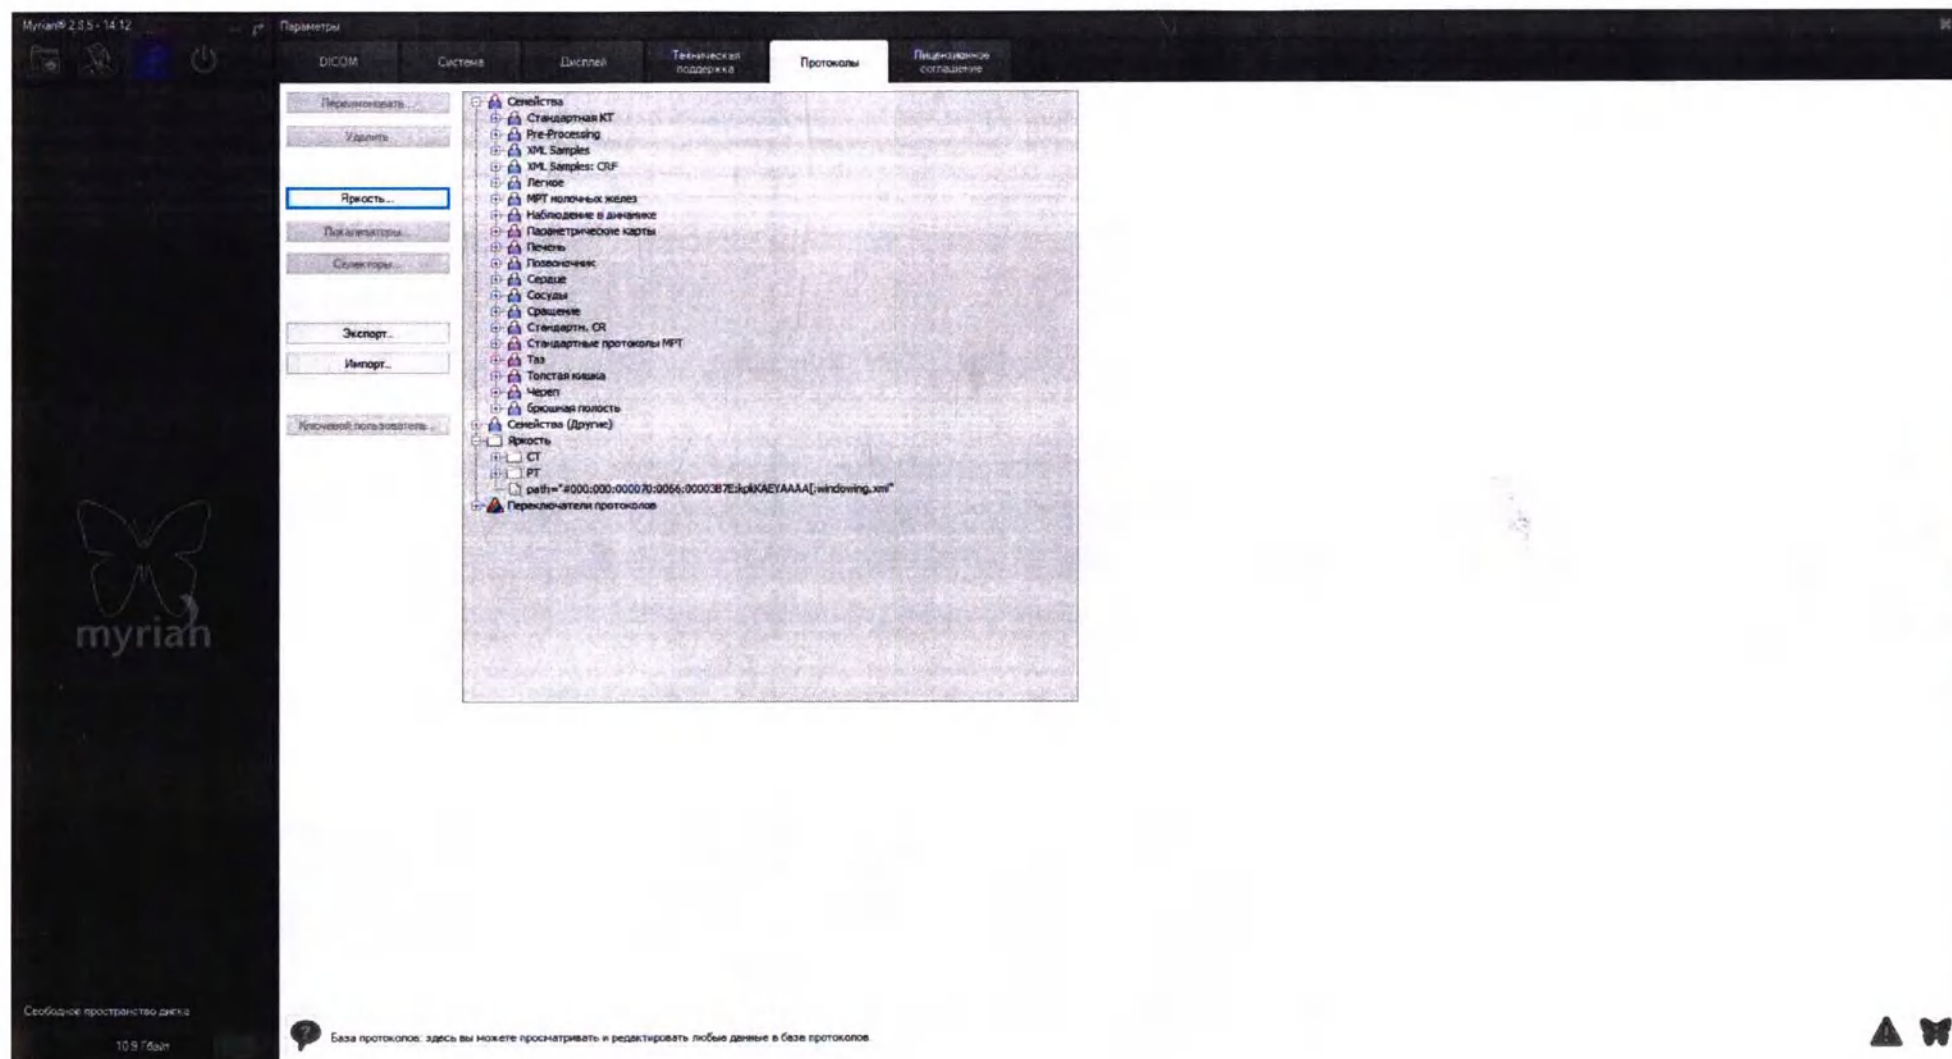


Рисунок 15 Внешний вид вкладки «Протоколы» кнопки «Настройки»



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: _____ листа (-ов)

Генеральный директор
М.П.

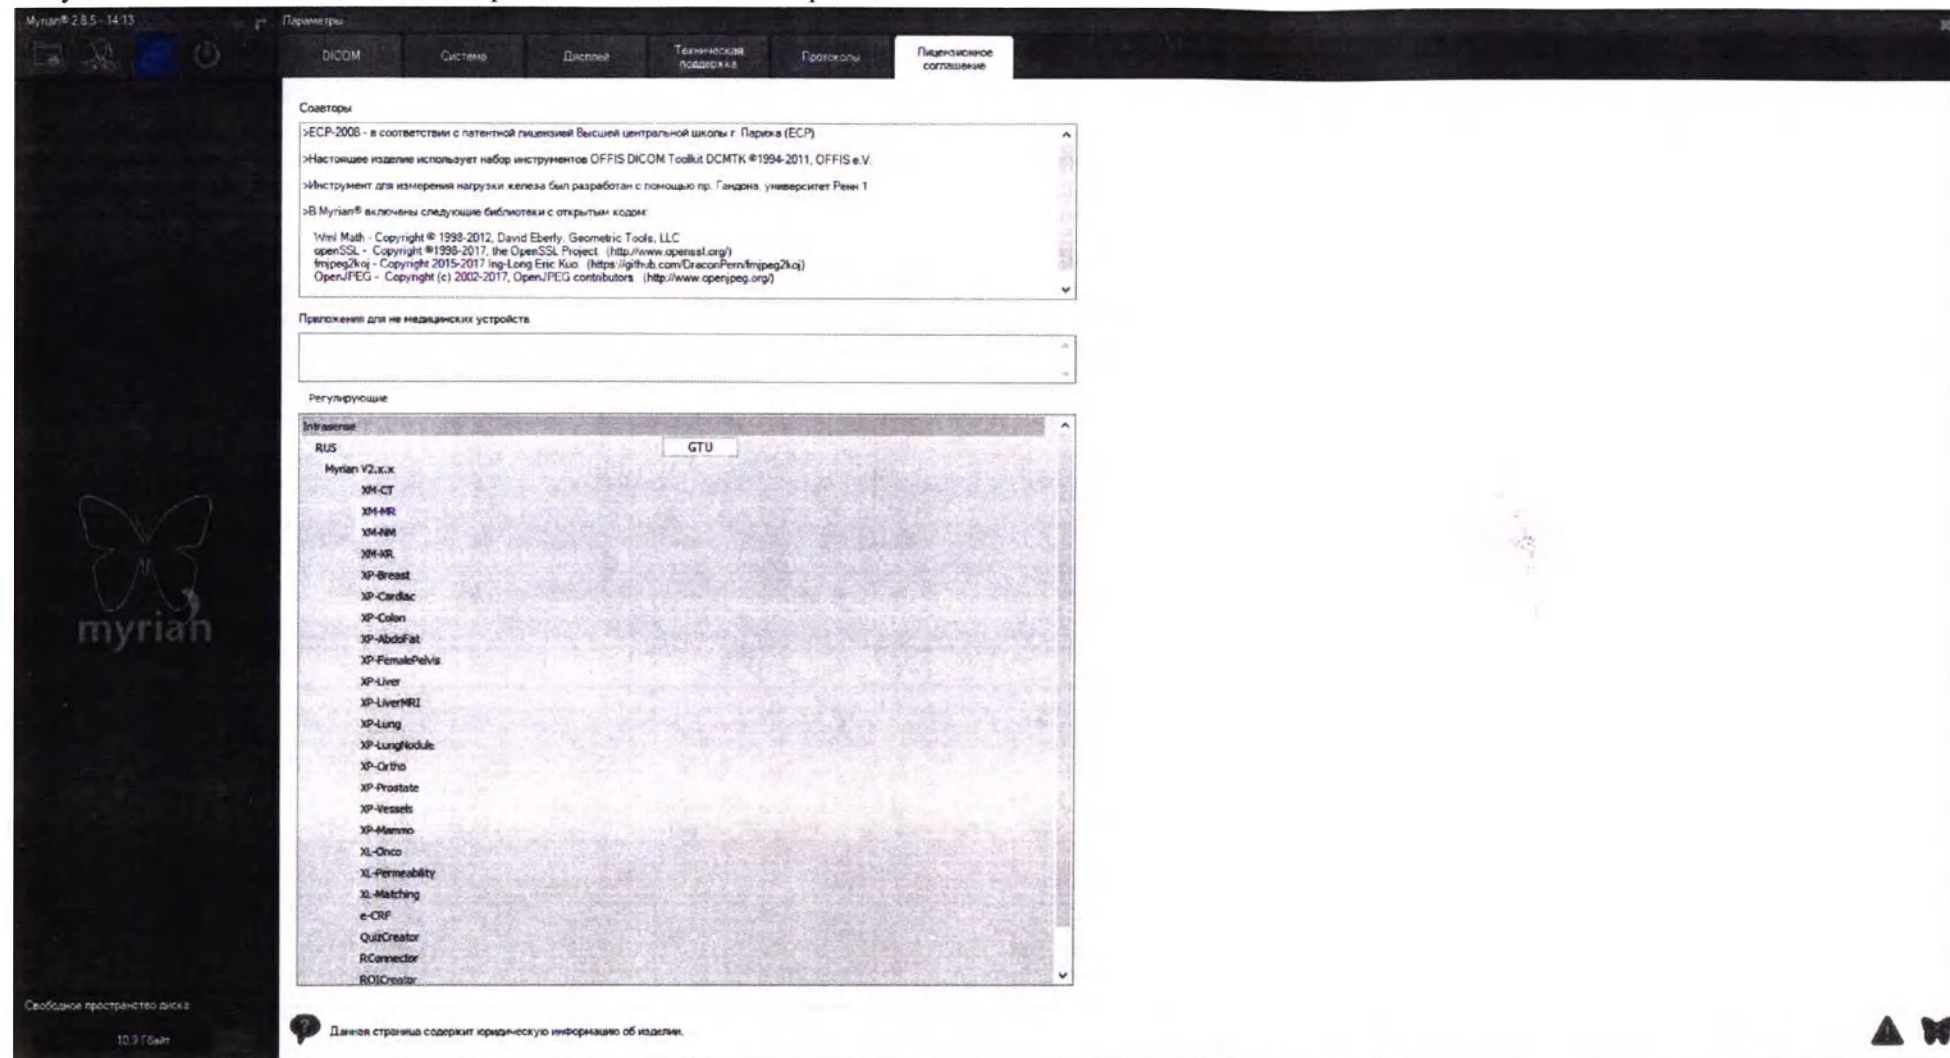

МИТРОХИНА Ю.Ю.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

№ 77 АГ 5987517