

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «КАРДЕКС»



В.Н. Карельский

2021 г.

**Пульсооксиметр для определения частоты пульса и насыщения гемоглобина
крови кислородом ПО-02-“КАРДЕКС” по
ТУ 9441-003-25630854-00**

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ




Блок электронный исп.1, ЯЕКА.941118.003




Блок электронный исп.2, ЯЕКА.941118.003-01




Блок электронный исп.3, ЯЕКА.941118.003-02

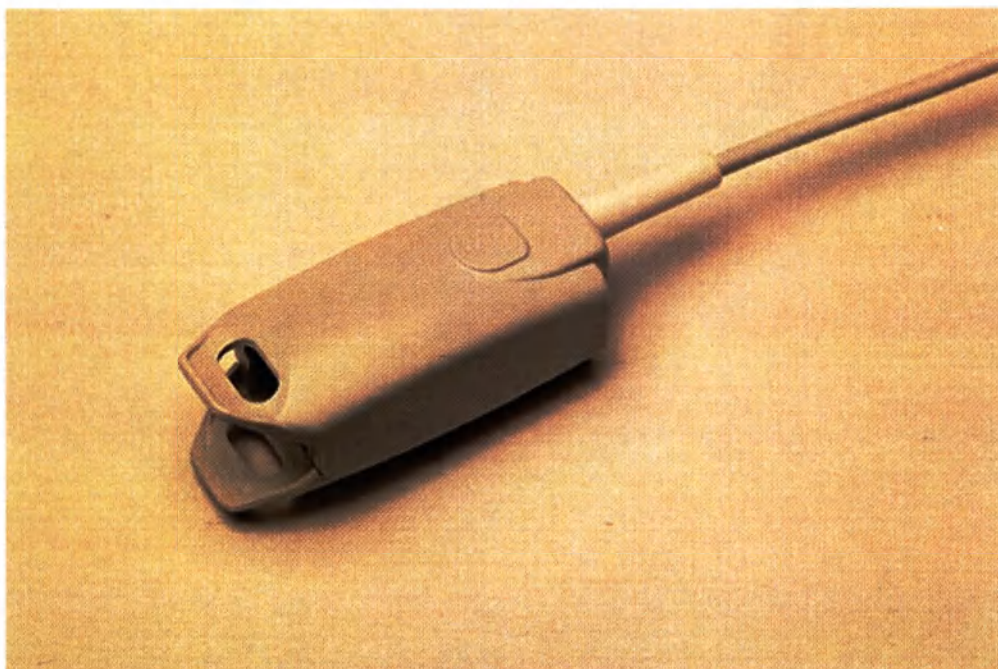


Датчик сатурации оптоэлектронный пальцевый F-3212-31(9)

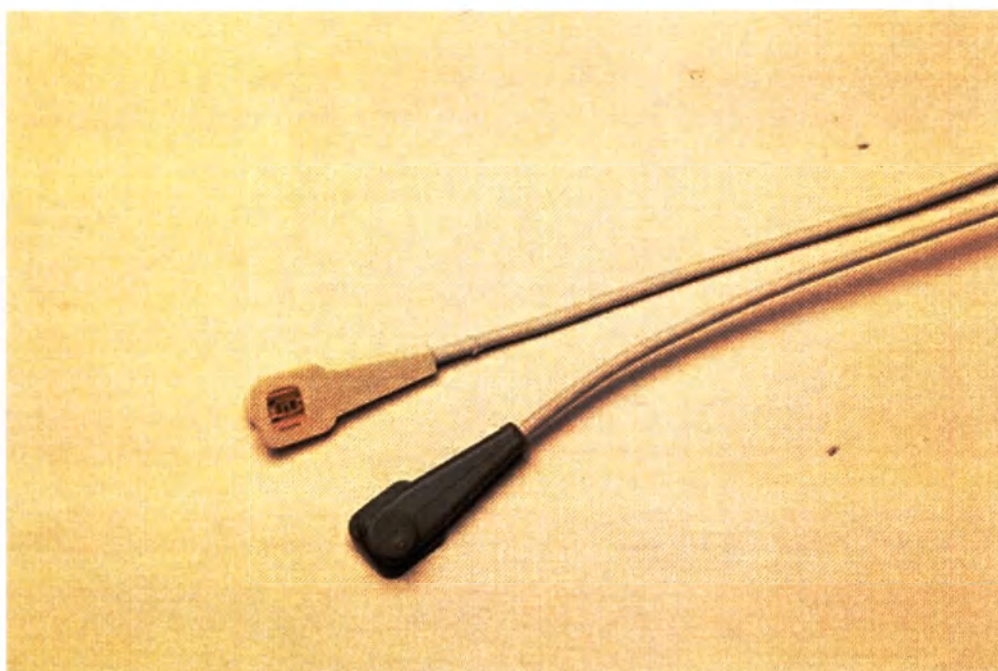


Датчик сатурации оптоэлектронный типа “Y” Y-2217-31(9)

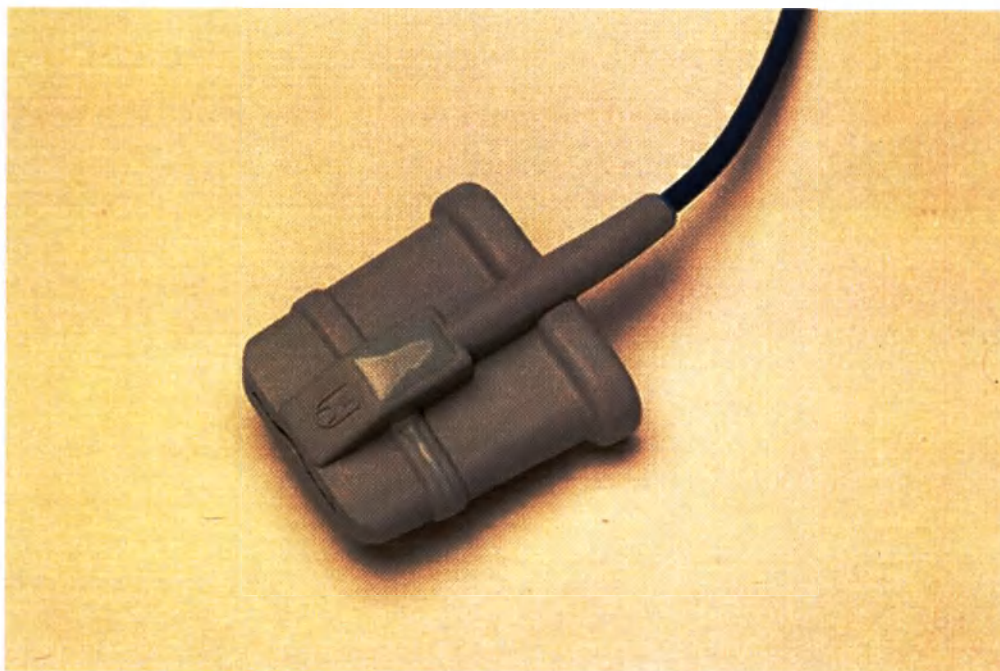


Датчик сатурации оптоэлектронный R-3212-31(9)

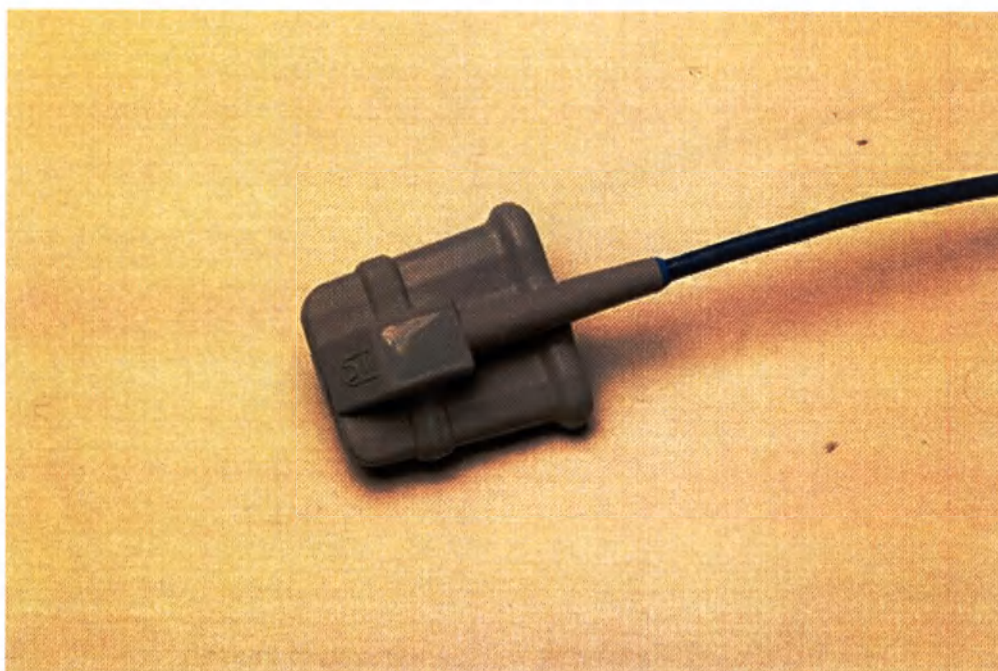

Датчик сатурации оптоэлектронный RM-3212-9

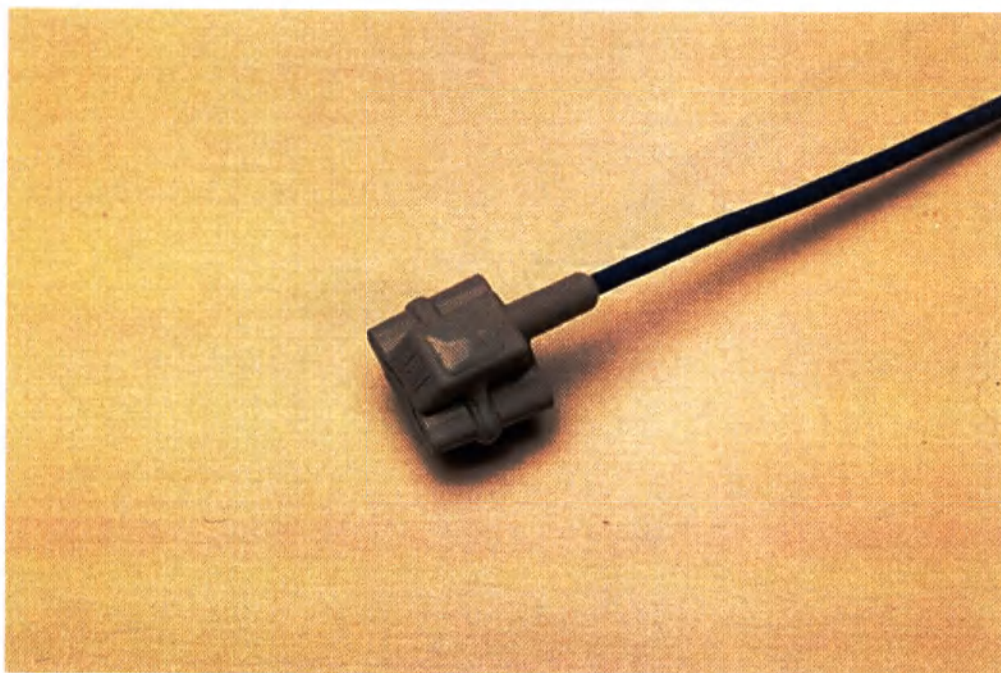


Датчик сатурации оптоэлектронный RS-3212-9

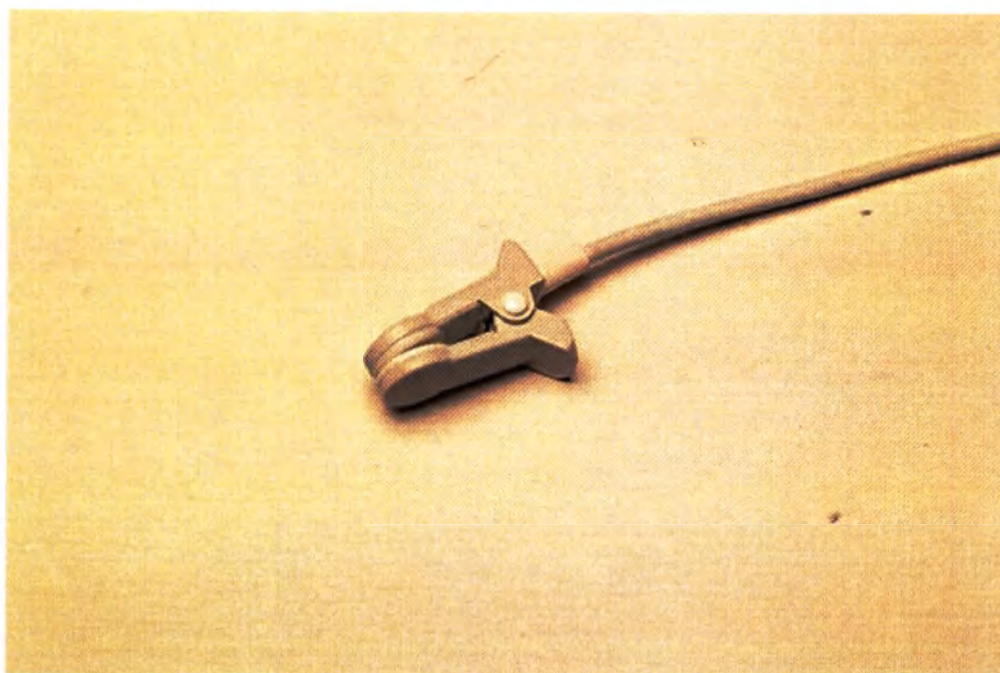


Датчик сатурации оптоэлектронный ES-3212-9



Датчик сатурации оптоэлектронный W-3212-9 STD

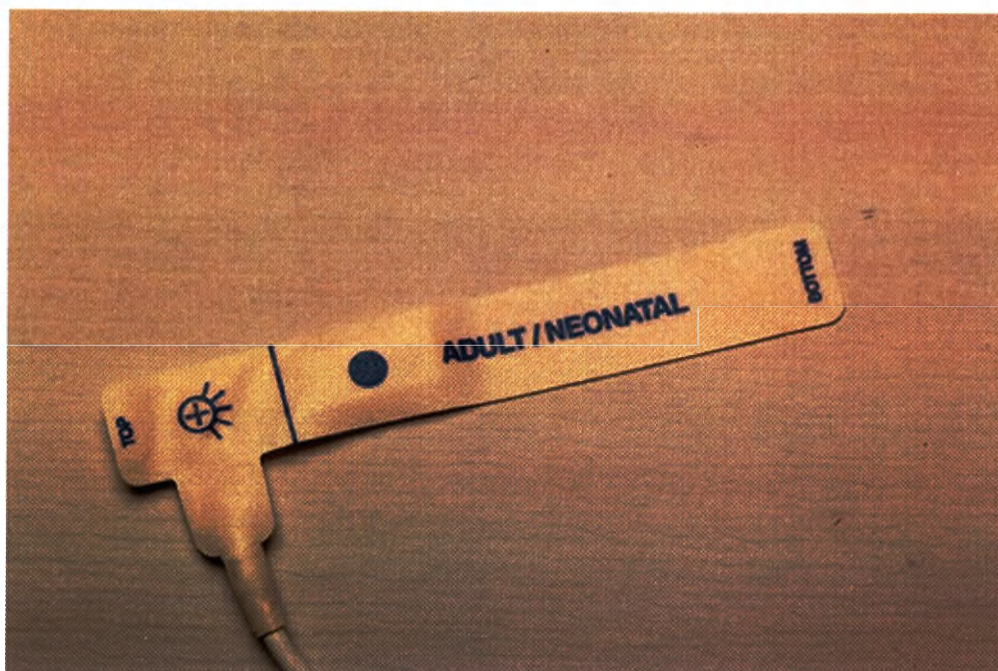

Датчик сатурации оптоэлектронный DN-2211-6 STD

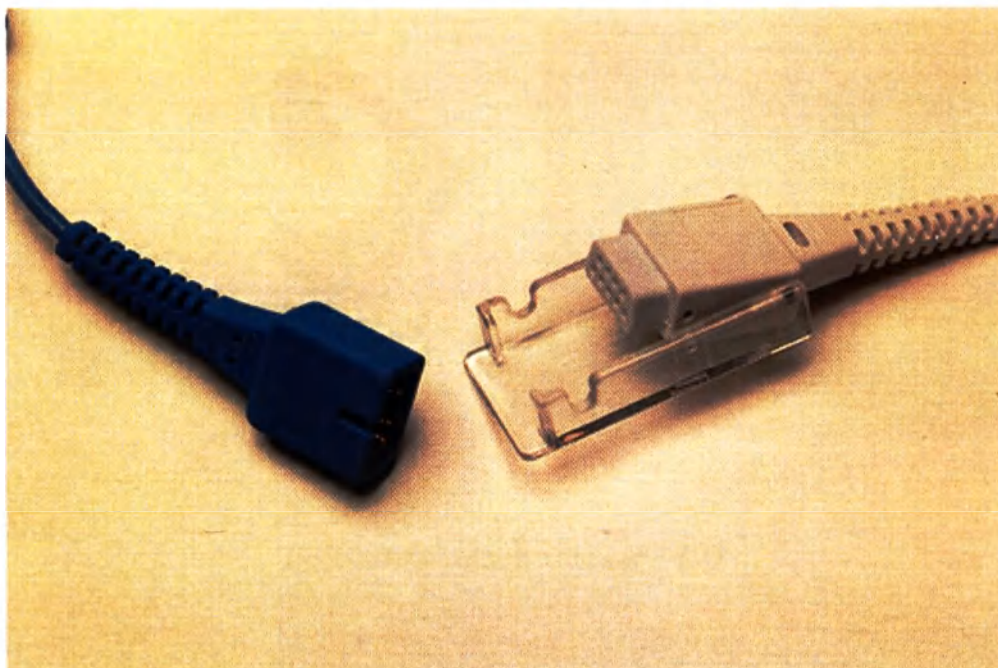

Удлинитель кабеля датчика сатурации оптоэлектронного X-4212



термопринтер Porti-S30/40




Держатель ушной клипсы Z-603




Лента для крепления датчика сатурации Z-604



Подставка ЯЕКА.301312.001

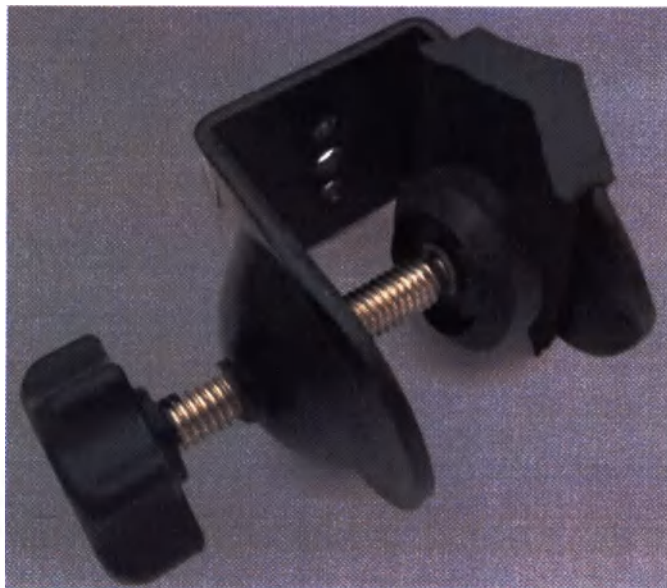

Держатель ЯЕКА.301524.001

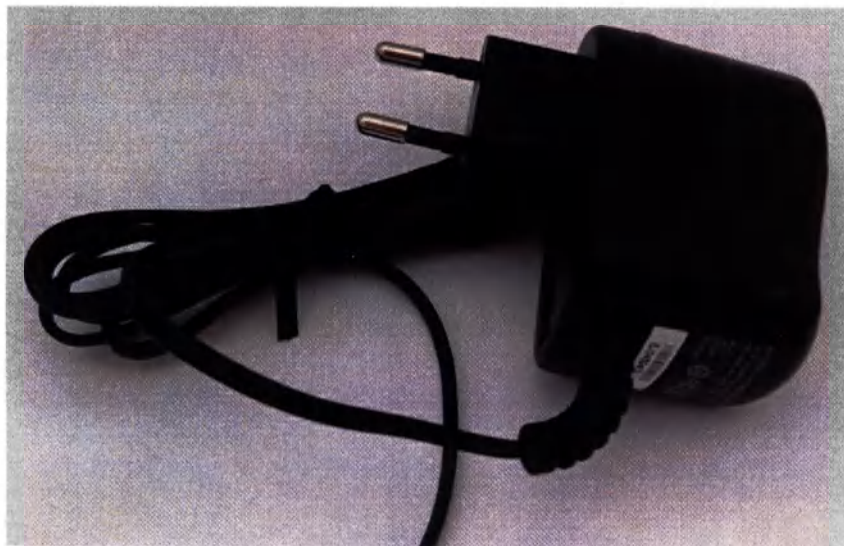

Блок питания MeanWell



Стабилизатор развязывающий ЯЕКА.436434.002

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 11 листа(ов)

Директор
ООО «КАРДЕКС»

/ Карельский В.Н.

