


Фотографические изображения

**Скальпели офтальмологические микрохирургические "Оптимед"
по ТУ 32.50.13 -012-29792921-2020**



Скальпель – копье

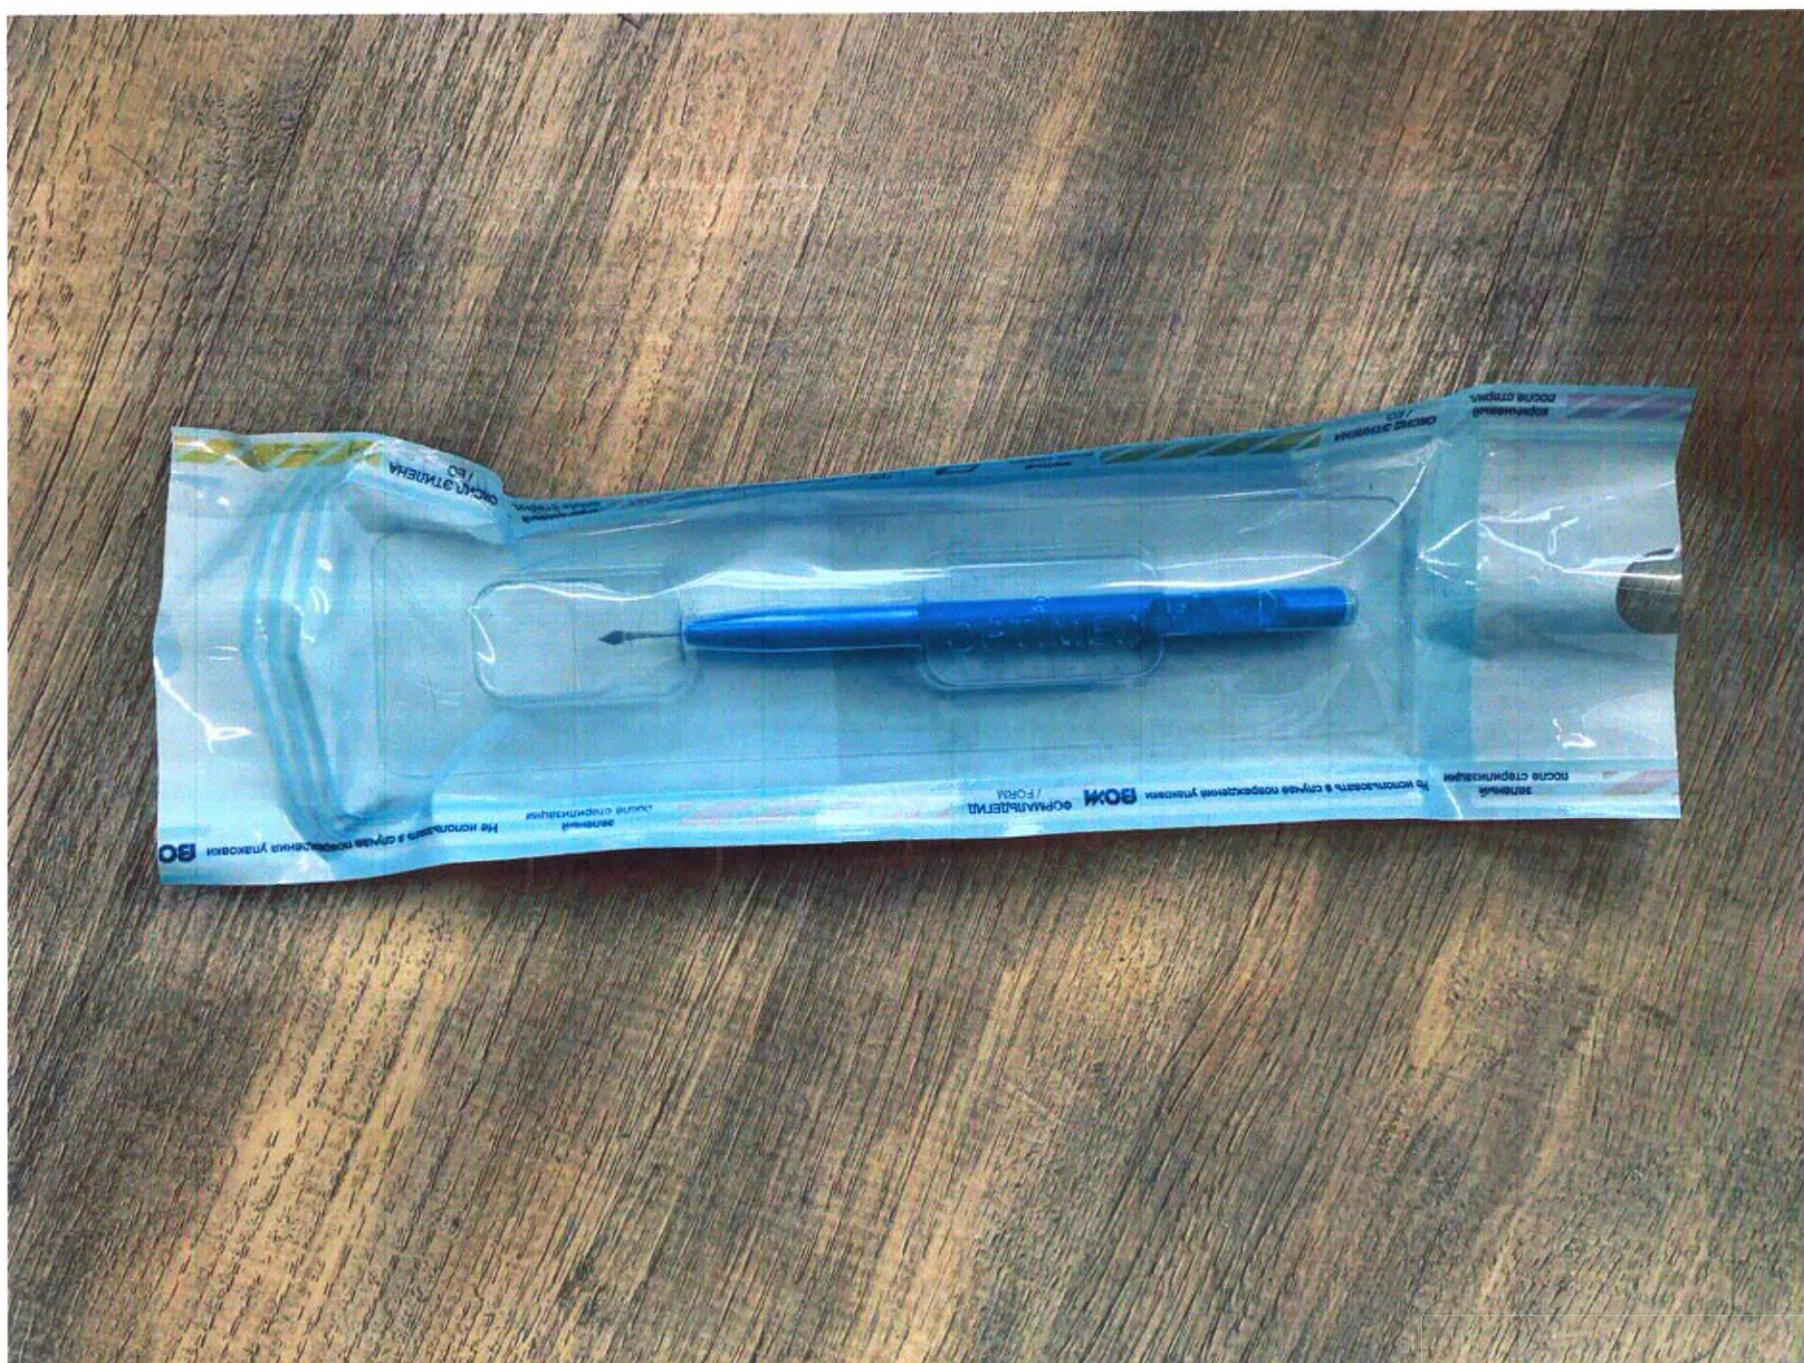

Скальпель – кератом



Скальпель – расширитель

5 ШТУК

СКАЛЬПЕЛИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ "ОПТИМЕД"

по ТУ 32.50.13-012-29792921-2020

Макет упаковки паковка Скальпели офтальмологические микрохирургические "Оптимед" по ТУ 32.50.13-012-29792921-2020

В упаковке:
- Скальпели офтальмологические микрохирургические
«Оптимед» по ТУ 32.50.13-012-29792921-2020 - 5 шт.
РУ № ФСР 2009/04347 от _____

- инструкция по применению

- 1 шт.

STERILE EO



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5°C до +30°C.
Вскрывать первичную упаковку только в стерильных условиях.
Использовать изделие непосредственно сразу после вскрытия.
Предназначено только для однократного использования.
Необходимо утилизировать сразу же после проведения лечебной процедуры.
Утилизация должна осуществляться в соответствии с принятой медицинской практикой и действующими государственными либо местными нормативами.

РАЗРАБОТЧИК/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.
453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145.
АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
ЗАО «Оптимедсервис», Россия.
453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - интернационалистов д. 17.

Макет упаковка Скальпели офтальмологические микрохирургические "Оптимед" по ТУ 32.50.13-012-29792921-2020

**СКАЛЬПЕЛИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ «ОПТИМЕД»**
по ТУ 32.50.13-012-29792921-2020

Варианты исполнения:

- Скальпель - копые, типоразмер ☒ 0,8 мм ☐ 1,2 мм ☐ 1,4 мм ☐ 1,6 мм
- Скальпель - кератом, типоразмер ☐ 2,0 мм ☐ 2,2 мм ☐ 2,4 мм ☐ 2,6 мм ☐ 2,75 мм
- Скальпель - расширитель, типоразмер ☐ 5,5 мм

Макет упаковка Скальпели офтальмологические микрохирургические "Оптимед" по ТУ 32.50.13-012-29792921-2020

СКАЛЬПЕЛИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ "ОПТИМЕД"

Одноразовые

5 штук


СТЕРИЛЬНО

Дата выпуска: 08 02 21

Годен до: 08 02 24

Партия №: 003F

Макет упаковки Скальпели офтальмологические микрохирургические "Оптимед" по ТУ 32.50.13-012-29792921-2020

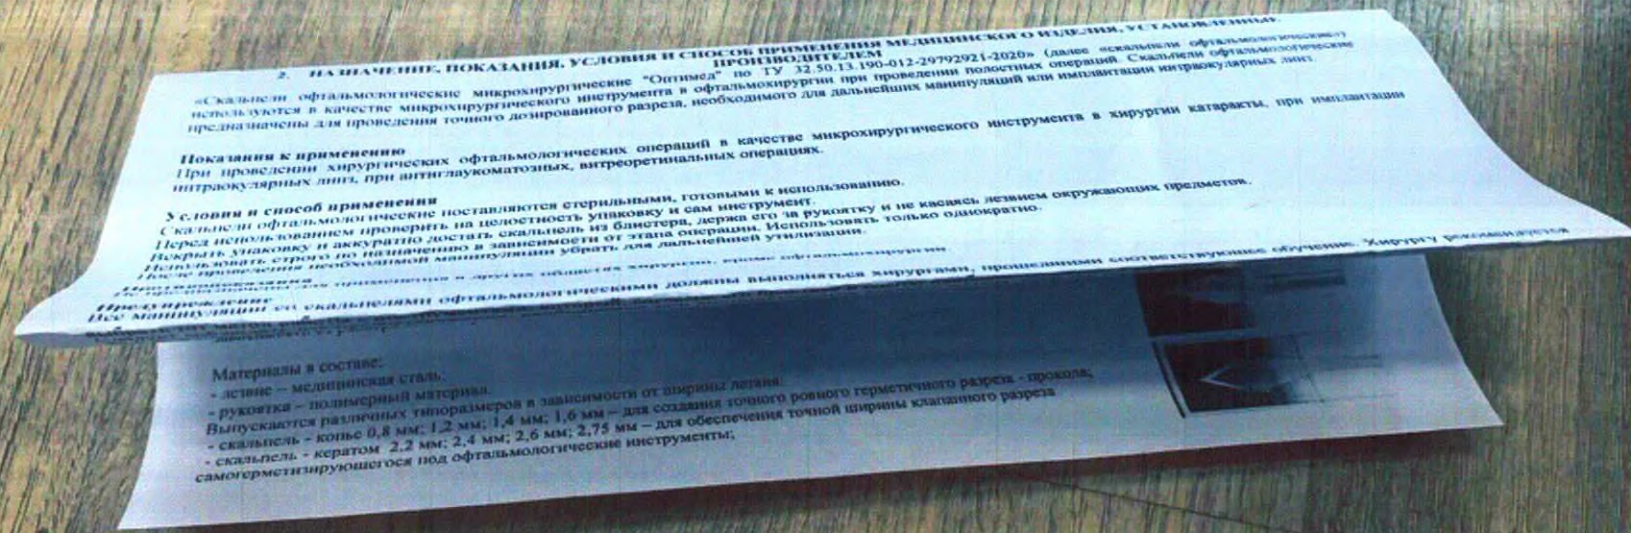

Макет инструкции Скальпели офтальмологические микрохирургические "Оптимед" по ТУ 32.50.13-012-29792921-2020

Скальпели офтальмологические микрохирургические "Оптимед"
по ТУ 32.50.13-012-29792921-2020
ПУ № ФСР 2009/04347 от _____

«Оптимедсервис»

Варианты исполнения:

Скальпель - копьё, типоразмер ☒ 0,8 мм ☐ 1,2 мм ☐ 1,4 мм ☐ 1,6 мм

Скальпель - кератом, типоразмер ☐ 2,0 мм ☐ 2,2 мм ☐ 2,4 мм ☐ 2,6 мм ☐ 2,75 мм

Скальпель - расширитель, типоразмер ☐ 5,5 мм



Не использовать при
нарушении
стерильного барьера

Дата выпуска:
Годен до:
Партия №:

08 02 21
08 02 24
003F

Макет маркировки Скальпели офтальмологические микрохирургические "Оптимед" по ТУ 32.50.13-012-29792921-2020

