Доп к ЛА

BECKMAN COULTER

Technical Documentation

Addendum to Instruction for Use
Access SARS-CoV-2 IgM Calibrator
For Russia Regulation

As responsible official of Beckman Coulter, Inc., I hereby certify that document attached to this cover letter is a true copy of the original document.

Authorized Signatory:

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document, to which this certificate is attached and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California)
ss
County of Orange)

On Friday, March 26, 2021 before me, Xochitl Meraz, Notary Public, personally appeared Nanette Canepa who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that she executed the same in her authorized capacity, and that by her signatures on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Notary Public

XOCHITL MERAZ
Notary Public - California
Orange County
Commission # 2228730
My Comm. Expires Feb 10, 2022

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Boulevard
Brea, CA 92821

Mailing Address:
250 S. Kraemer Boulevard
P.O. Box 8000
Brea, CA 92822-8000

Telephone: (714) 993-5321
Facsimile: (714) 961-4234
Internet: www.beckmancoulter.com

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ПРИНЦИП

Наименование

Калибраторы для калибровки анализа качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека, иммунохемилюминесцентным методом для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system, в составе:

1. Калибраторы для калибровки анализа качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 (Access SARS-CoV-2 IgM Calibrator):

1.1. Калибраторы C0, C1 – 2 флакона;

1.2. Калибровочная карта со штрих кодами.

Далее по тексту может упоминаться как «Калибраторы Access SARS-CoV-2 IgM», «Access SARS-CoV-2 IgM Cal».

НАЗНАЧЕНИЕ

Калибраторы Access SARS-CoV-2 IgM предназначены для калибровки исследования Access SARS-CoV-2 IgM для качественного определения in vitro антител IgM к SARS-CoV-2 в человеческой сыворотке, в пробирках для отделения сыворотки, и в плазме (с добавлением гепарина, EDTA и цитрата), только для использования на системах иммунохимического анализа семейства Access.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Калибратор Access SARS-CoV-2 IgM используется для калибровки (определения порогового значения) исследования Access SARS-CoV-2 IgM. Путем сравнения интенсивности света, генерируемого образцом, со значением cut-off, определяется наличие или отсутствие в образце антител IgM к SARS-CoV-2.

Утилизация

Химические остатки и отходы должны перерабатываться в плановом порядке как специальные отходы. Они подлежат утилизации в соответствии с законодательством по предотвращению загрязнения окружающей среды и прочими законами соответствующей страны. В целях обеспечения соответствия мы рекомендуем связаться с соответствующими местными органами и\или утвержденной компанией, занимающейся переработкой отходов, для получения информации.

При обращении с медицинскими отходами на территории Российской Федерации необходимо соблюдать местное законодательство и, в частности, санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 от 28 января 2021 года (Отходы класса А). Процедура утилизации отходов определяется в соответствии с правилами и предписаниями Федерального закона № 89-ФЗ «О отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Не применимо для данного медицинского изделия.

Сведения о маркировке

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

IVD

Регистрационное удостоверение: XXXXXX от XXXXXX

Калибраторы для калибровки анализа качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека, иммунохемилюминесцентным методом для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system (LOT 124325)

Калибраторы для калибровки анализа качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека, иммунохемилюминесцентным методом (Access SARS-CoV-2 IgM Calibrator) (LOT 124325)

Состав:

Калибраторы C0, C1 – 2 флакона;
Калибровочная карта со штрих кодами.
C0-C1, 2,0 мл/флакон. C0: Буфер TRIS, сурфактант и белок (бычий), <0,1% азида натрия и 0,5% ProClin* 300. C1:Буфер TRIS, содержащий положительную плазму с антителами IgM к SARS-CoV-2, сурфактант и белок (бычий), <0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300.

Кат. номер:	C58958
Лот:	см. на упаковке
Срок годности:	см. на упаковке
Страна происхождения:	см. на упаковке
Форма поставки:	2 фл x 2 мл; таблица результатов

«Осторожно»

H317, H412,
P273, P280,
P333+P313,
P362+P364

2° C – 10° C

C58958_RUS_v1

Производитель:
Бекмен Культер, Инк., 250 С. Крамер Бульвар, Брея, штат Калифорния 92821 США
Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Бекмен Культер", Москва, Россия, 109004, Станиславского 21, стр.3

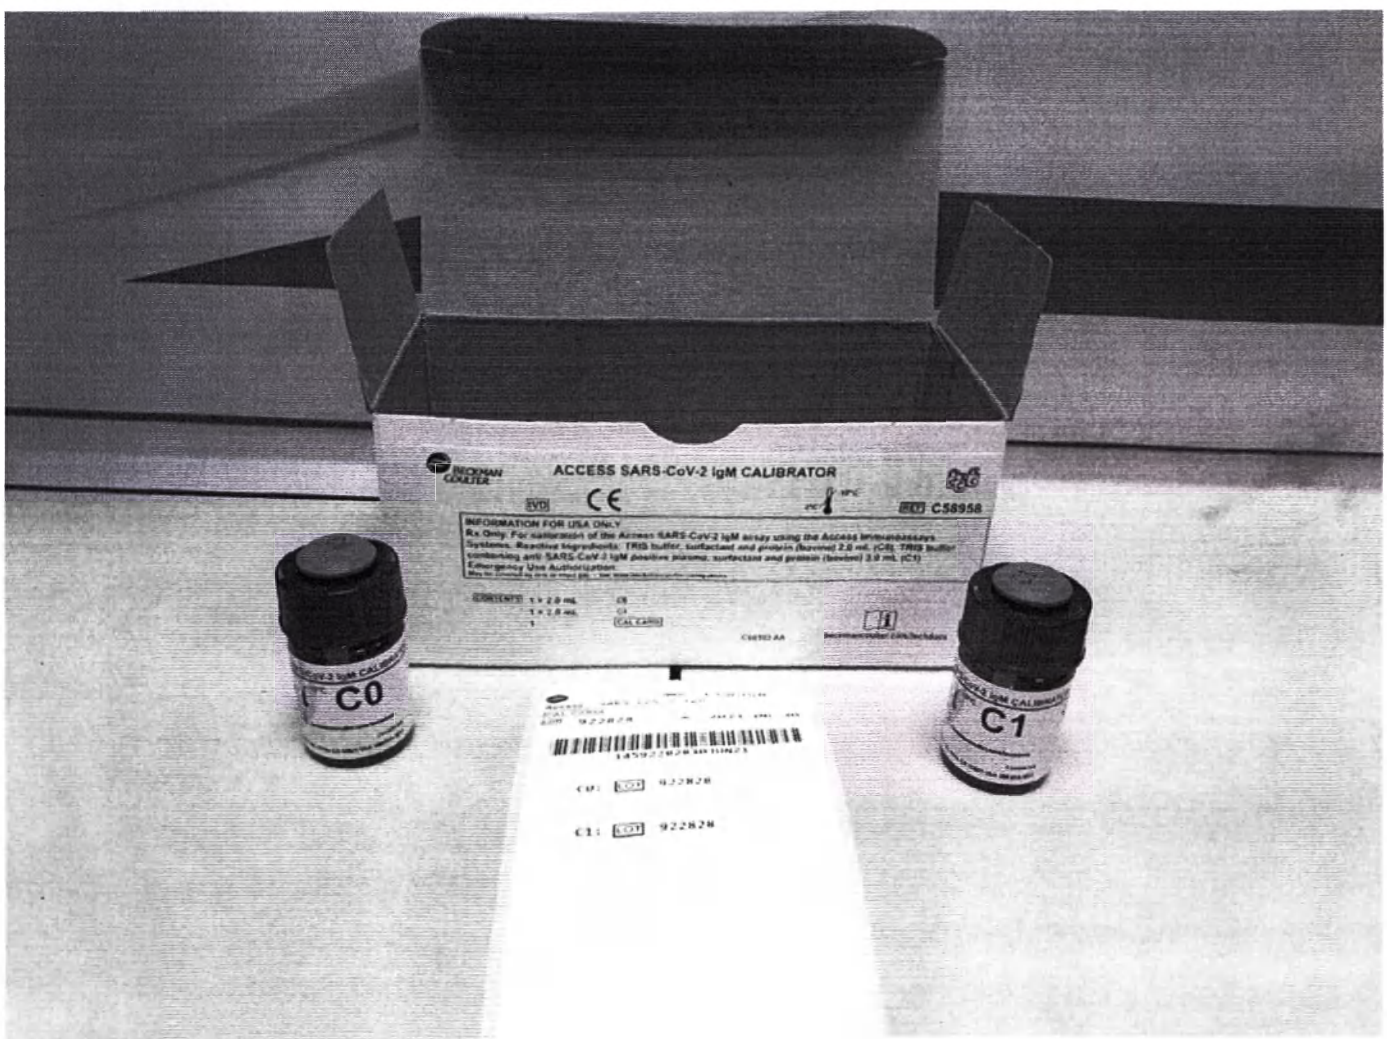

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование символа	Графическое обозначение символа	Наименование символа	Графическое обозначение символа
- номер по каталогу		- изготовитель	
- код партии		- содержимого достаточно для провеения n-количества тестов	
- логотип изготовителя		- изделие медицинское для диагностики in vitro	
- температурный диапазон		- наличие сертификата на соответствие европейским стандартам в Евросоюзе	
- обратитесь к руководству по эксплуатации		- использовать до…	
- биологический риск		- дата изготовления	

СВЕДЕНИЯ О РЕДАКЦИЯХ

Версия A
Новый выпуск.

КЛЮЧ СИМВОЛОВ

Глоссарий символов доступен на сайте beckmancoulter.com/techdocs (номер документа C02724).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РФ:

ООО «Бекмен Культер», 109004 Москва, Россия, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3.
Тел. +7 (495) 228 67 00, e-mail: beckman.ru@beckman.com

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

/Перевод с английского языка на русский язык/

Техническая документация

Дополнение к Инструкции по применению
Калибраторы для калибровки анализа качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека, иммунохемилюминесцентным методом для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system (Access SARS-CoV-2 IgM Calibrator)
Для регистрации в России

В качестве ответственного должностного лица компании Бекмен Культер, Инк., настоящим я заявляю, что прилагаемый к настоящему сопроводительному письму документ является точной копией оригинала.

/Печать:
Бекмен Культер Инк.
Отдел нормативно-правового регулирования/

Уполномоченное лицо с правом подписи:

/Подпись/

Нотариус или прочее должностное лицо, подписывающее настоящее свидетельство, подтверждает только личность лица, поставившего подпись под документом, к которому прилагается данное свидетельство, а не достоверность, точность или действительность самого документа.

Штат Калифорния)
Место
Округ Ориндж)

В пятницу, 26 марта 2021 года передо мной, Ксочитл Мераз (Xochitl Meraz), нотариусом, появилась Нанетт Канепа (Nanette Canepa), которая доказала мне на основе убедительных свидетельств, что она является лицом, чья подпись поставлена на документе, и подтвердила, что она выполнила данный акт в соответствии с имеющимися у нее полномочиями, и что поставив свою подпись на документе, лицо или компания, от имени которой действовало настоящее лицо, исполнило(а) настоящий документ.

Я заявляю ПОД СТРАХОМ НАКАЗАНИЯ ЗА ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО в соответствии с законодательством Штата Калифорния, что предыдущий параграф является подлинным и корректным.

ЗАВЕРЯЮ своей подписью и печатью.

КСОЧИТЛ МЕРАЗ (XOCHITL MERAZ)
Государственный Нотариус - штат Калифорния
Округ Ориндж
Лицензия № 2228730
Срок действия лицензии истекает 10 февраля 2022 года

/Подпись/

Нотариус

Бекмен Культер, Инк.
250 С. Крамер Бульвар, Брея, штат Калифорния, 92821

Адрес для корреспонденции:
250 С. Крамер Бульвар
а/я 8000
Брея, штат Калифорния 92822-8000

Телефон: (714) 993-5321
Факсимиле: (714)961-4234
Интернет: www.beckmancoulter.com

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перевод данного текста выполнен переводчиком Бушенковым Иваном Витальевичем

Российская Федерация
Город Москва
Шестнадцатого июня две тысячи двадцать первого года

Я, Скляр Надежда Ивановна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Дударева Александра Владимировича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Бушенкова Ивана Витальевича.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № **77/178-н/77-2021-**

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Н. И. Скляр

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью **5** лист(-а,-ов).

ВРИО нотариуса:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

BECKMAN COULTER

Technical Documentation

Instruction for Use
Access SARS-CoV-2 IgM Calibrator

As responsible official of Beckman Coulter, Inc., I hereby certify that document attached to this cover letter is a true copy of the original document.

Authorized Signatory:

Nanette Canepa

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document, to which this certificate is attached and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California)
ss
County of Orange)

On Friday, March 26, 2021 before me, Xochitl Meraz, Notary Public, personally appeared Nanette Canepa who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that she executed the same in her authorized capacity, and that by her signatures on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

XOCHITL MERAZ
Notary Public - California
Orange County
Commission # 2228730
My Comm. Expires Feb 10, 2022

Notary Public

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Boulevard
Brea, CA 92821

Mailing Address:
250 S. Kraemer Boulevard
P.O. Box 8000
Brea, CA 92822-8000

Telephone: (714) 993-5321
Facsimile: (714) 961-4234
Internet: www.beckmancoulter.com

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

BECKMAN COULTER

ACCESS
Immunoassay Systems

Инструкции по применению

© 2020 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

ACCESS SARS-CoV-2 IgM CALIBRATOR
SARS-CoV-2 IgM

REF C58958

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Применять только для диагностики *in vitro*

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СИСТЕМАХ ИММУНОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЕМЕЙСТВА ACCESS

ЕЖЕГОДНАЯ ПРОВЕРКА

Проверено	Дата	Проверено	Дата

ПРИНЦИП

НАЗНАЧЕНИЕ

Калибраторы Access SARS-CoV-2 IgM предназначены для калибровки исследования Access SARS-CoV-2 IgM для качественного определения *in vitro* антител IgM к SARS-CoV-2 в человеческой сыворотке, в пробирках для отделения сыворотки, и в плазме (с добавлением гепарина, EDTA и цитрата), только для использования на системах иммунохимического анализа семейства Access.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Калибратор Access SARS-CoV-2 IgM используется для калибровки (определения порогового значения) исследования Access SARS-CoV-2 IgM. Путем сравнения интенсивности света, генерируемого образцом, со значением cut-off, определяется наличие или отсутствие в образце антител IgM к SARS-CoV-2.

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

Анализируемое вещество в калибраторе Access SARS-CoV-2 IgM прослеживается до рабочих калибраторов производителя. Соответствие стандартам измерений основано на стандарте EN ISO 17511.

Установленные значения были получены при анализе репрезентативных проб данной партии калибратора и являются специфическими для методик исследования реагентов Access. Значения, установленные с помощью других методик, могут отличаться. Эти различия могут быть обусловлены отклонениями, вызванными отличиями методов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

РЕАГЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Калибратор Access SARS-CoV-2 IgM
Ссылочный номер C58958: C0–C1, 2,0 мл/флакон

- Поставляется готовым к использованию.
- Храните в вертикальном положении в холодильнике при 2-10°C.
- Перемешайте содержимое перед использованием, осторожно переворачивая флакон. Избегайте образования пузырьков.
- Стабилен до истечения срока годности, указанного на этикетке, при хранении в невскрытой упаковке при 2-10°C.
- Содержимое флакона стабильно при 2-10°C в течение 90 дней с момента первоначального использования.
- Признаком возможного разрушения является выход контрольных значений за пределы установленного диапазона.
- Обратитесь к калибровочной карте для получения точных концентраций.

C0:	Буфер TRIS, сурфактант и белок (бычий), <0,1% азида натрия и 0,5% ProClin* 300.
C1:	Буфер TRIS, содержащий положительную плазму с антителами IgM к SARS-CoV-2, сурфактант и белок (бычий), <0,1% азида натрия и 0,5% ProClin 300.
Калибровочная карта:	1

*ProClin™ является торговым знаком компании Dow Chemical Company («Dow») или дочерней компании Dow.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **Для диагностики *in vitro*.**
- При соблюдении описанной процедуры риск работы с пробами и препаратами крови минимален. Однако с этими продуктами необходимо обращаться как с потенциально инфекционно-опасными, соблюдая универсальные меры предосторожности и правила надлежащей лабораторной практики[1] вне зависимости от их происхождения, обработки и предшествующей сертификации. Для дезинфекции используйте соответствующее дезинфицирующее средство. Храните и утилизируйте данные материалы и контейнеры из-под них в соответствии с местными предписаниями и руководствами.
- Антитела, используемые для приготовления реагента, получают из человеческой плазмы. Всегда рассматривайте эти продукты как потенциально инфекционные. Вне зависимости от их происхождения, обработки и предшествующей сертификации, обращайтесь с ними, соблюдая универсальные меры предосторожности и правила надлежащей лабораторной практики. Для дезинфекции используйте соответствующее дезинфицирующее средство. Храните и утилизируйте данные материалы и контейнеры из-под них в соответствии с местными предписаниями и руководствами.[2]
- Сведения об опасности, представляемой продуктом, см. в следующих разделах: «АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ» И «КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПО СИСТЕМЕ GHS».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИНГРЕДИЕНТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Консервант с содержанием азида натрия может образовывать взрывоопасные соединения в металлической водопроводной арматуре. См. бюллетень Национального института по охране труда и промышленной гигиене (NIOSH) «Взрывоопасные азиды (16.08.76)».
Во избежание накопления азидных соединений промыть сливные трубы водой после сброса неразбавленного реагента. Утилизацию азида натрия следует проводить в соответствии с соответствующими местными нормами.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПО СИСТЕМЕ СГС

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

SARS-CoV-2 IgM C0	**ОСТОРОЖНО!**	
	H317	**Может вызывать аллергическую кожную реакцию.**
	H412	**Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.**
	P273	**Не допускать попадания в окружающую среду.**
	P280	**Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения / лица.**
	P333+P313	**При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.**
	P362+P364	**Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.**
	реакционная смесь из 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин -3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазолин -3-он [EC № 220-239-6](3:1) < 0,05%	
SARS-CoV-2 IgM C1	**ОСТОРОЖНО!**	
	H317	**Может вызывать аллергическую кожную реакцию.**
	H412	**Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.**
	P273	**Не допускать попадания в окружающую среду.**
	P280	**Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения / лица.**
	P333+P313	**При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.**
	P362+P364	**Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.**
	реакционная смесь из 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин -3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазолин -3-он [EC № 220-239-6](3:1) < 0,05%	

906	**Паспорт безопасности доступен на сайте beckmancoulter.com/techdocs**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КАЛИБРОВКА

ИНФОРМАЦИЯ О КАЛИБРОВКЕ

Предоставляются следующие калибраторы Access SARS-CoV-2 IgM: отрицательный и положительный. Данные калибровки исследования действительны не более 28 дней.

Анализируйте калибраторы в трех повторениях.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

ПРОЦЕДУРА

Обратитесь к соответствующим руководствам по эксплуатации систем и/или к справочной системе для получения информации по теории калибровки, конфигурированию калибраторов, вводу запроса на тестирование калибратора, а также анализу данных калибровки.

ПРИМЕЧАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ АНАЛИЗА

ОГРАНИЧЕНИЯ

При признаках бактериального загрязнения или повышенной мутности реагента флакон необходимо выбросить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Beckman Coulter, стилизованный логотип и упоминаемые здесь знаки продукции и услуг Beckman Coulter являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Beckman Coulter, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

Могут быть охвачены одним или более патентами. — см. www.beckmancoulter.com/patents.

ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ

Версия A

Новый выпуск.

КЛЮЧ СИМВОЛОВ

Глоссарий символов доступен на сайте beckmancoulter.com/techdocs (номер документа C02724).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ССЫЛКИ

1. Approved Guideline - Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections, M29-A4, 4th Edition, May 2014. Clinical and Laboratory Standards Institute.

2. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. HHS Publication, 5th ed., December 2009.

EC REP Beckman Coulter Eurocenter S.A., 22, rue Juste-Olivier. Case Postale 1044, CH - 1260 Nyon 1, Switzerland
Tel: +41 (0)22 365 36 11

Beckman Coulter, Inc., 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821 U.S.A.
www.beckmancoulter.com

ООО «Бекмен Культер», 109004 Москва, Россия, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3.
Тел. +7 (495) 228 67 00, e-mail: beckman.ru@beckman.com

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

/Перевод с английского языка на русский язык/

Техническая документация

Инструкция по применению
Калибраторы для калибровки анализа качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека, иммунохемилюминесцентным методом для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system (Access SARS-CoV-2 IgM Calibrator)

В качестве ответственного должностного лица компании Бекмен Культер, Инк., настоящим я заявляю, что прилагаемый к настоящему сопроводительному письму документ является точной копией оригинала.

/Печать:
Бекмен Культер Инк.
Отдел нормативно-правового регулирования/

Уполномоченное лицо с правом подписи:

/Подпись/

Нотариус или прочее должностное лицо, подписывающее настоящее свидетельство, подтверждает только личность лица, поставившего подпись под документом, к которому прилагается данное свидетельство, а не достоверность, точность или действительность самого документа.

Штат Калифорния)
Место
Округ Ориндж)

В пятницу, 26 марта 2021 года передо мной, Ксочитл Мерез (Xochitl Meraz), нотариусом, появилась Нанетт Канепа (Nanette Canepa), которая доказала мне на основе убедительных свидетельств, что она является лицом, чья подпись поставлена на документе, и подтвердила, что она выполнила данный акт в соответствии с имеющимися у нее полномочиями, и что поставив свою подпись на документе, лицо или компания, от имени которой действовало настоящее лицо, исполнило(а) настоящий документ.

Я заявляю ПОД СТРАХОМ НАКАЗАНИЯ ЗА ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО в соответствии с законодательством Штата Калифорния, что предыдущий параграф является подлинным и корректным.

ЗАВЕРЯЮ своей подписью и печатью.

КСОЧИТЛ МЕРАЗ (XOCHITL MERAZ)
Государственный Нотариус - штат Калифорния
Округ Ориндж
Лицензия № 2228730
Срок действия лицензии истекает 10 февраля 2022 года

/Подпись/

Нотариус

Бекмен Культер, Инк.
250 С. Крамер Бульвар, Брея, штат Калифорния, 92821

Адрес для корреспонденции:
250 С. Крамер Бульвар
а/я 8000
Брея, штат Калифорния 92822-8000

Телефон: (714) 993-5321
Факсимиле: (714)961-4234
Интернет: www.beckmancoulter.com

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перевод данного текста выполнен переводчиком Бушенковым Иваном Витальевичем

Российская Федерация
Город Москва
Шестнадцатого июня две тысячи двадцать первого года

Я, Скляр Надежда Ивановна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Моск Дударева Александра Владимировича, свидетельствую подлинность подписи переводч Бушенкова Ивана Витальевича.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № **77/178-н/77-2021-** 19-2774

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Н. И. Скляр

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью **8** лист(-а,-ов).

ВРИО нотариуса:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU