


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

Вариант 1, Комплектация 1

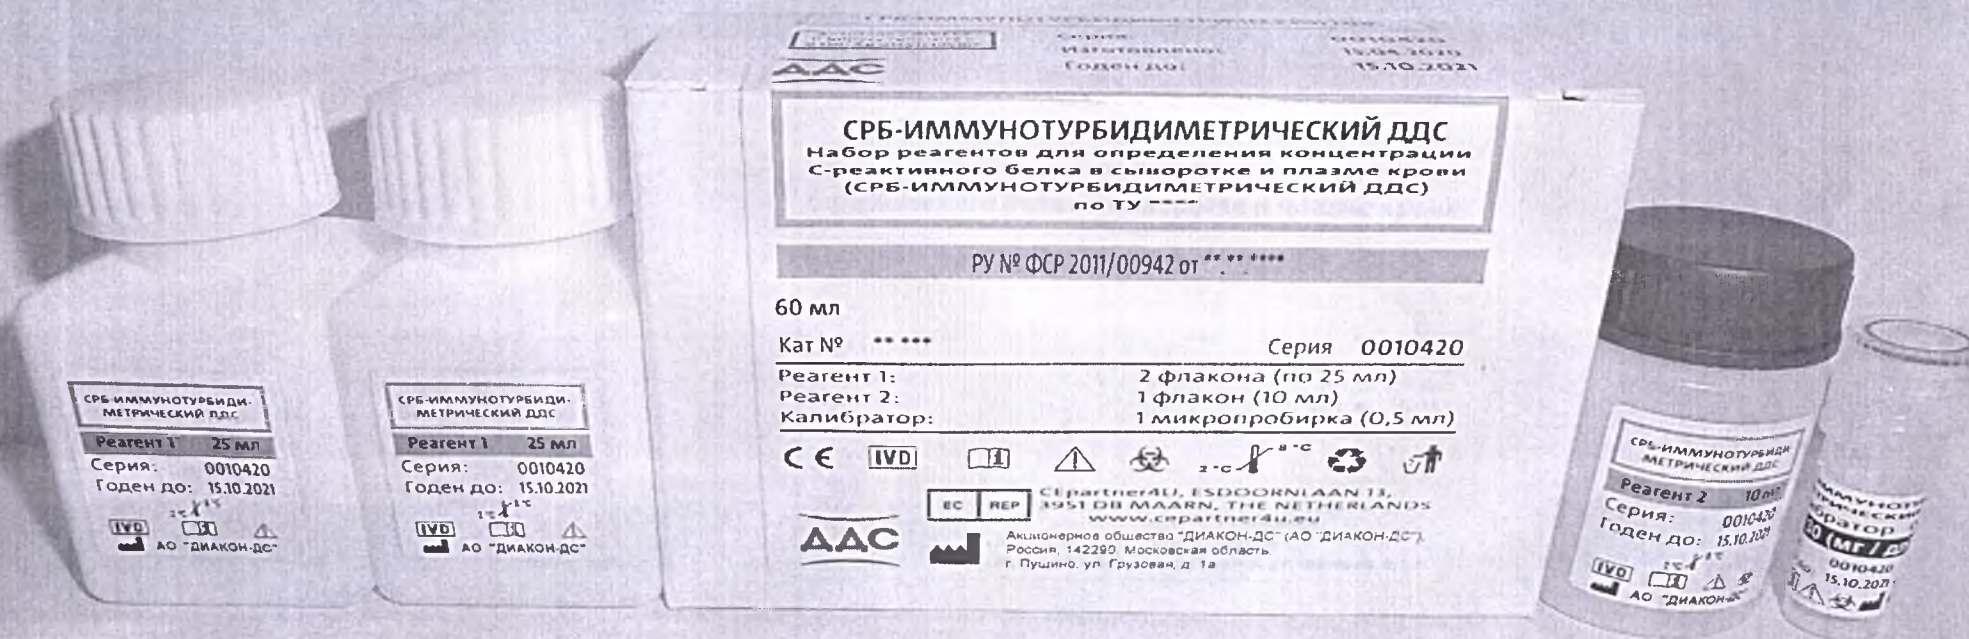


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

Вариант 1, Комплектация 1




Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

ант 1, Комплектация 2

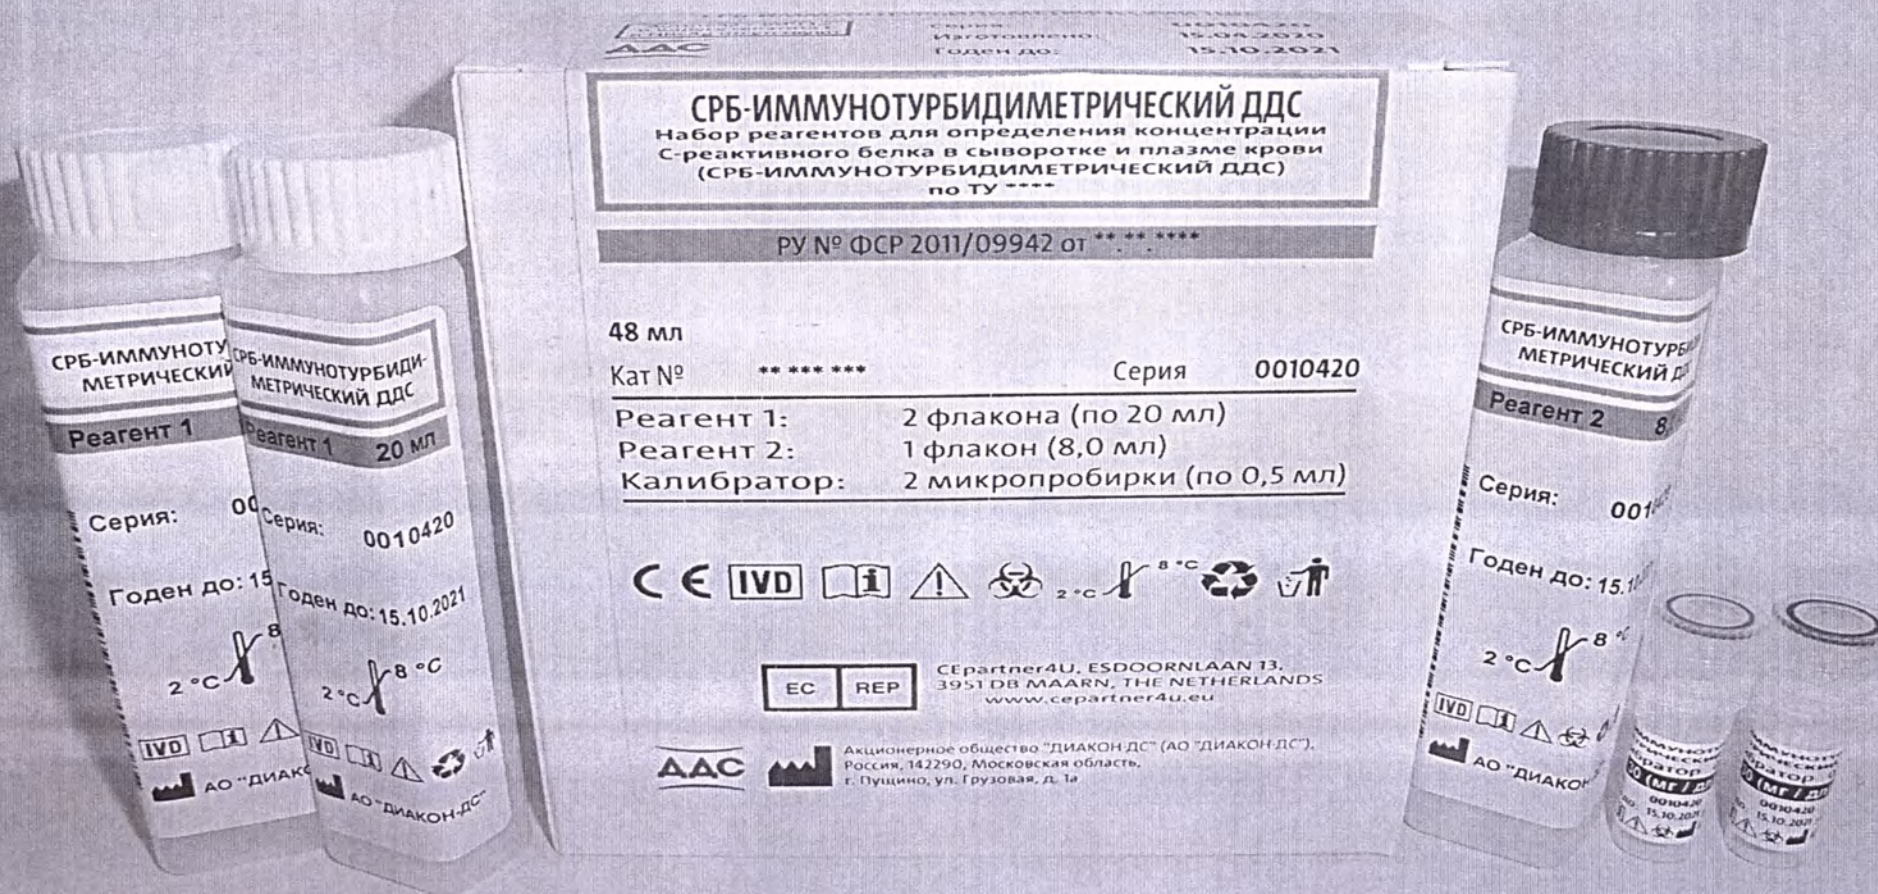


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

нт 1, Комплектация 3

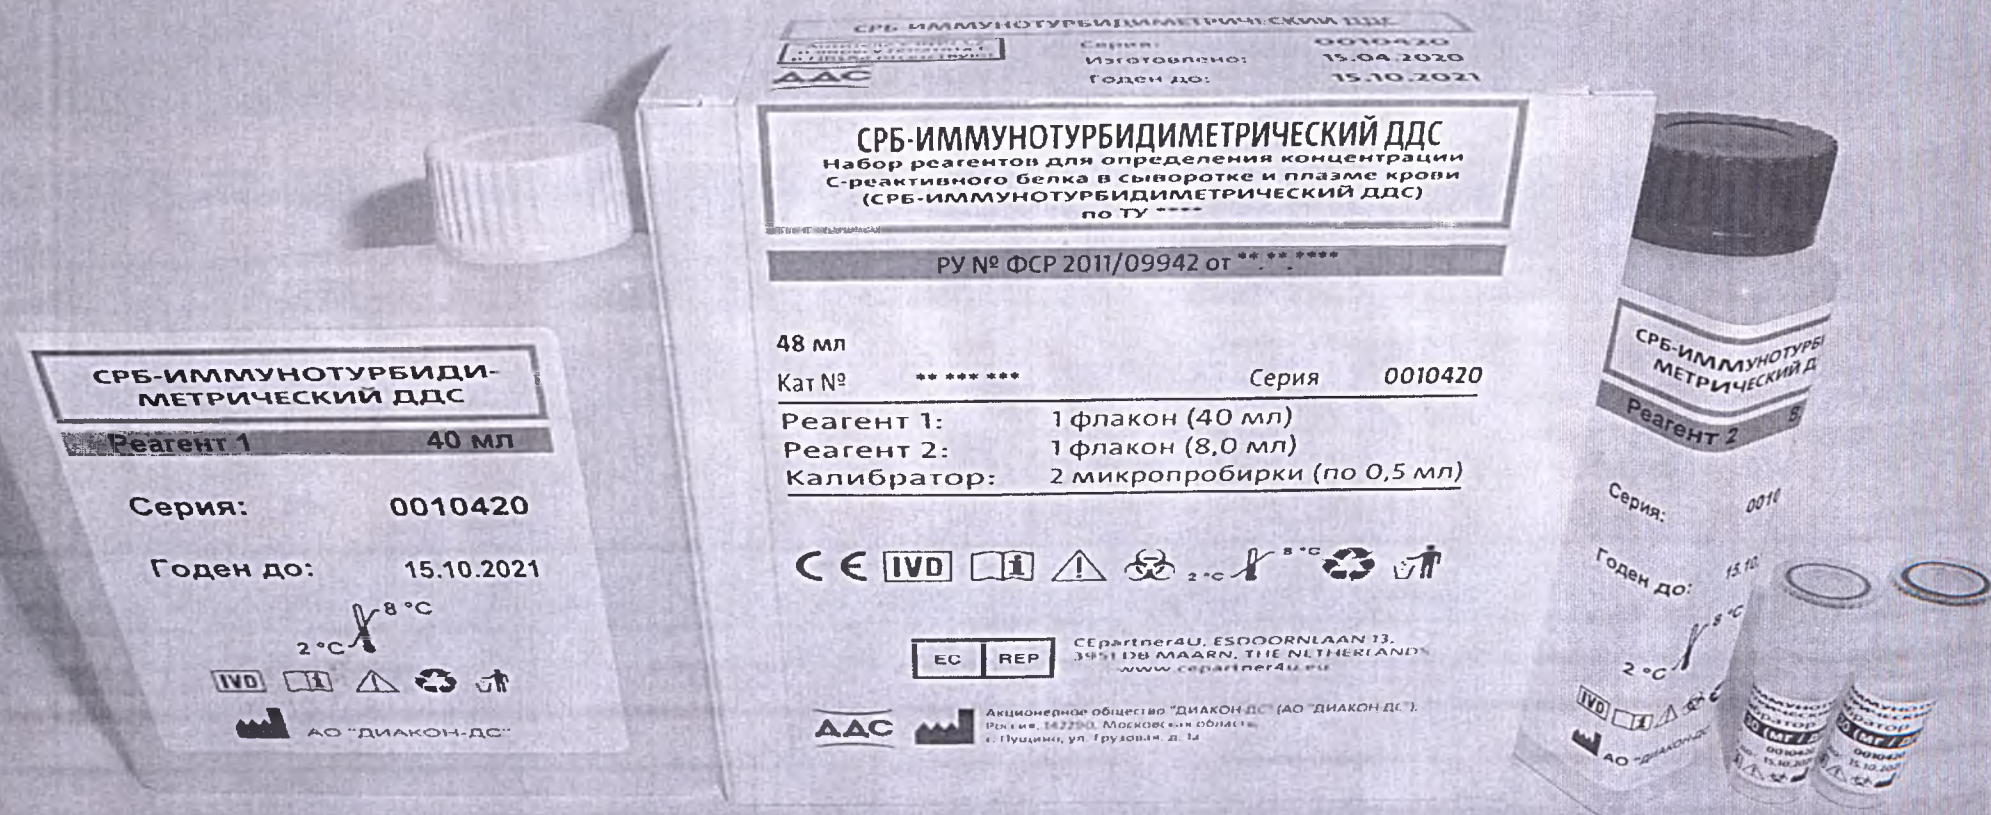


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

ит 1, Комплектация 4

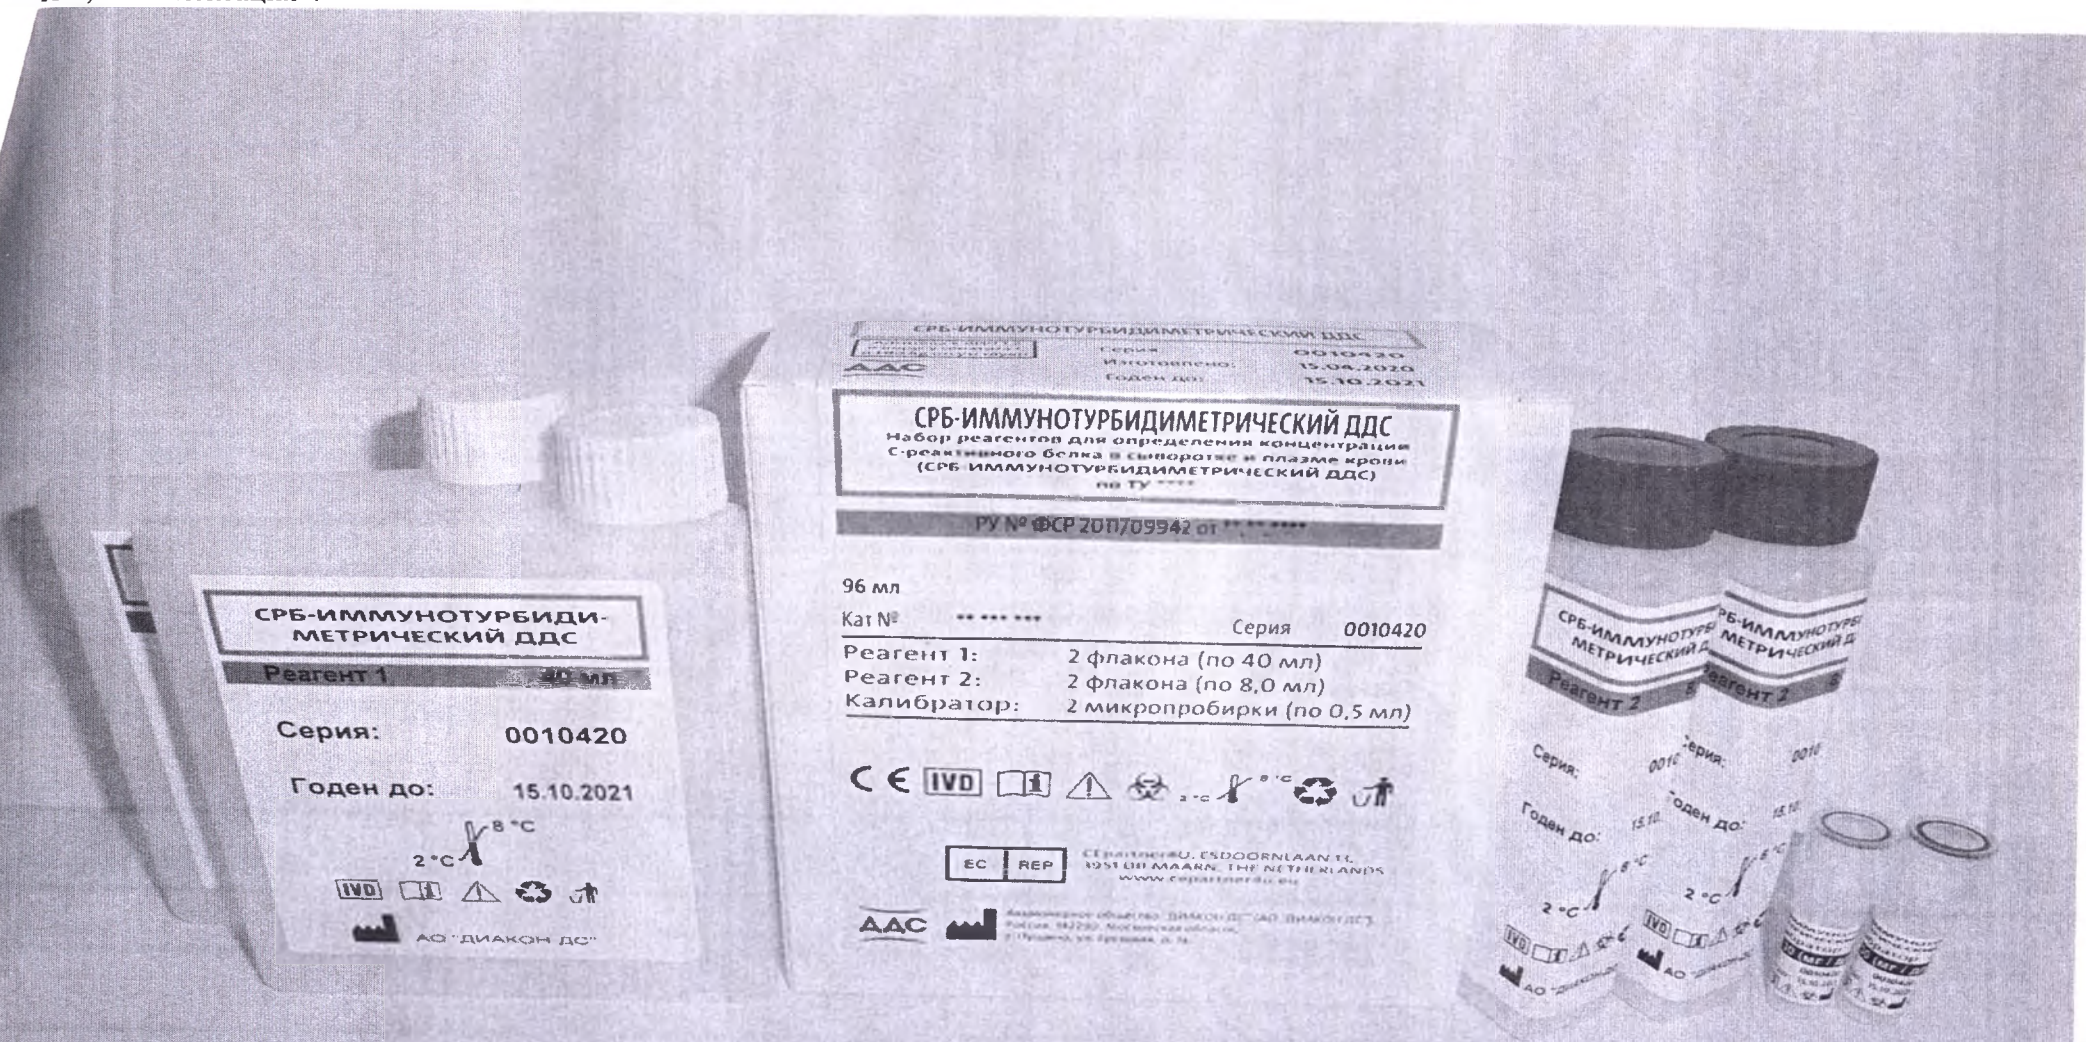



Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

г 1, Комплектация 5

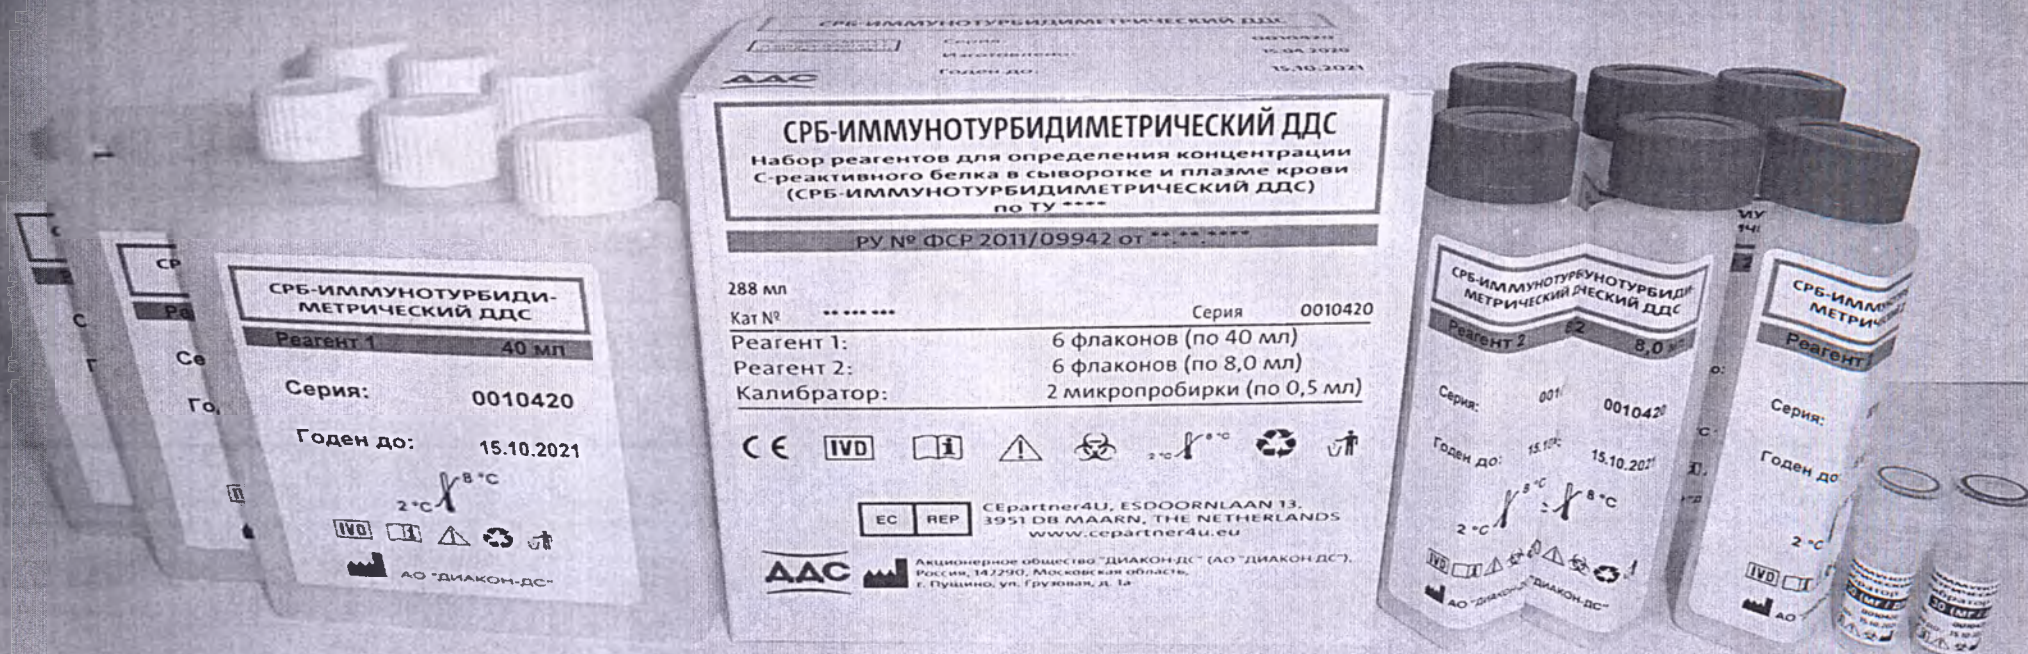

Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)


г 1, Комплектация 7

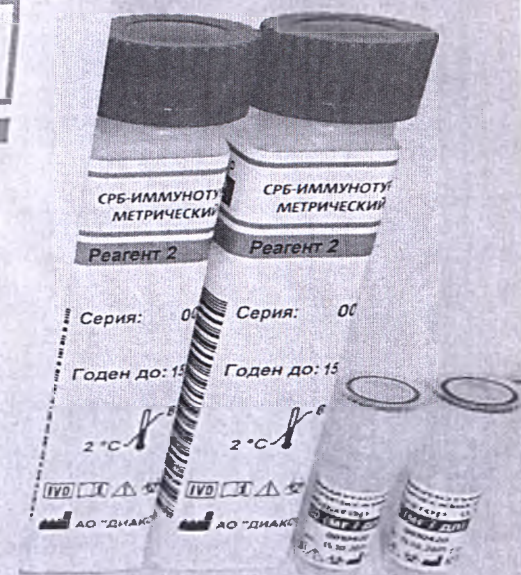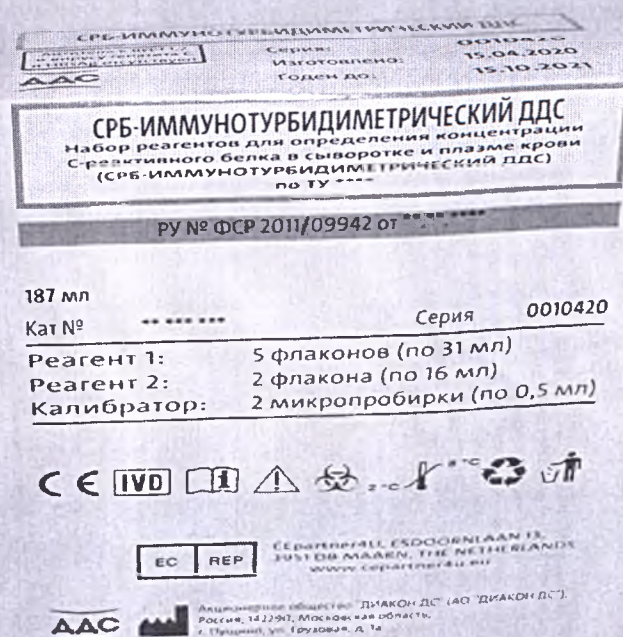

Внешний вид


Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови (СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

Кат 2, Комплектация 1

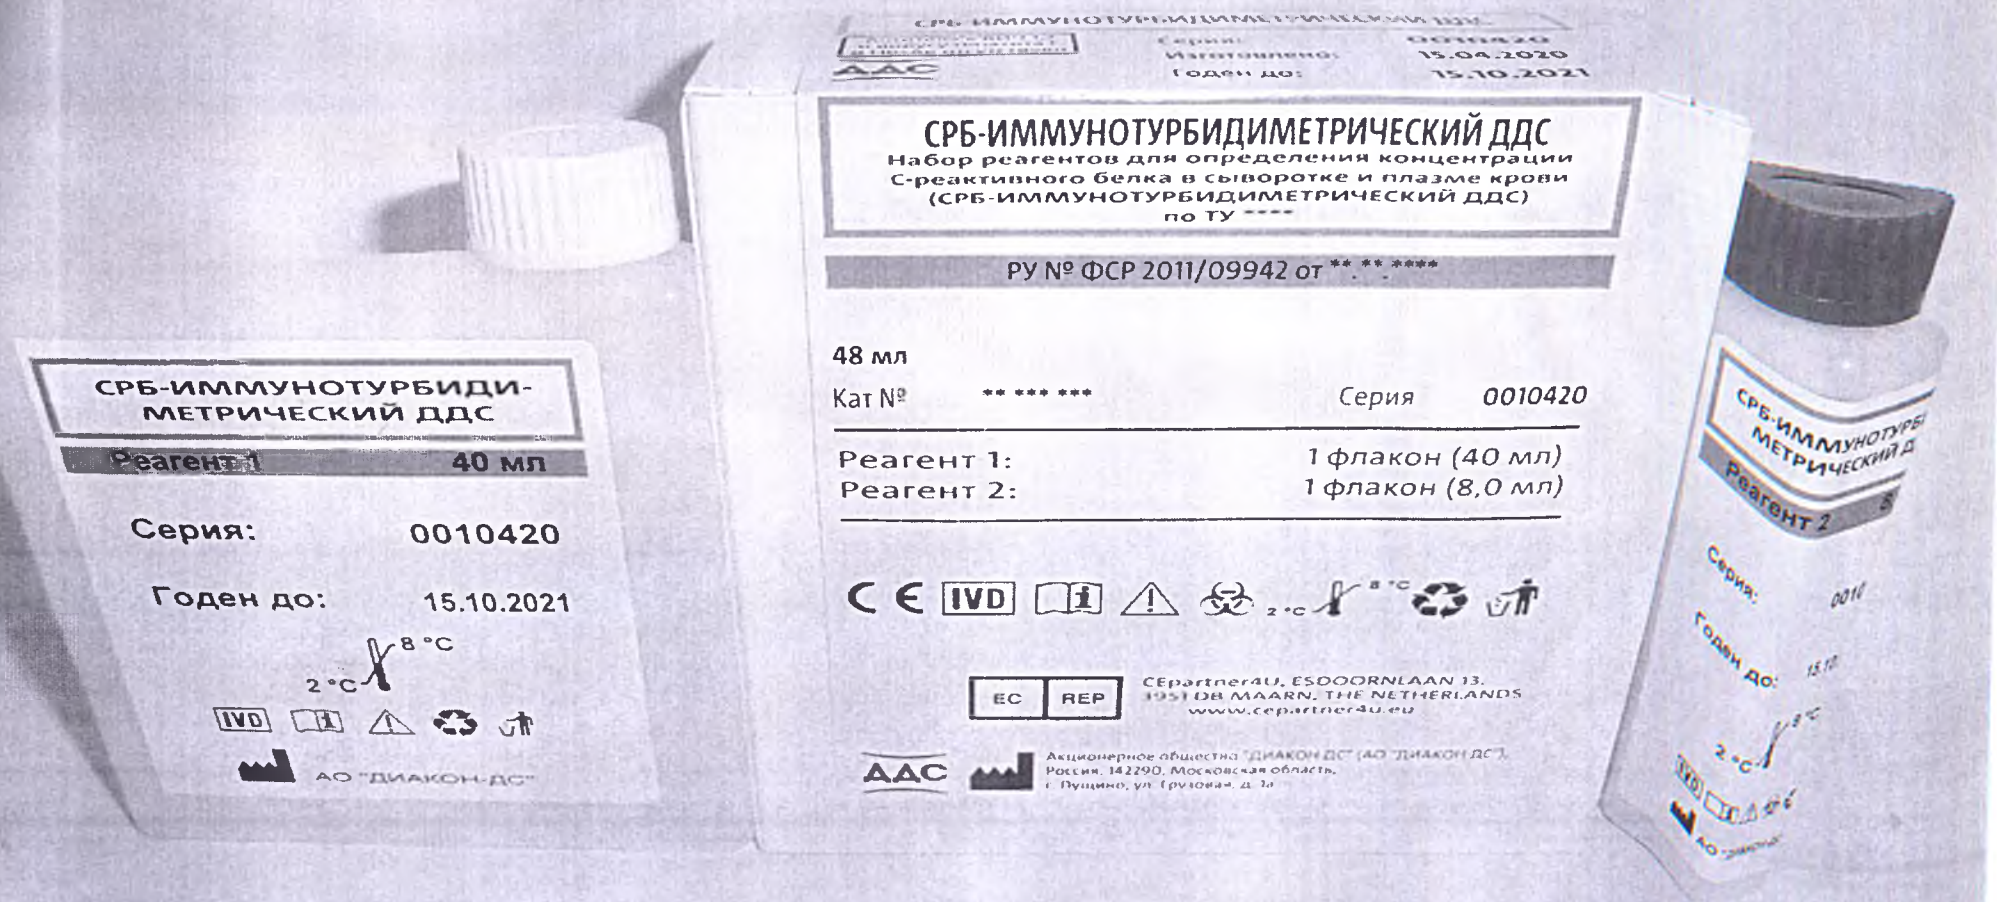


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

л 2, Комплектация 2

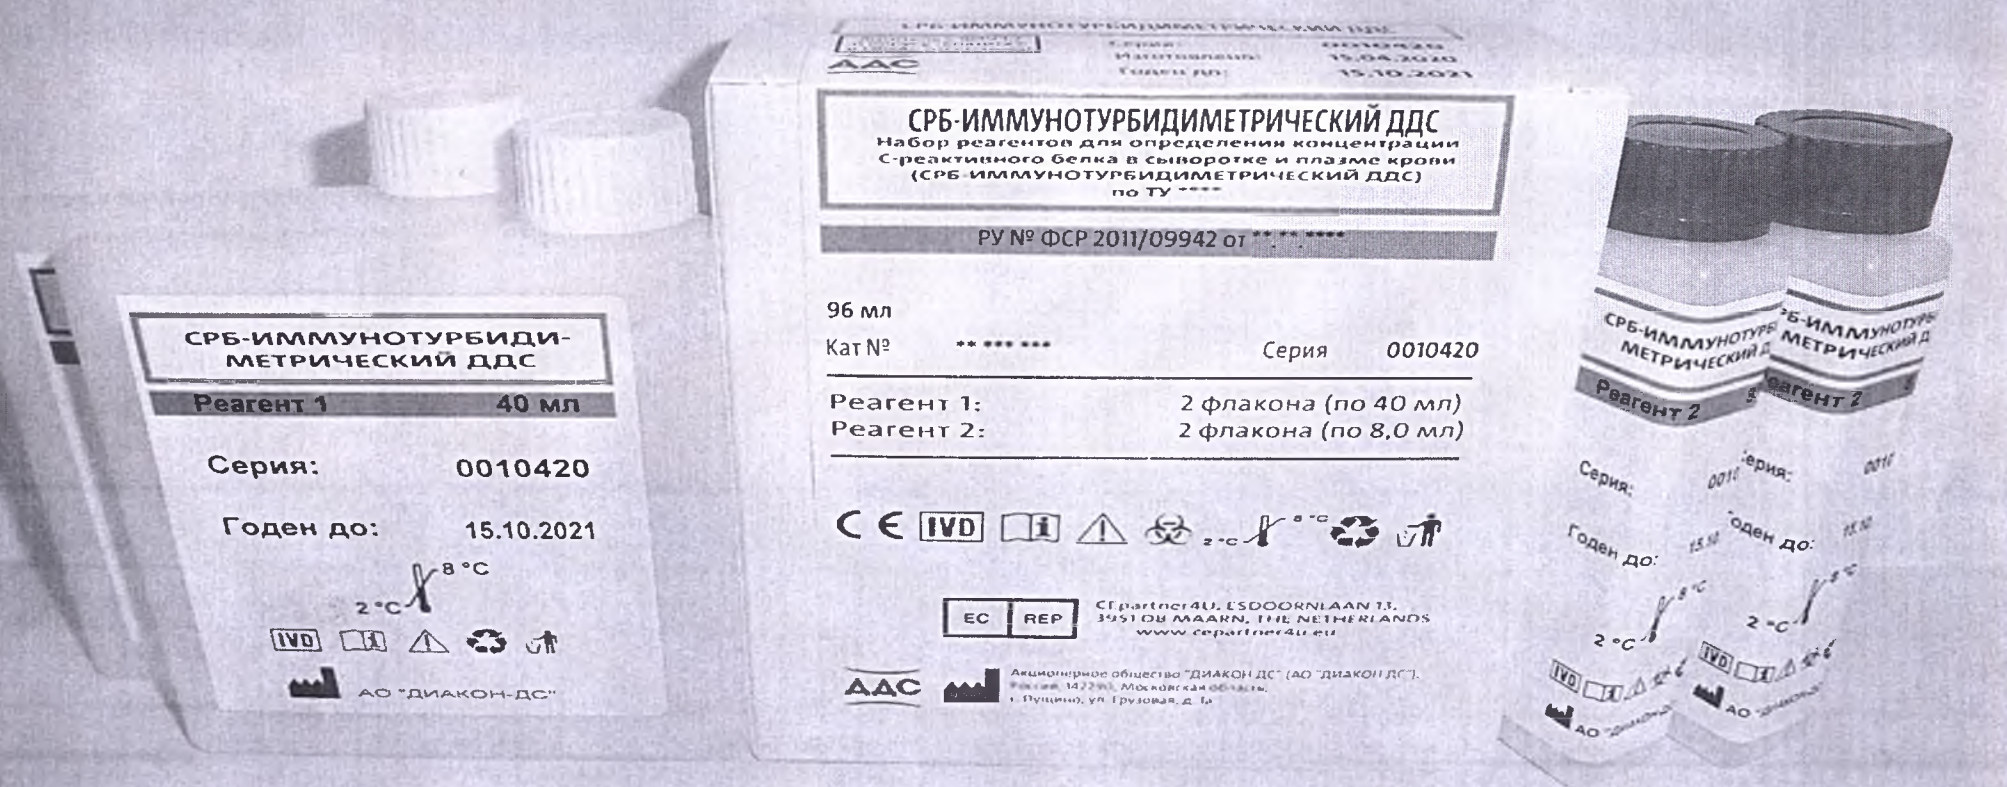


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

2, Комплектация 3

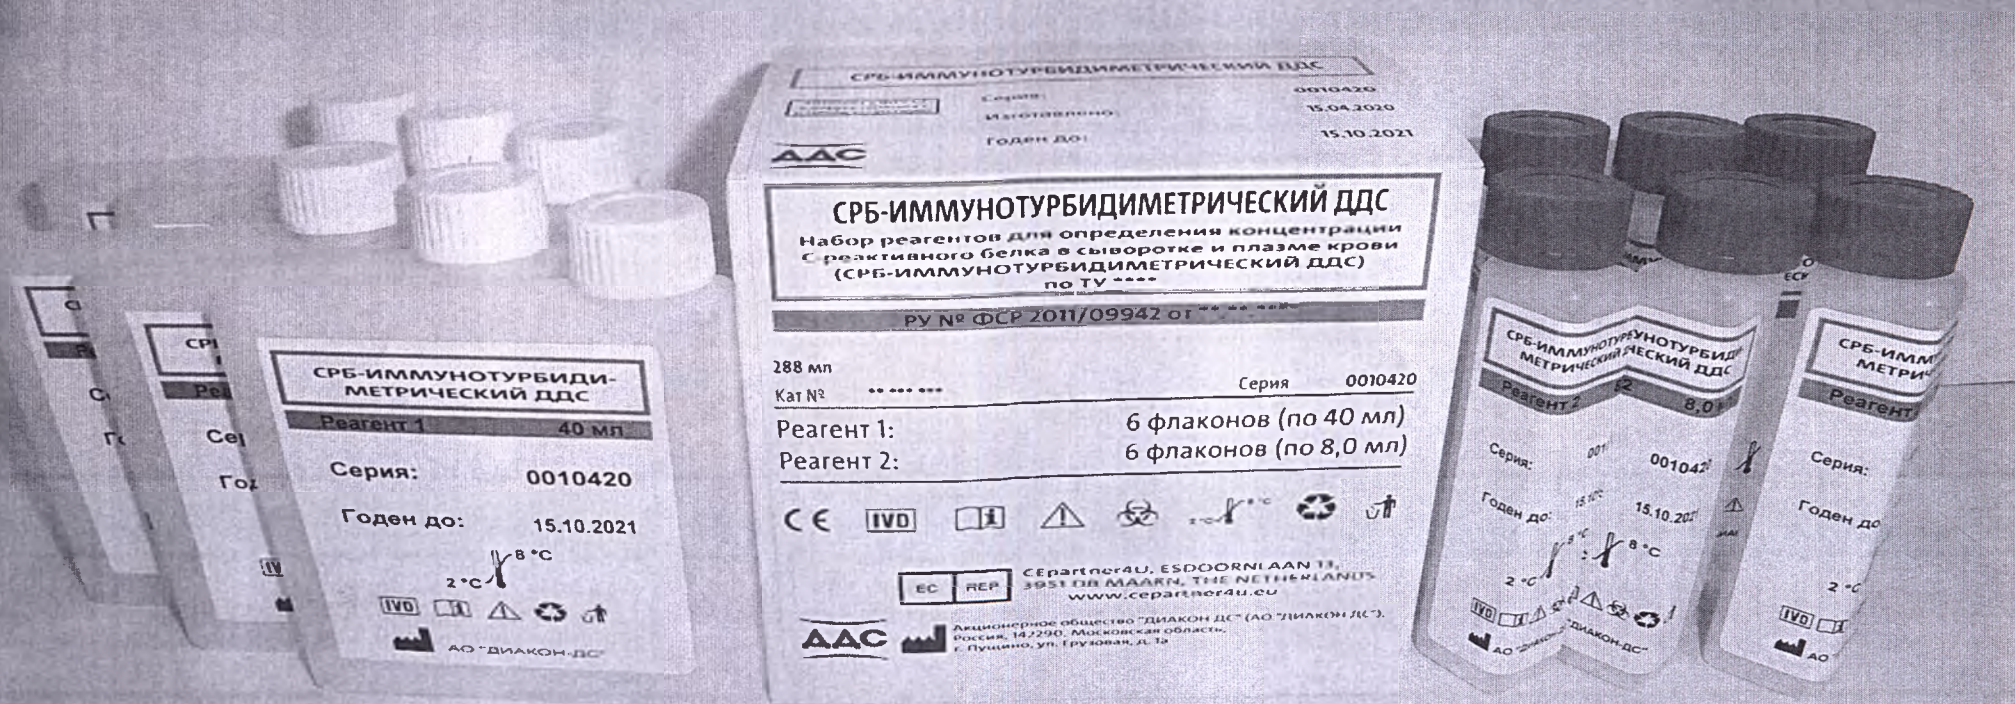


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

2, Комплектация 4

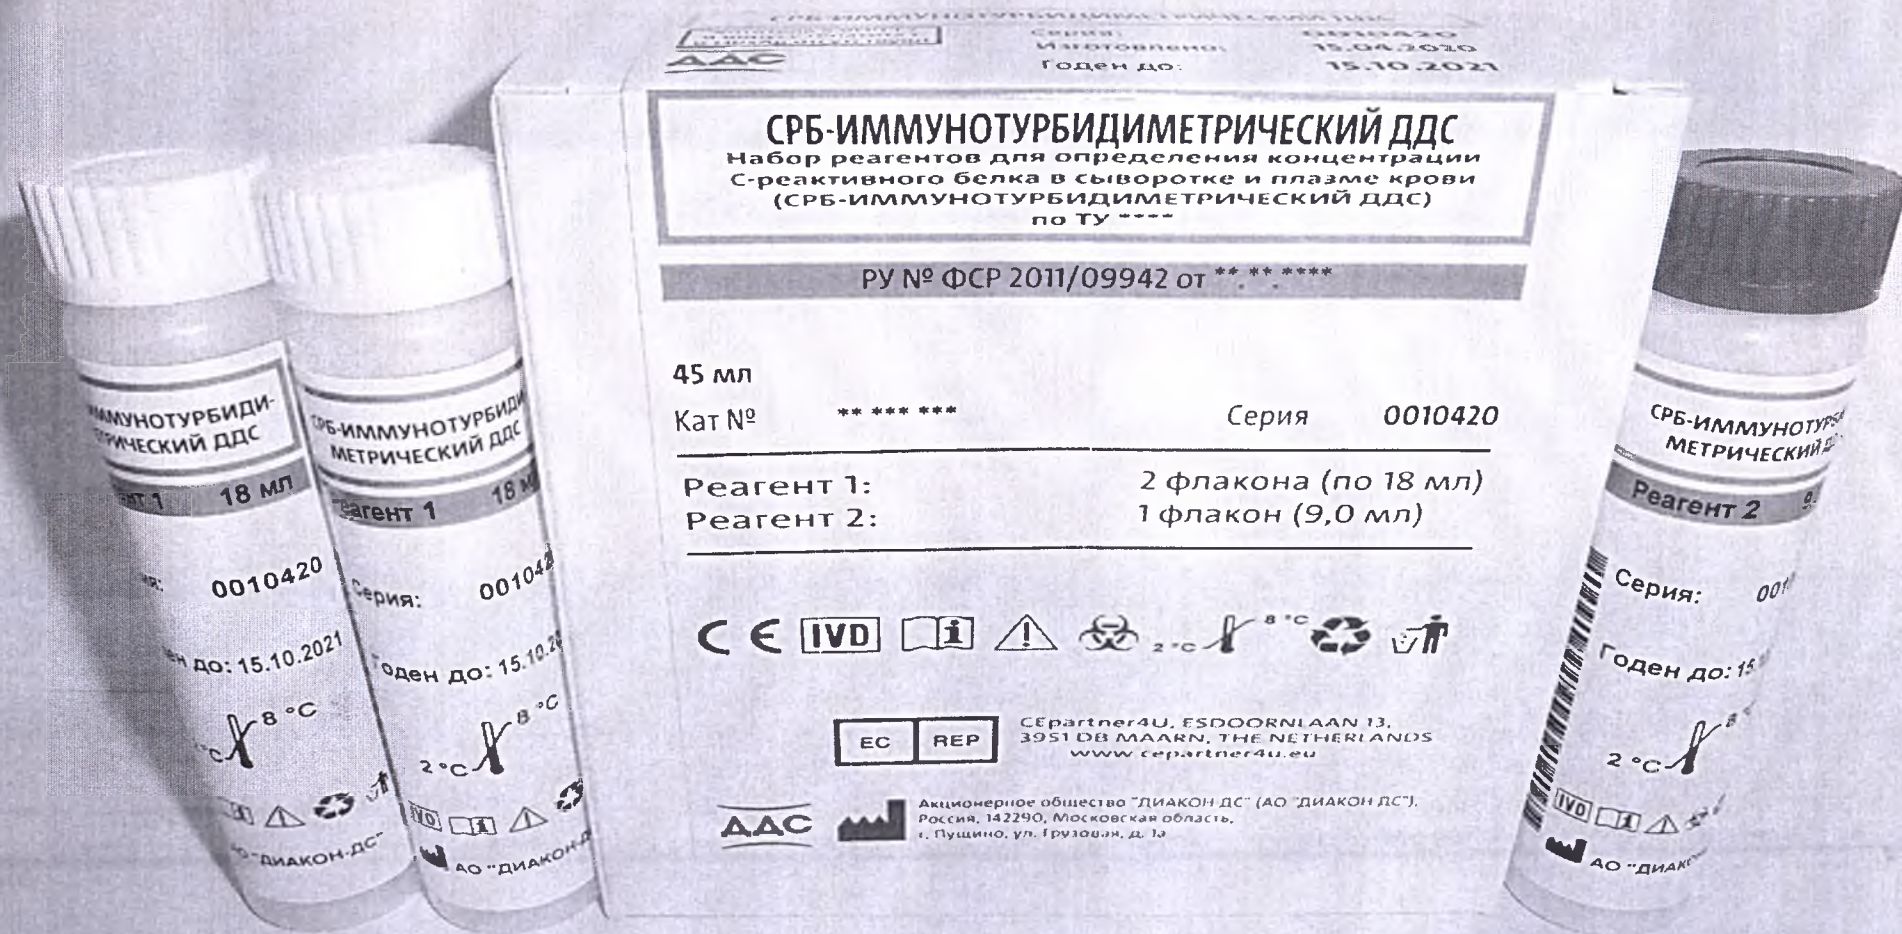


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

2, Комплектация 5

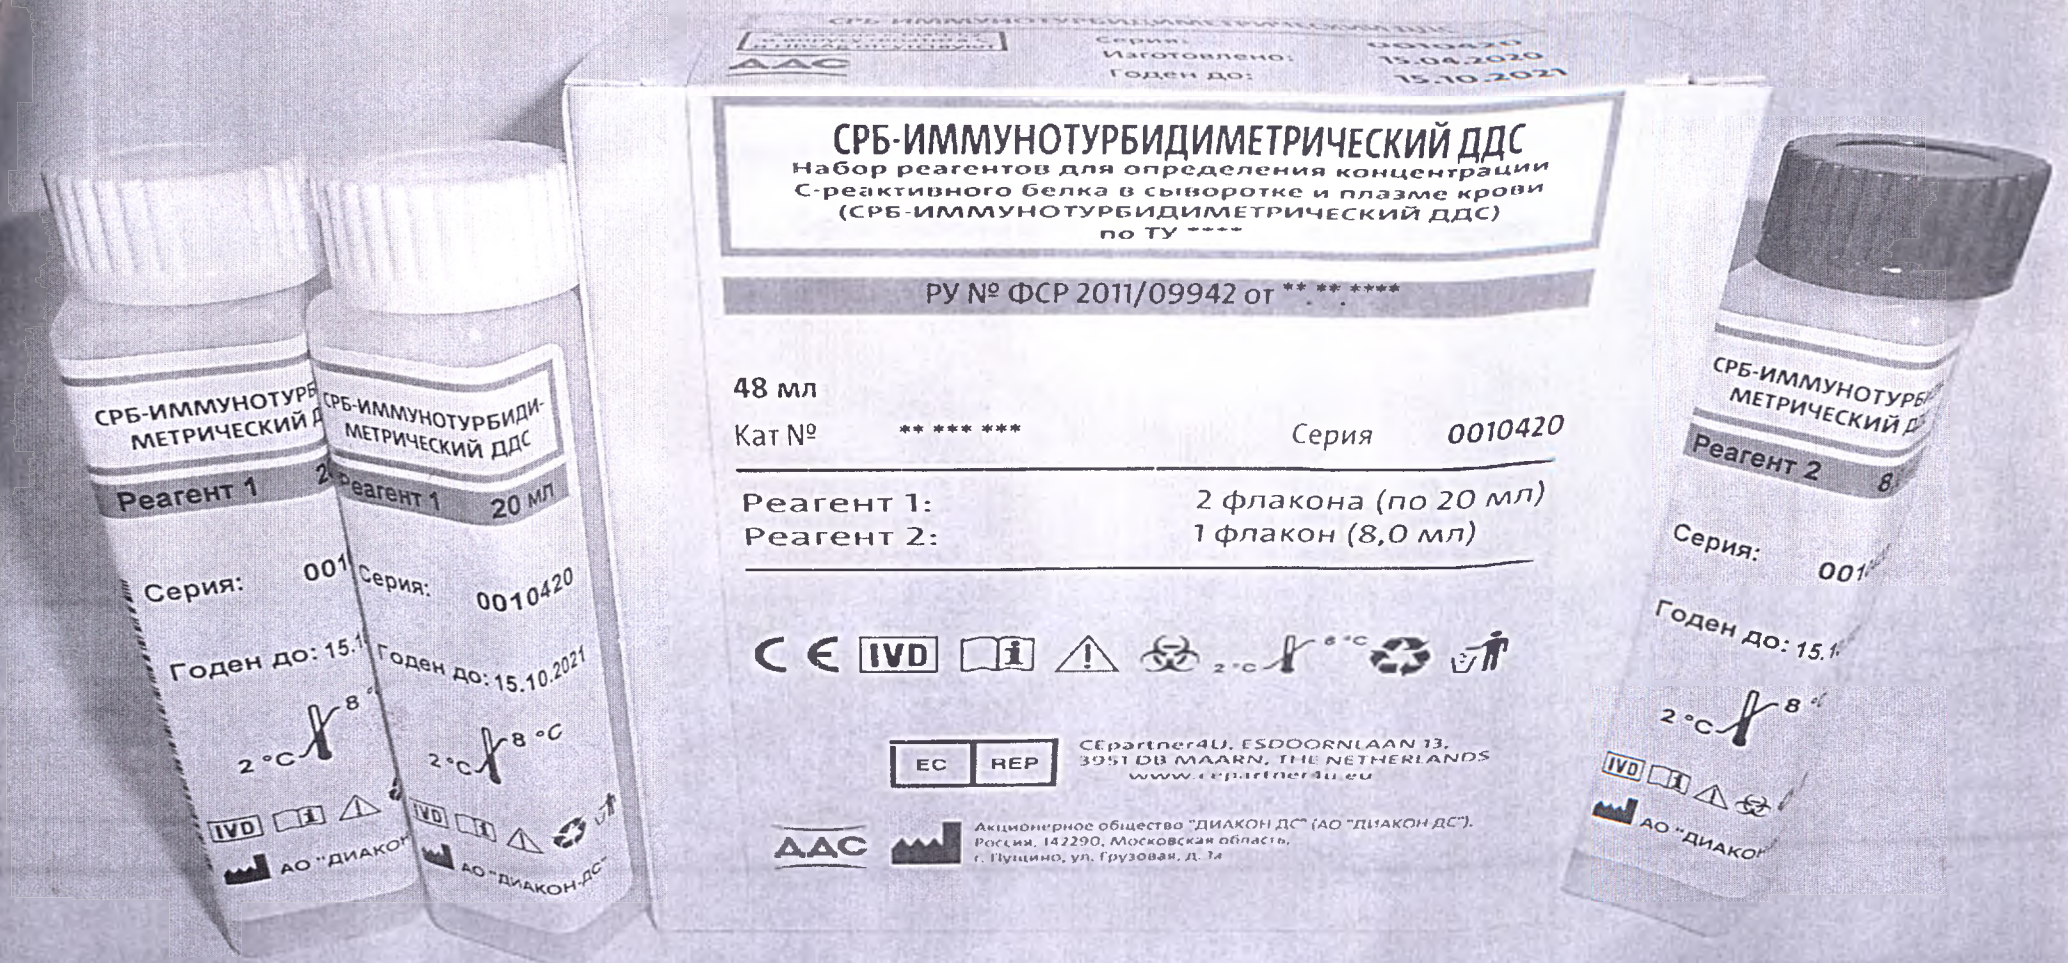

Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)


2. Комплектация 6

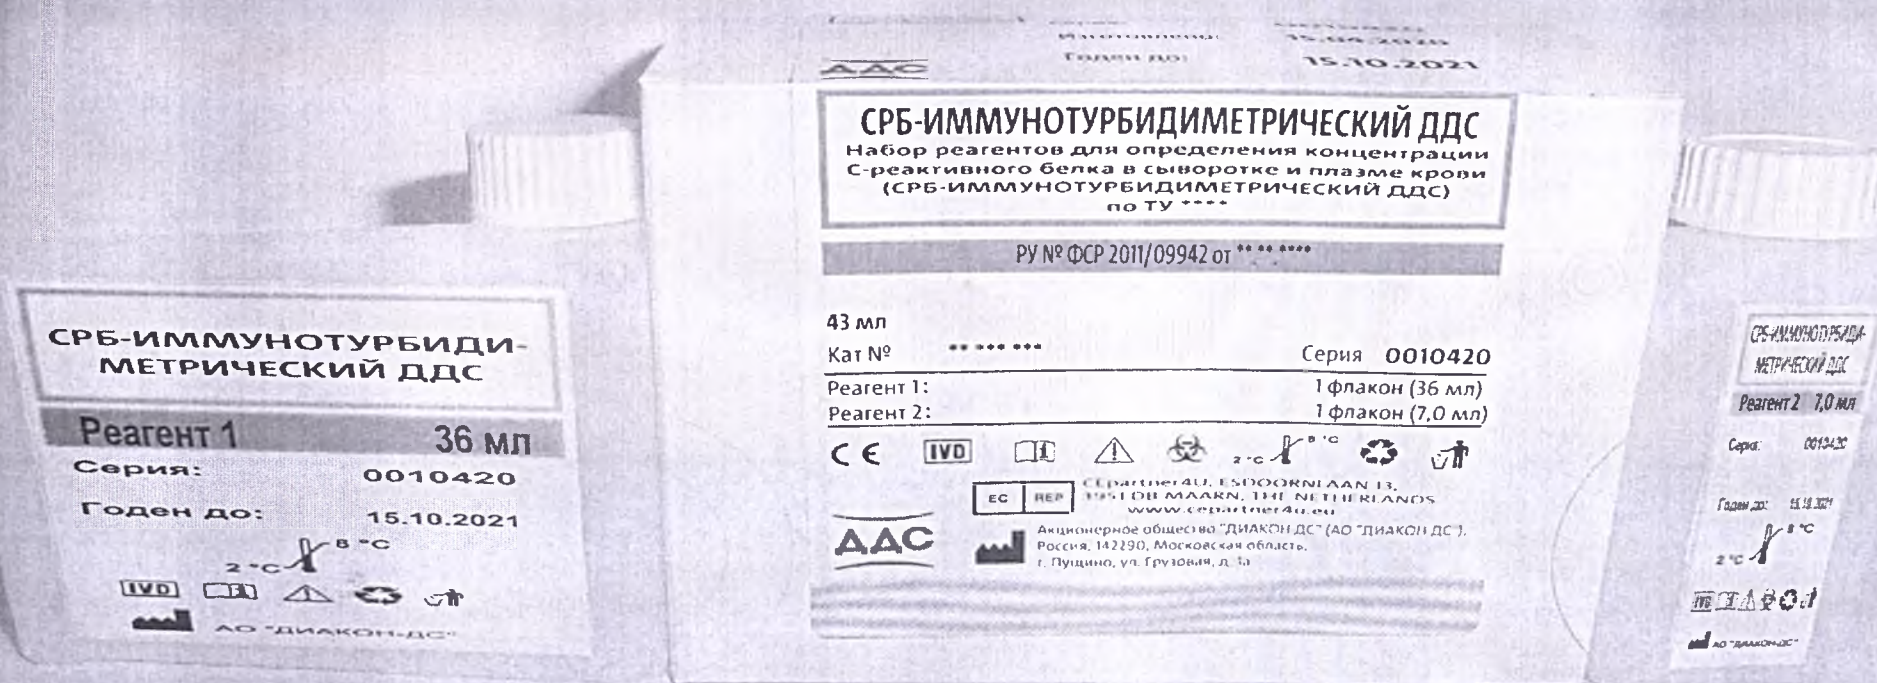

Внешний вид




Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови (СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

п. 2, Комплектация 7

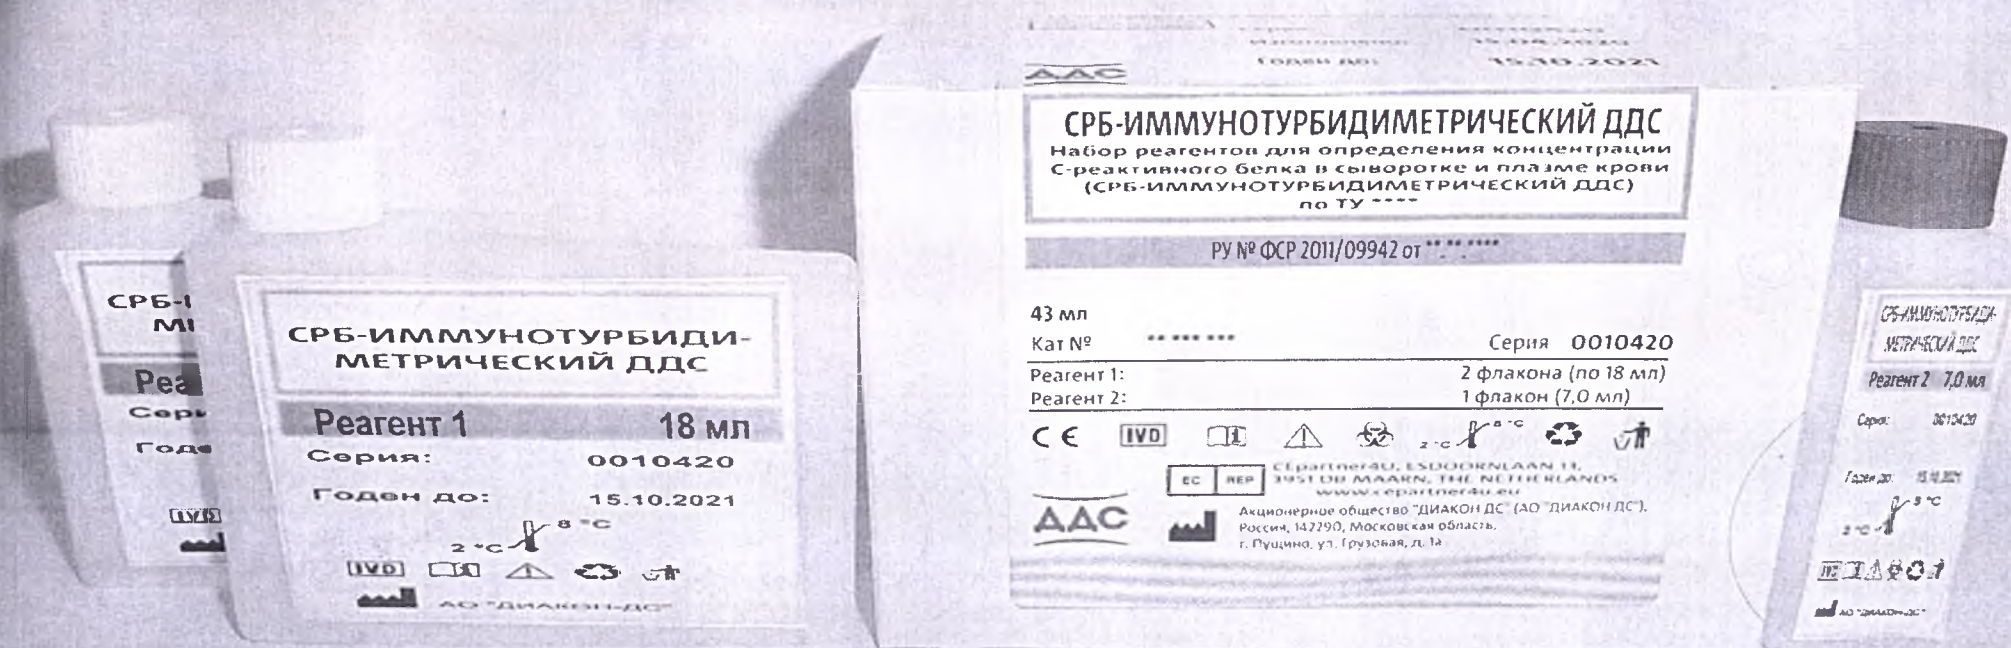


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

2, Комплектация 8

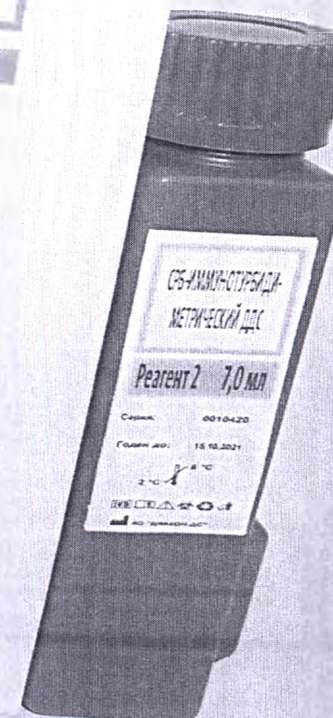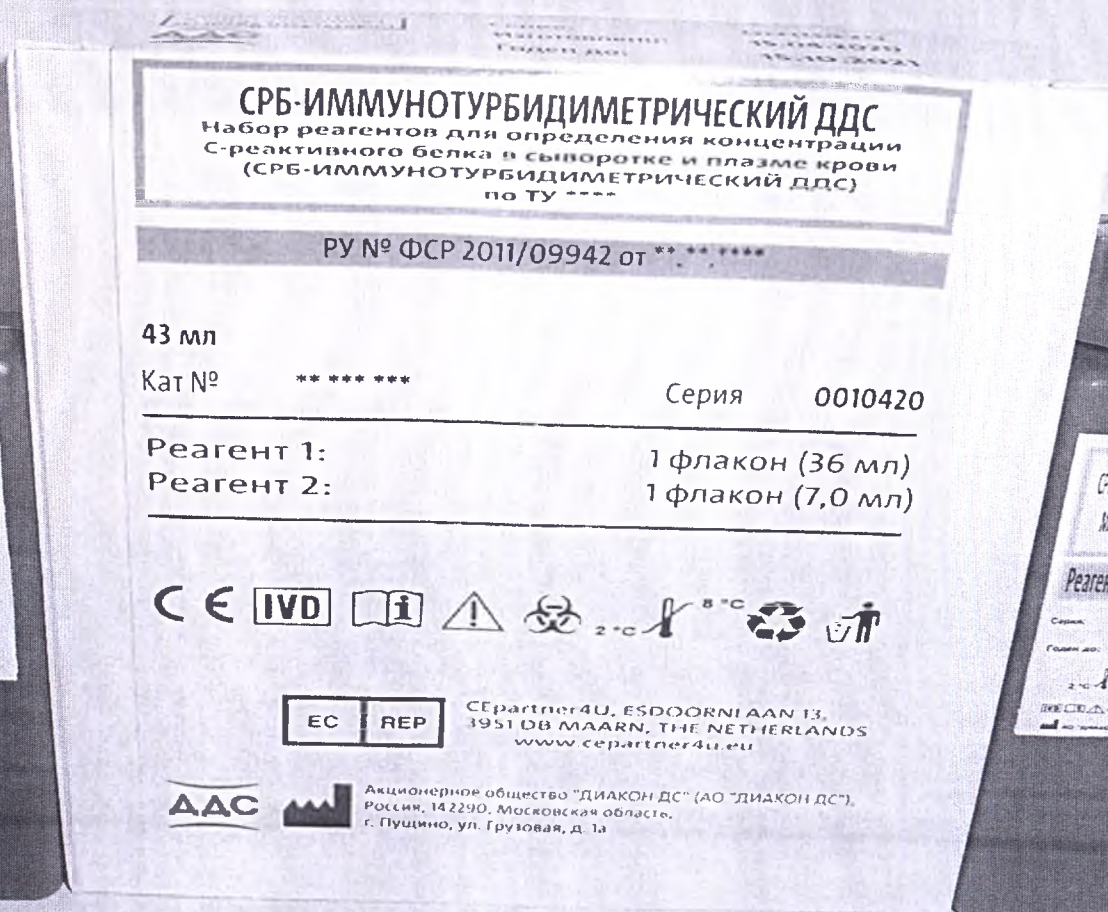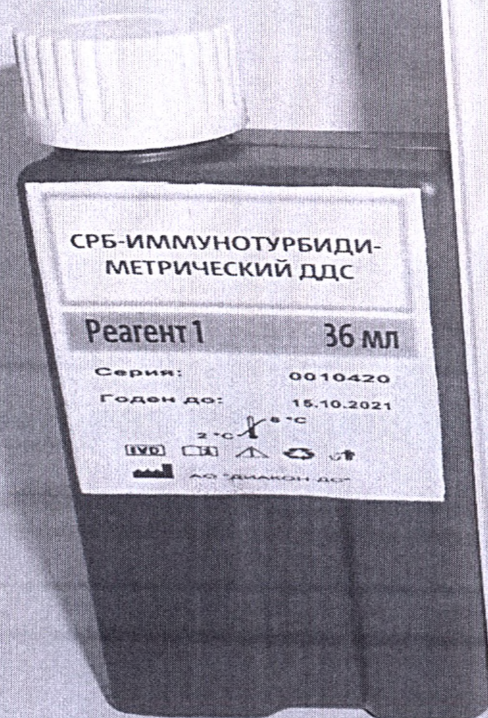


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

2, Комплектация 9

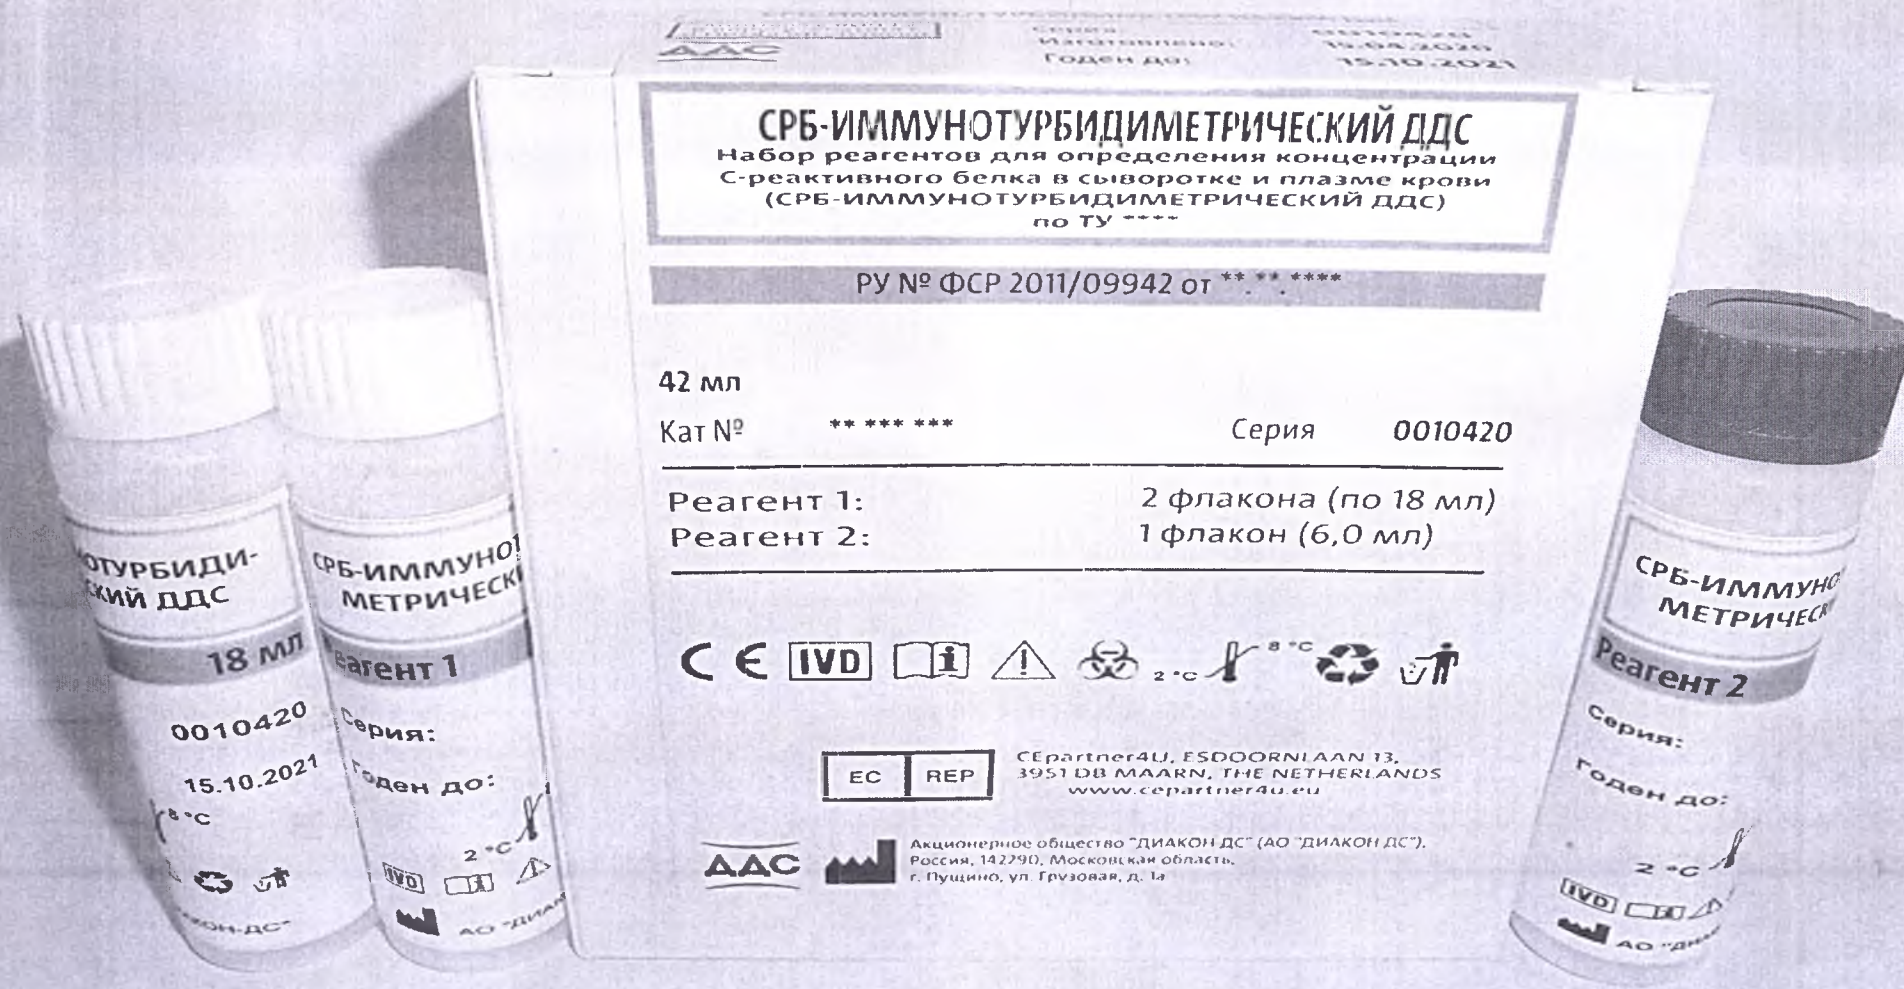


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

2, Комплектация 10

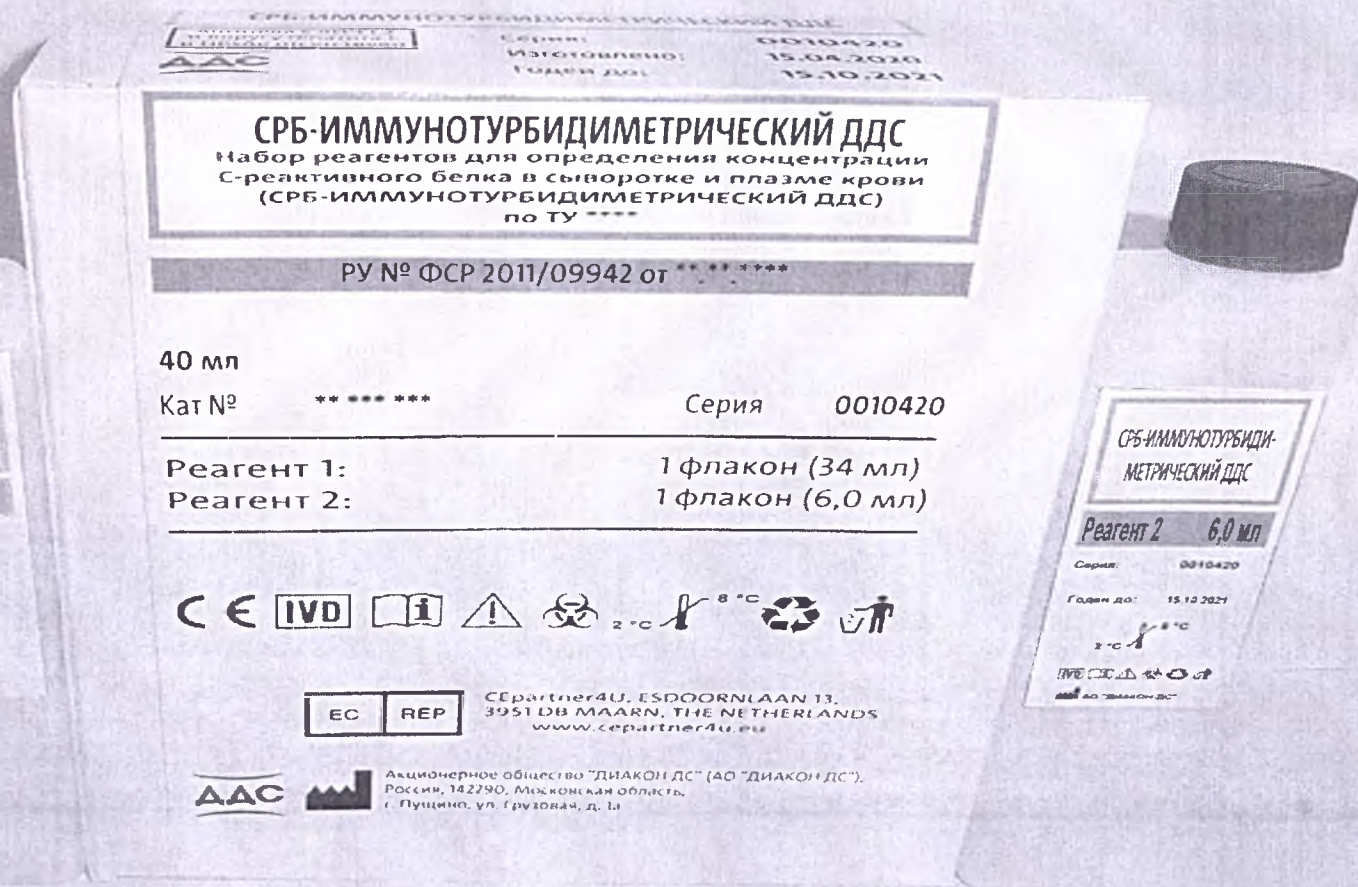


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

2, Комплектация 11

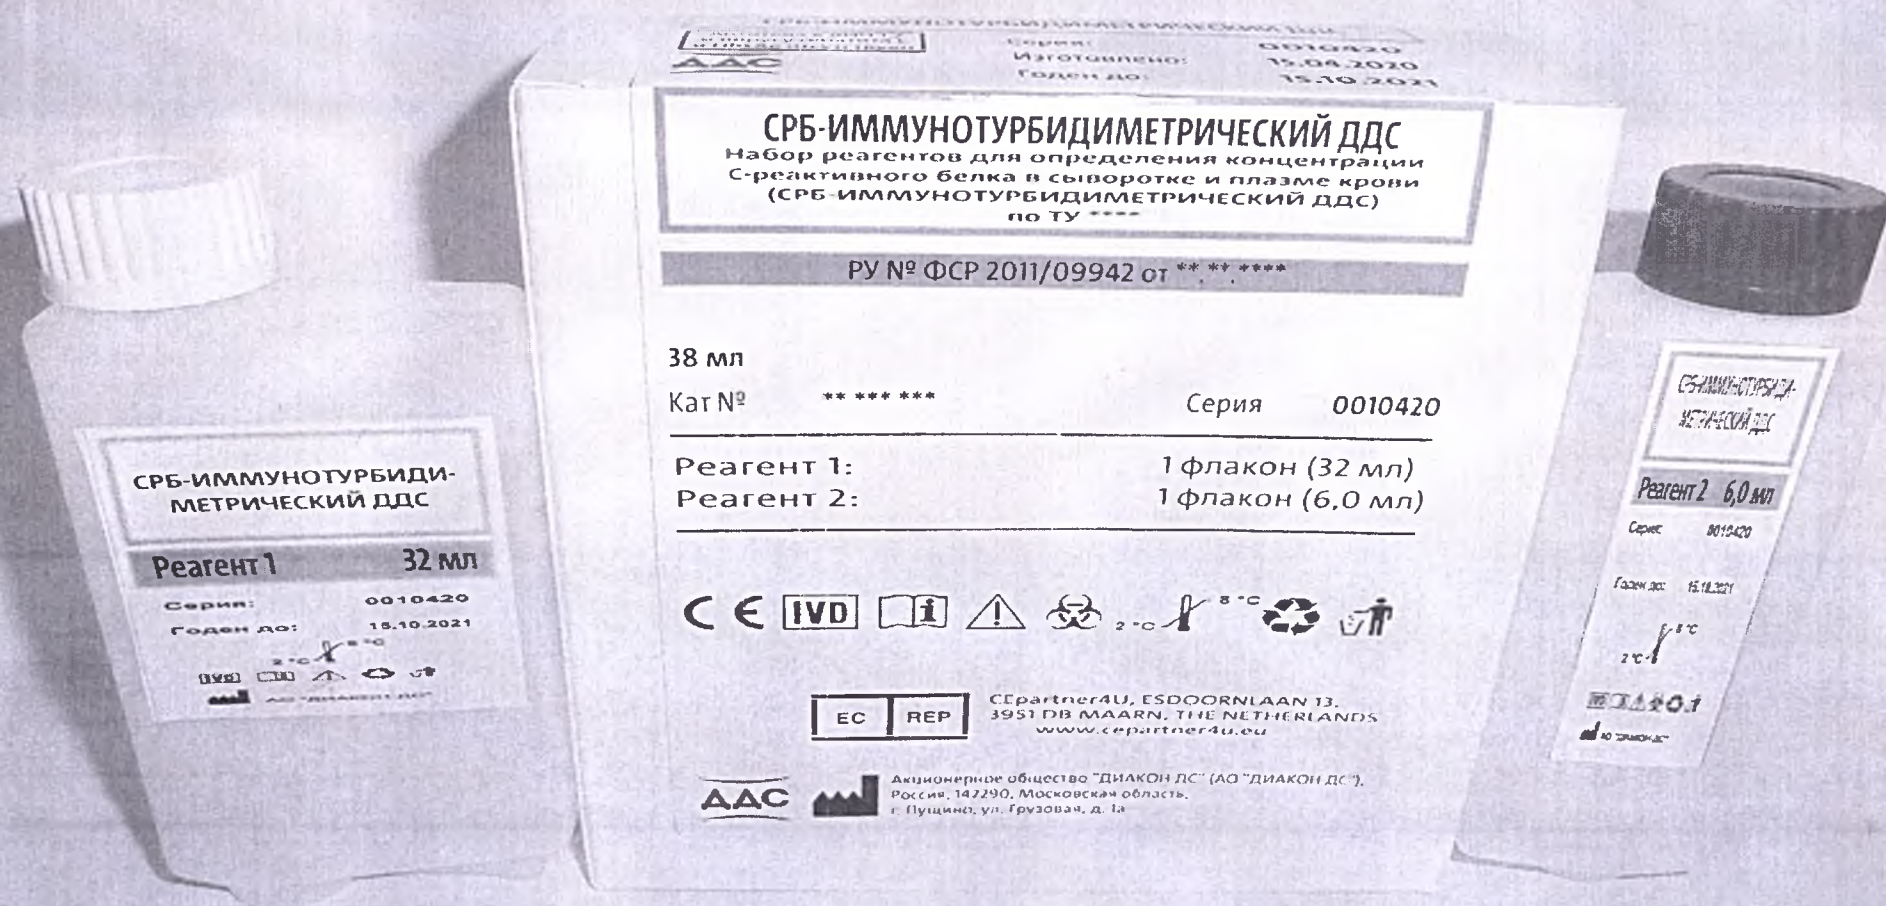

Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

ИНТ 2, Комплектация 12

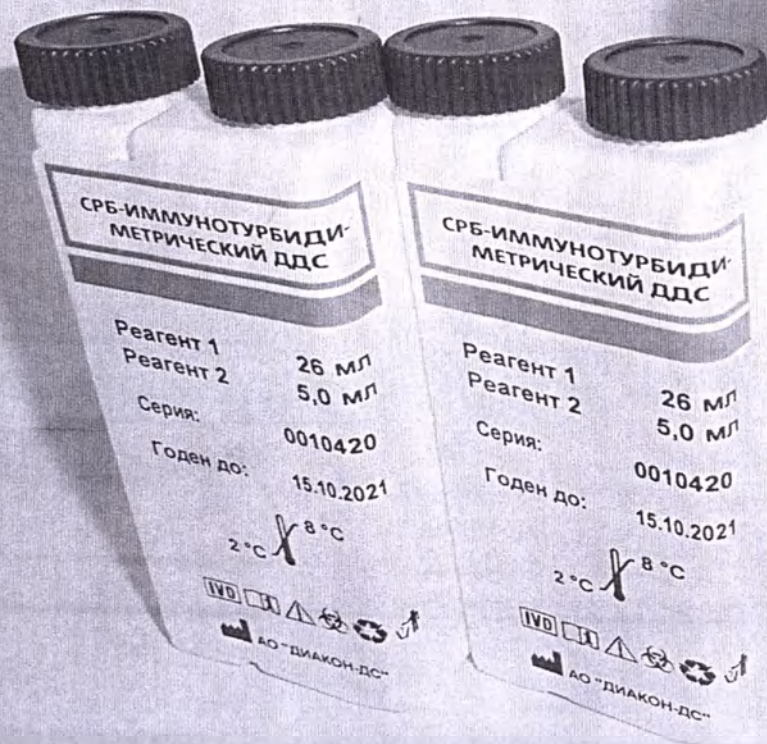

СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС
 Серийный номер: 0010420
 Дата изготовления: 15.06.2020
 Срок годности: 15.10.2021

СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС
 Набор реагентов для определения концентрации
 С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
 (СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
 по ТУ ****



РУ № ФСР 2011/09942 от ** ** *

62 мл

Кат № *****

Серия 0010420

Реагент 1: 2 флакона (по 26 мл)
 Реагент 2: 2 флакона (по 5,0 мл)





Ceartner4U, ESDOORNLAAN 13,
 3951 DB MAAARN, THE NETHERLANDS
www.ceartner4u.eu

AAC



Акционерное общество "ДИАКОН ДС" (АО "ДИАКОН ДС").
 Россия, 142290, Московская область,
 г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а


Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови (СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

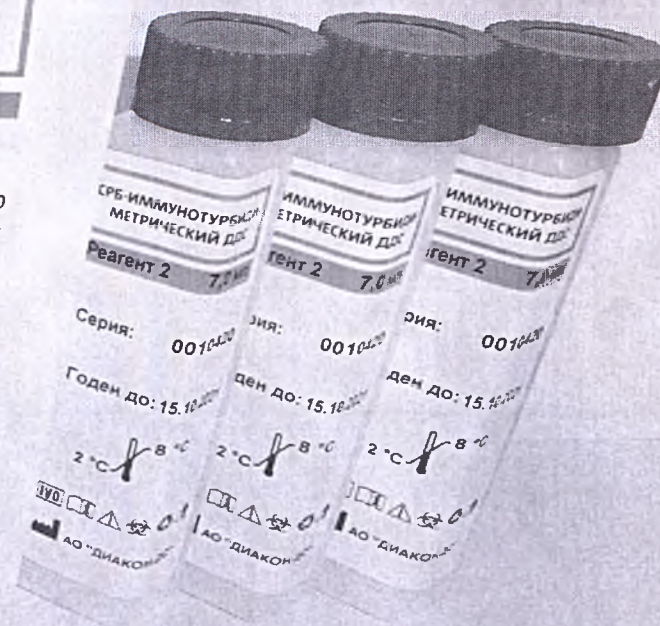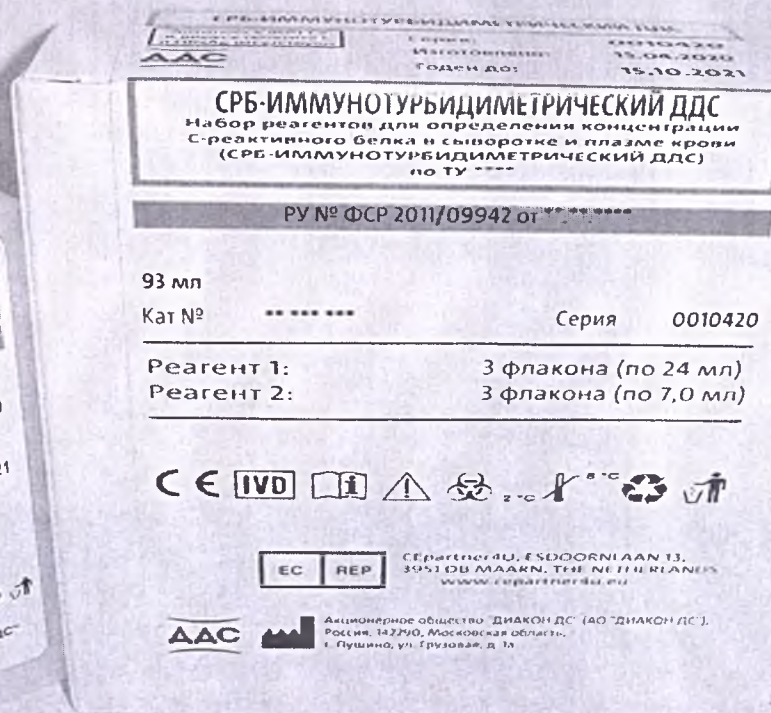

Внешний вид


Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови (СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

Эксперт 2, Комплектация 13

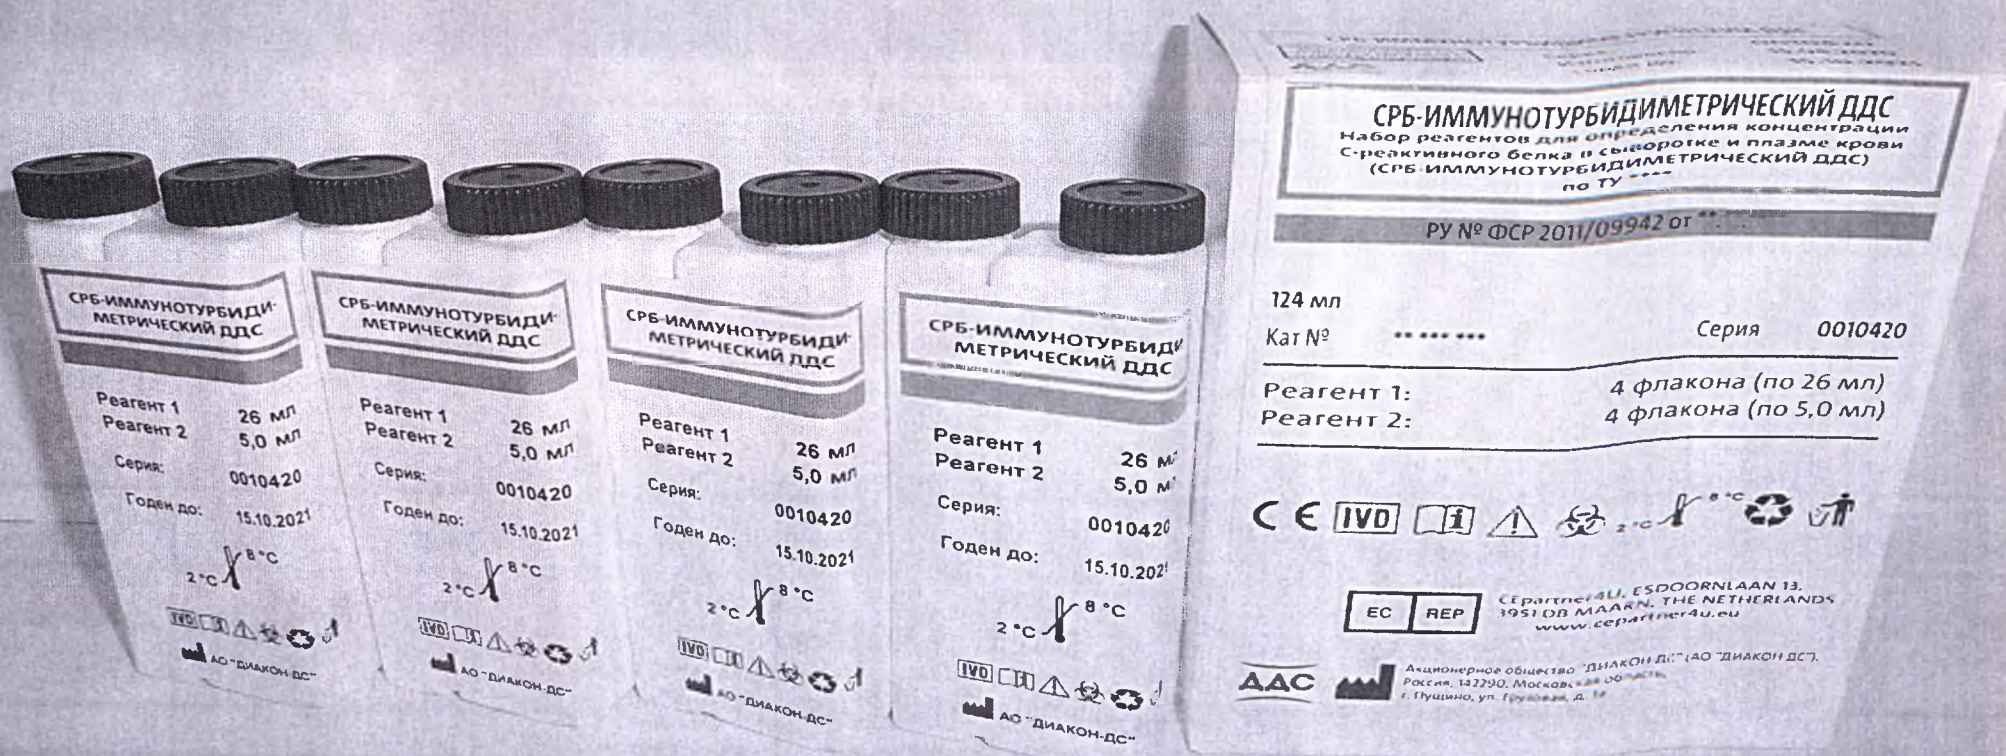


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

Лист 2, Комплектация 15

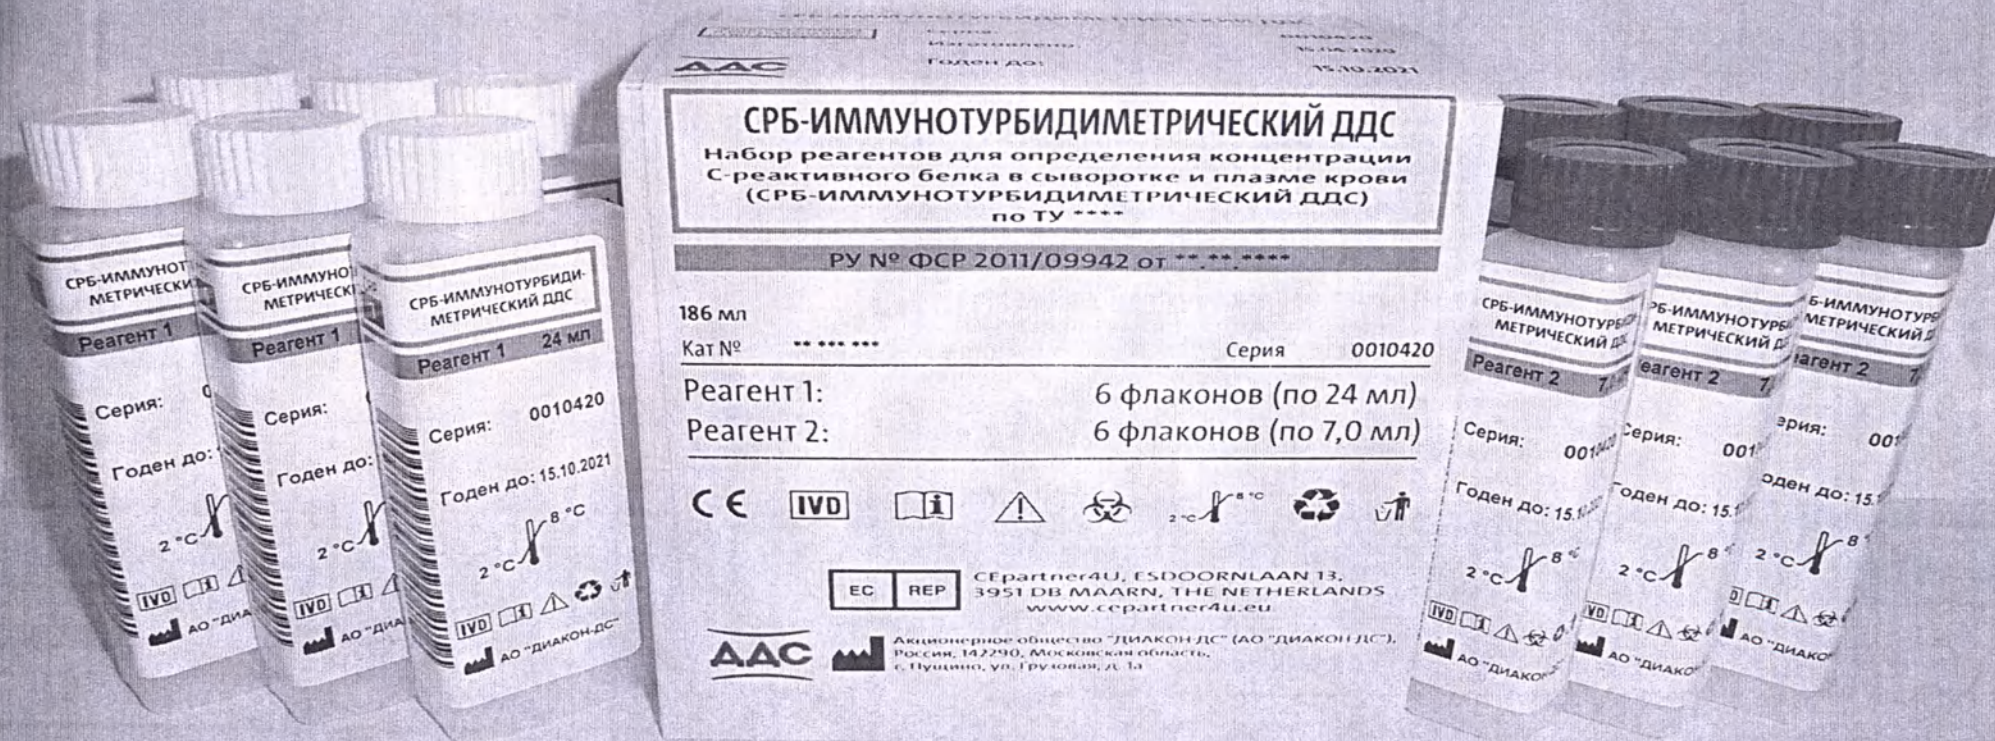


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

Лист 2, Комплектация 16

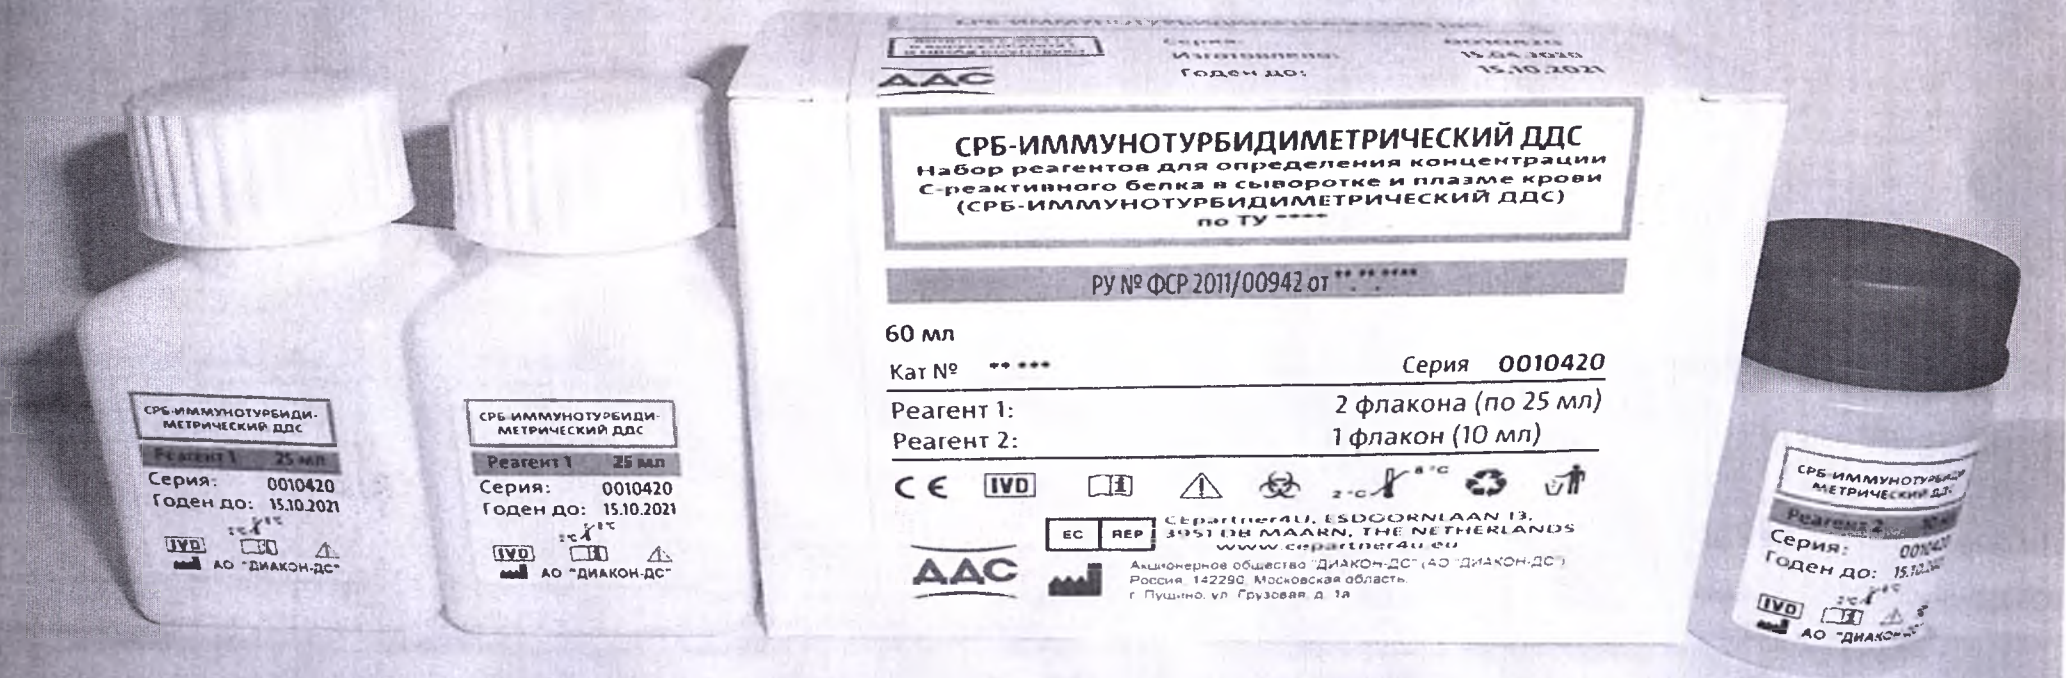


Лит 2, Комплектация 17




Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

Вариант 3, Комплектация 1

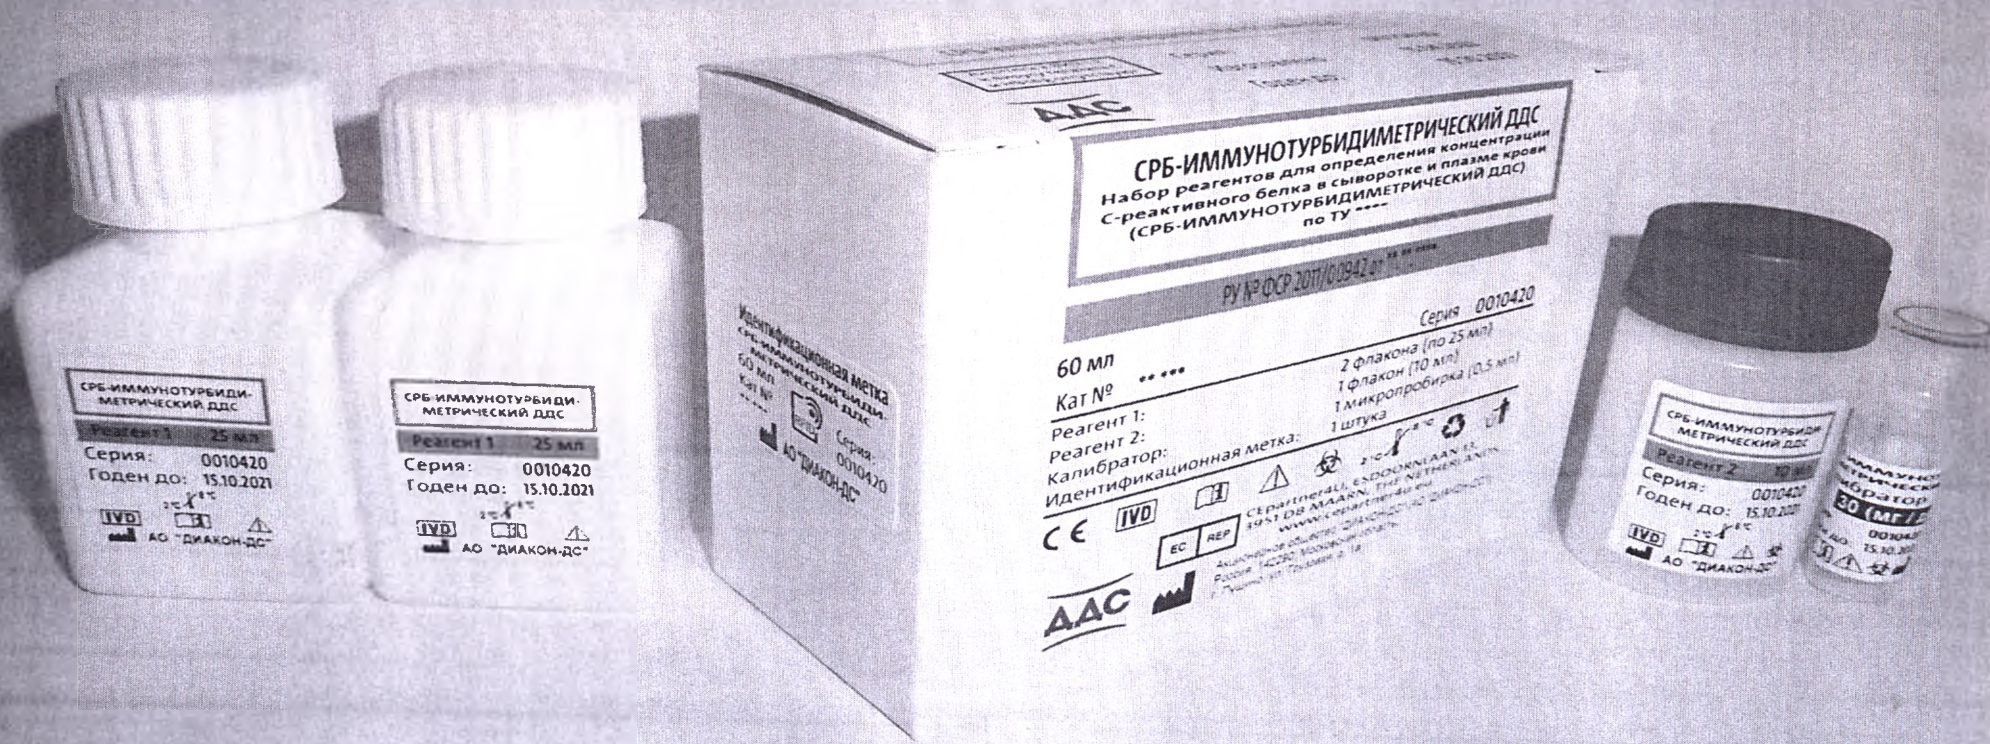

Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови
(СРБ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

Вариант 4, Комплектация 1

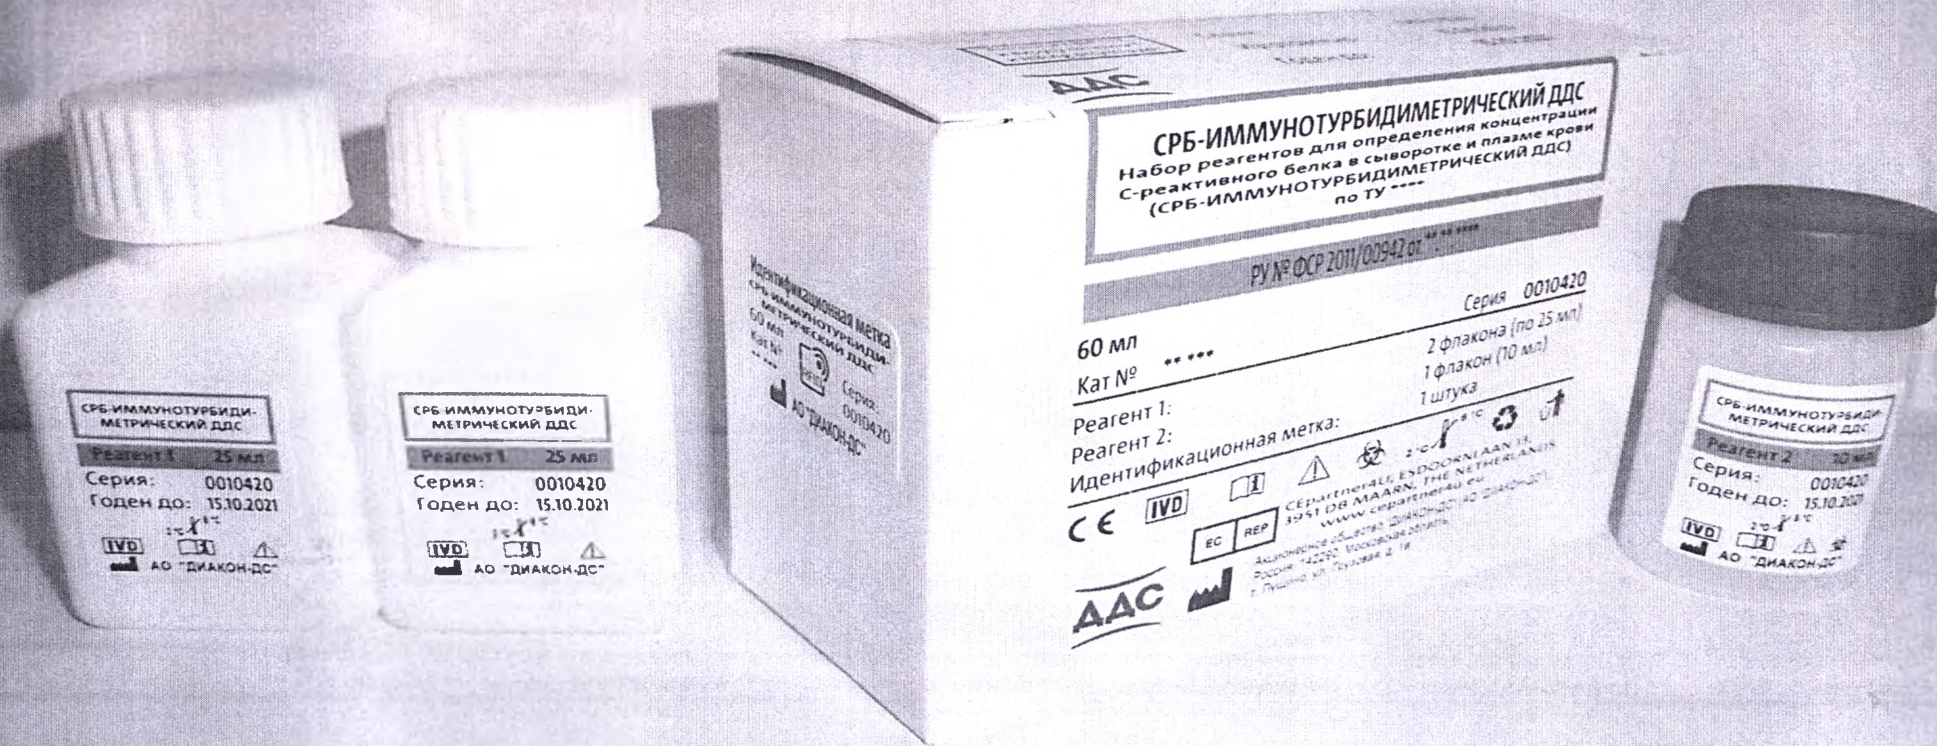



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 27

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»

Т.Ю. Корзун