

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы по регистрации
продукции для in vitro диагностики,
биохимия и портативные системы в
диагностике, ООО «Сименс
Здравоохранение»


Тышкунова Е.С.
22.05.2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Набор контрольных материалов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических
серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin Quality Control (Atellica IM BRAHMS PCT QC))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

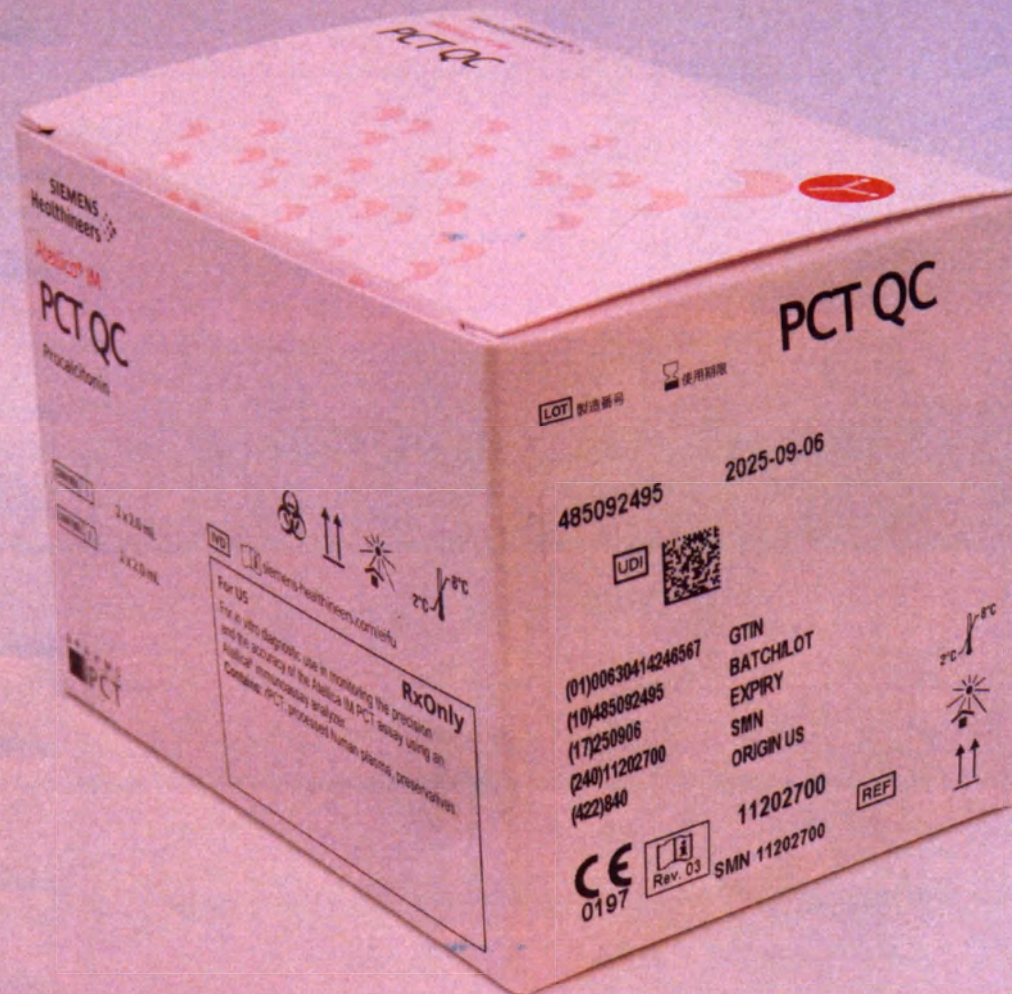


SIEMENS
Healthineers


Atellica® IM


PCT QC





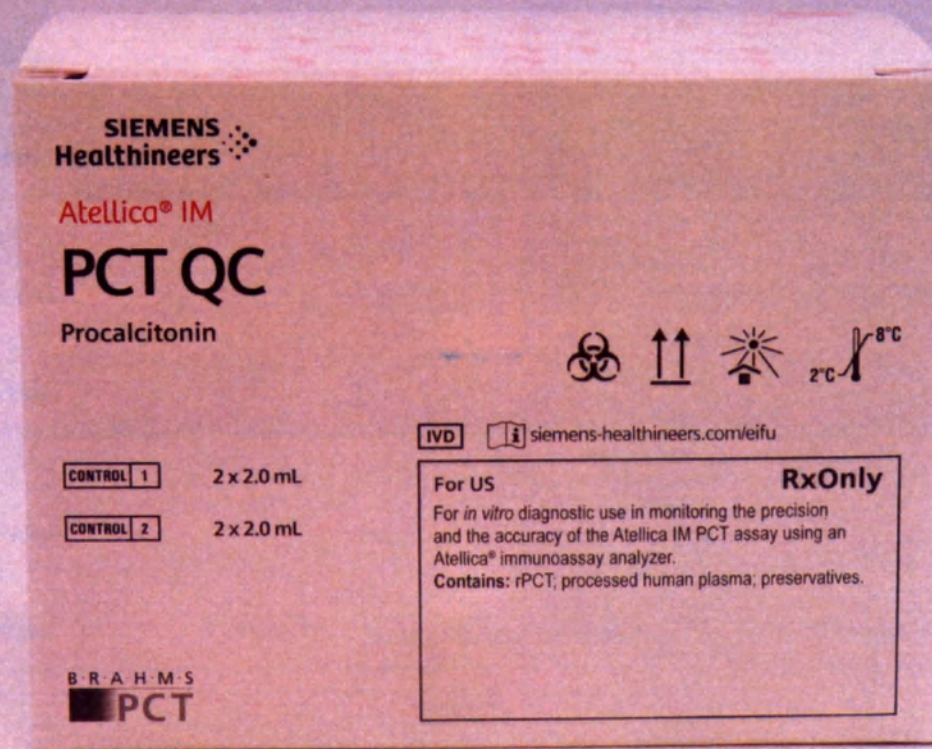

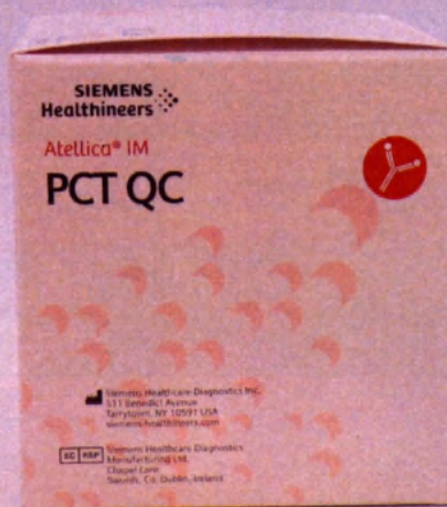

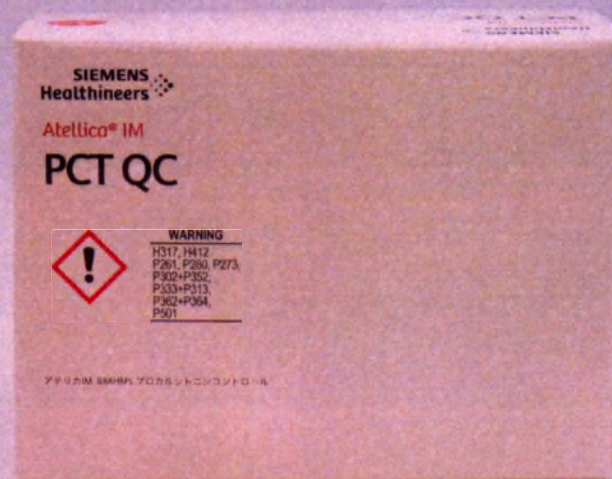

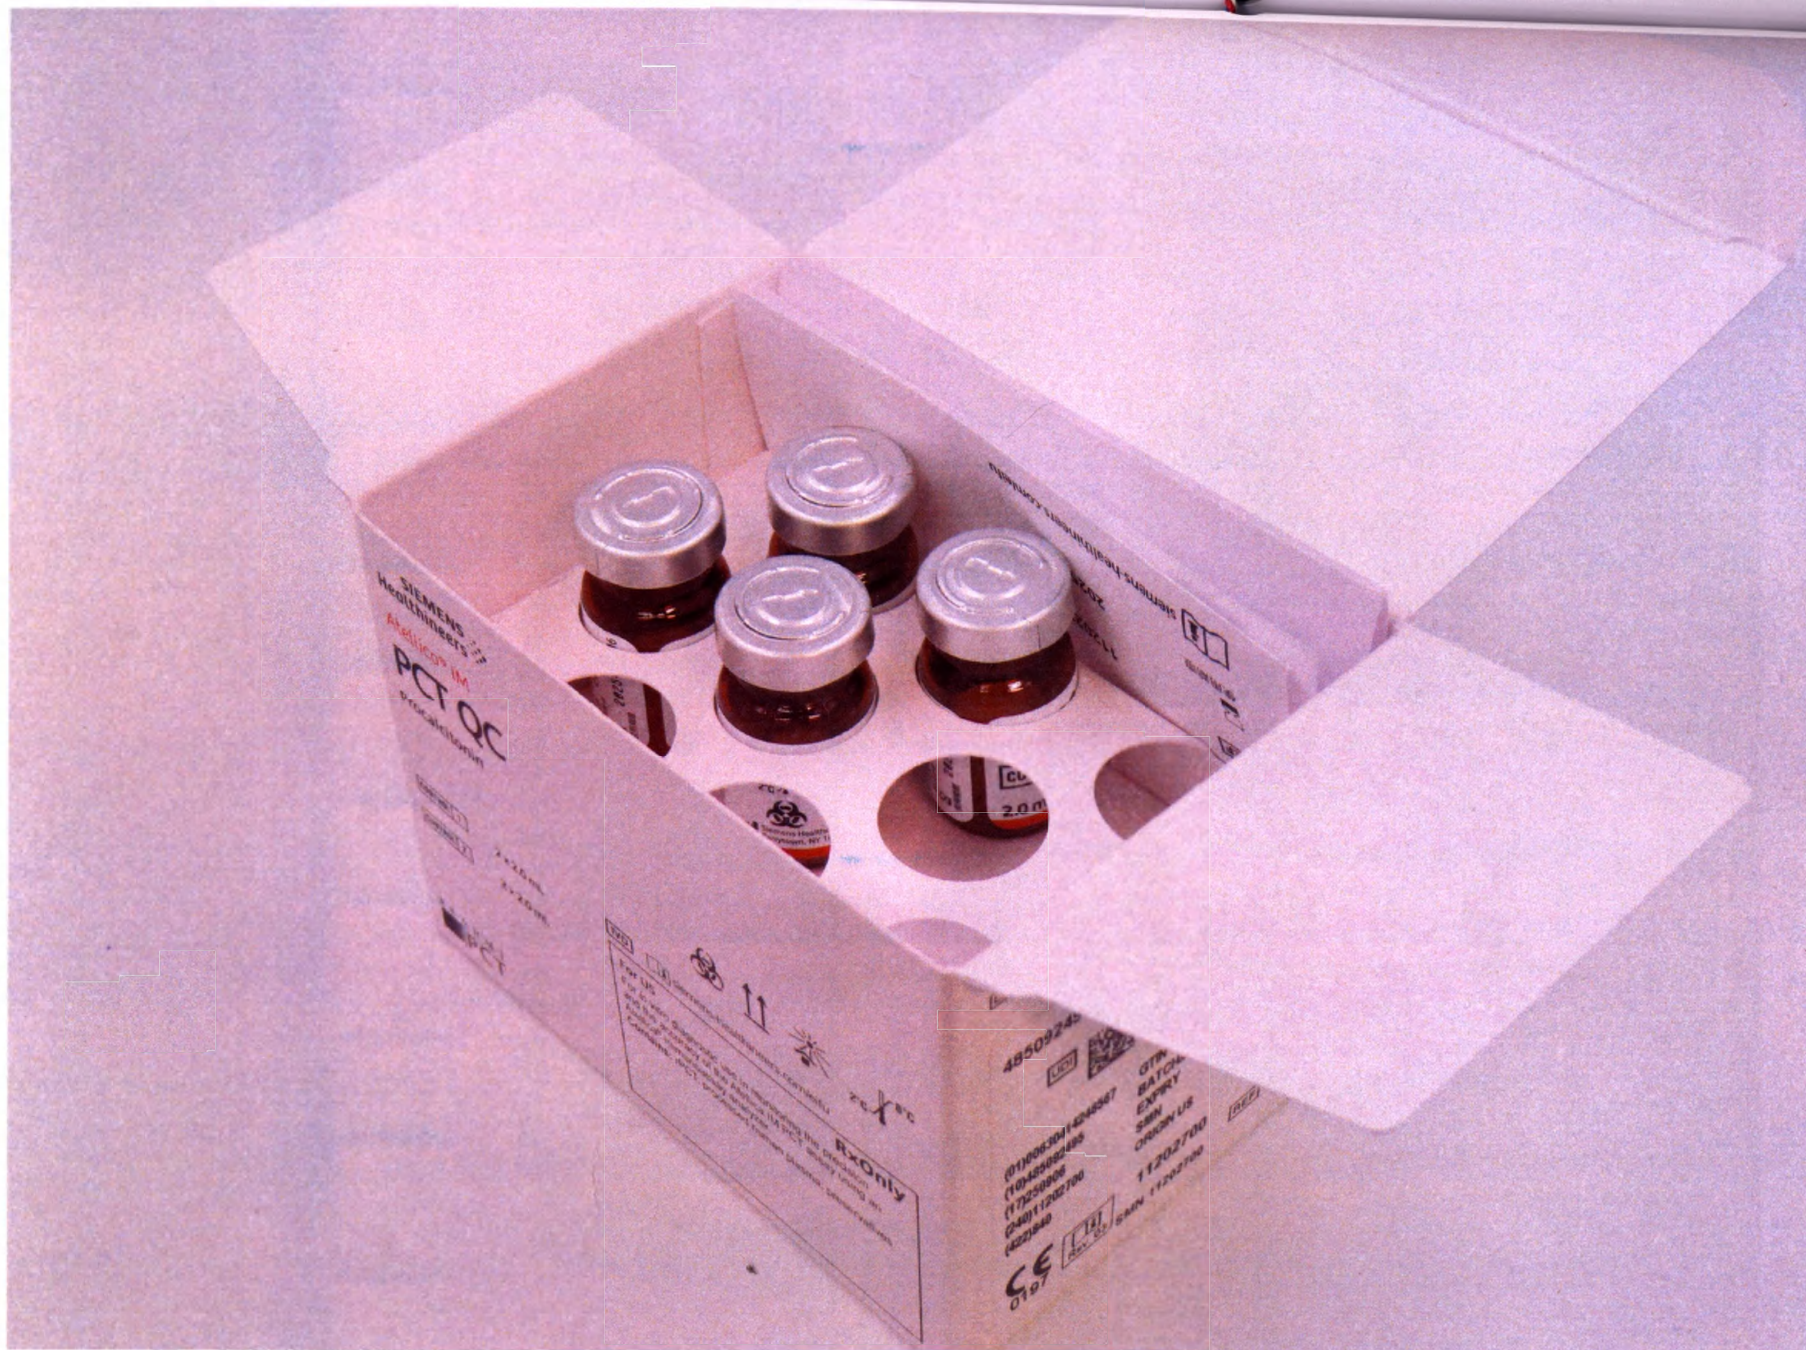


Рисунок 7. Набор контрольных материалов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin Quality Control (Atellica IM BRAHMS PCT QC). Общий вид



Рисунок 8. Набор контрольных материалов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin Quality Control (Atellica IM BRAHMS PCT QC). 1. Контрольный материал 1-го уровня Atellica IM PCT QC CONTROL 1; 2,0 мл - 2 флакона.



Рисунок 9. Набор контрольных материалов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin Quality Control 2, 2.0 mL - 2 флакона).

SIEMENS
Healthineers
Atellica® IM
QC

PCT

CONTROL	LOT	VAL
---------	-----	-----

REF	11202700
-----	----------

EXP	2021-12-27
-----	------------

LOT	11202700
-----	----------

UNITS	C
-------	---

	LOT	ng/mL	ng/mL
CONTROL 1	2936111	0.491	0.147
CONTROL 2	2936112	11.3	3.40

10997642 Рак. 04

**11202700 Набор контрольных материалов для определения
прокальцитонина на анализаторах
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM
BRAHMS Procalcitonin Quality Control (Atellica IM
BRAHMS PCT QC))**

Информация о производителе и стране производства:

см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2022/16338 от 19.01.2022

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 02

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 11. Макет маркировки для Российской Федерации, который будет наноситься на внешнюю упаковку медицинского изделия «Набор контрольных материалов для определения прокальцитонина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM BRAHMS Procalcitonin Quality Control (Atellica IM BRAHMS PCT QC))»

Всего прошито и пронумеровано
18 лист (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

