



22

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Терумо Рус»
Кучинский Д.В.



«22» декабря 2023 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Оксигенатор мембранный CAPIOX® FX с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром», в вариантах исполнения, с принадлежностями, производства «Терумо Корпорейшн» (Япония) (Terumo Corporation, Japan).

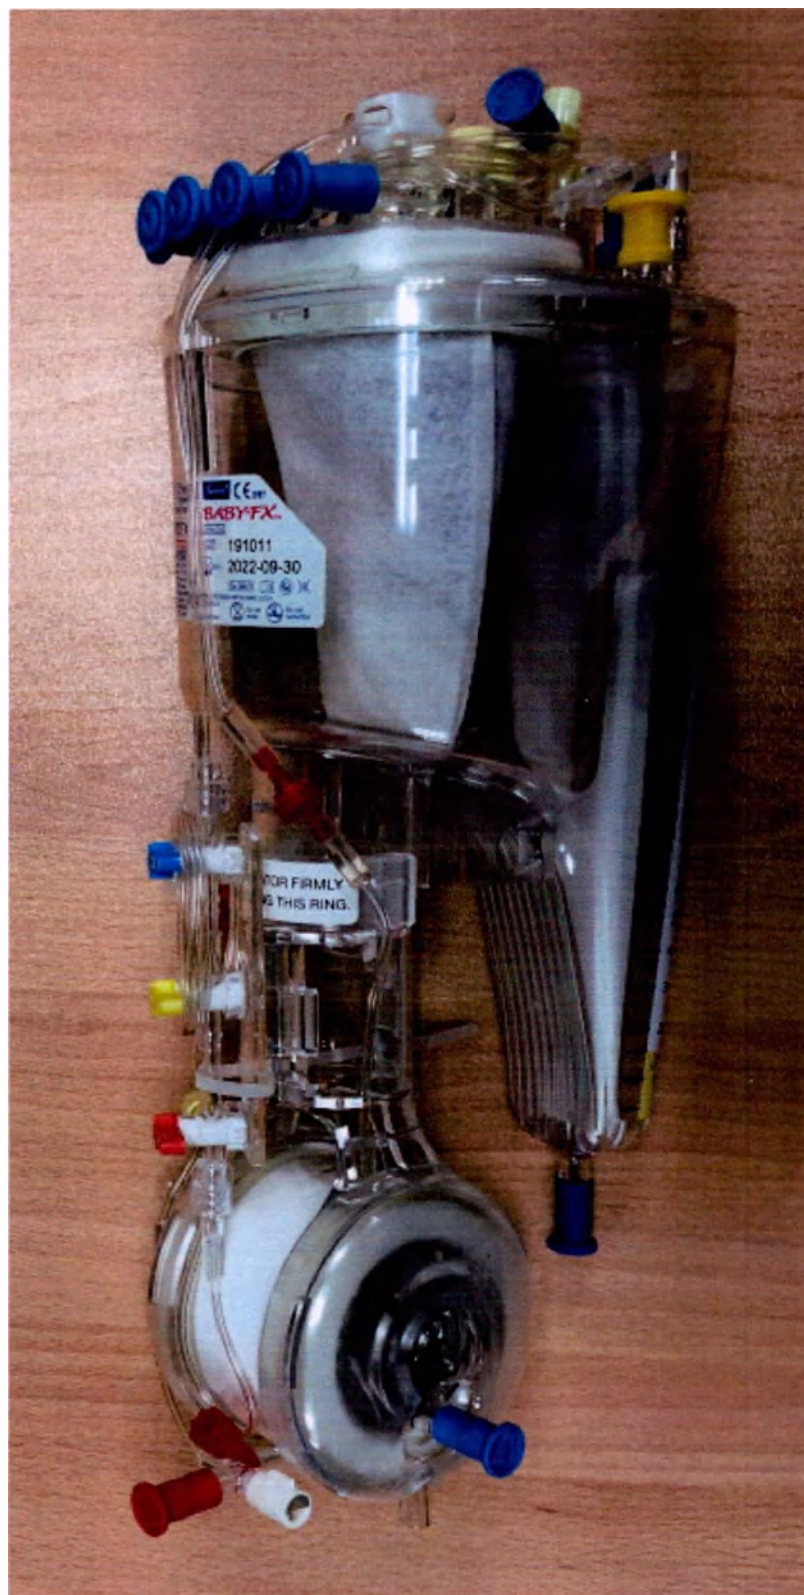


Рис. 1 - Оксигенатор мембранный CARIOX® FX05 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром. Вид спереди.



Рис. 2 - Оксигенатор мембранный CARIOX® FX05 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром. Вид сзади.

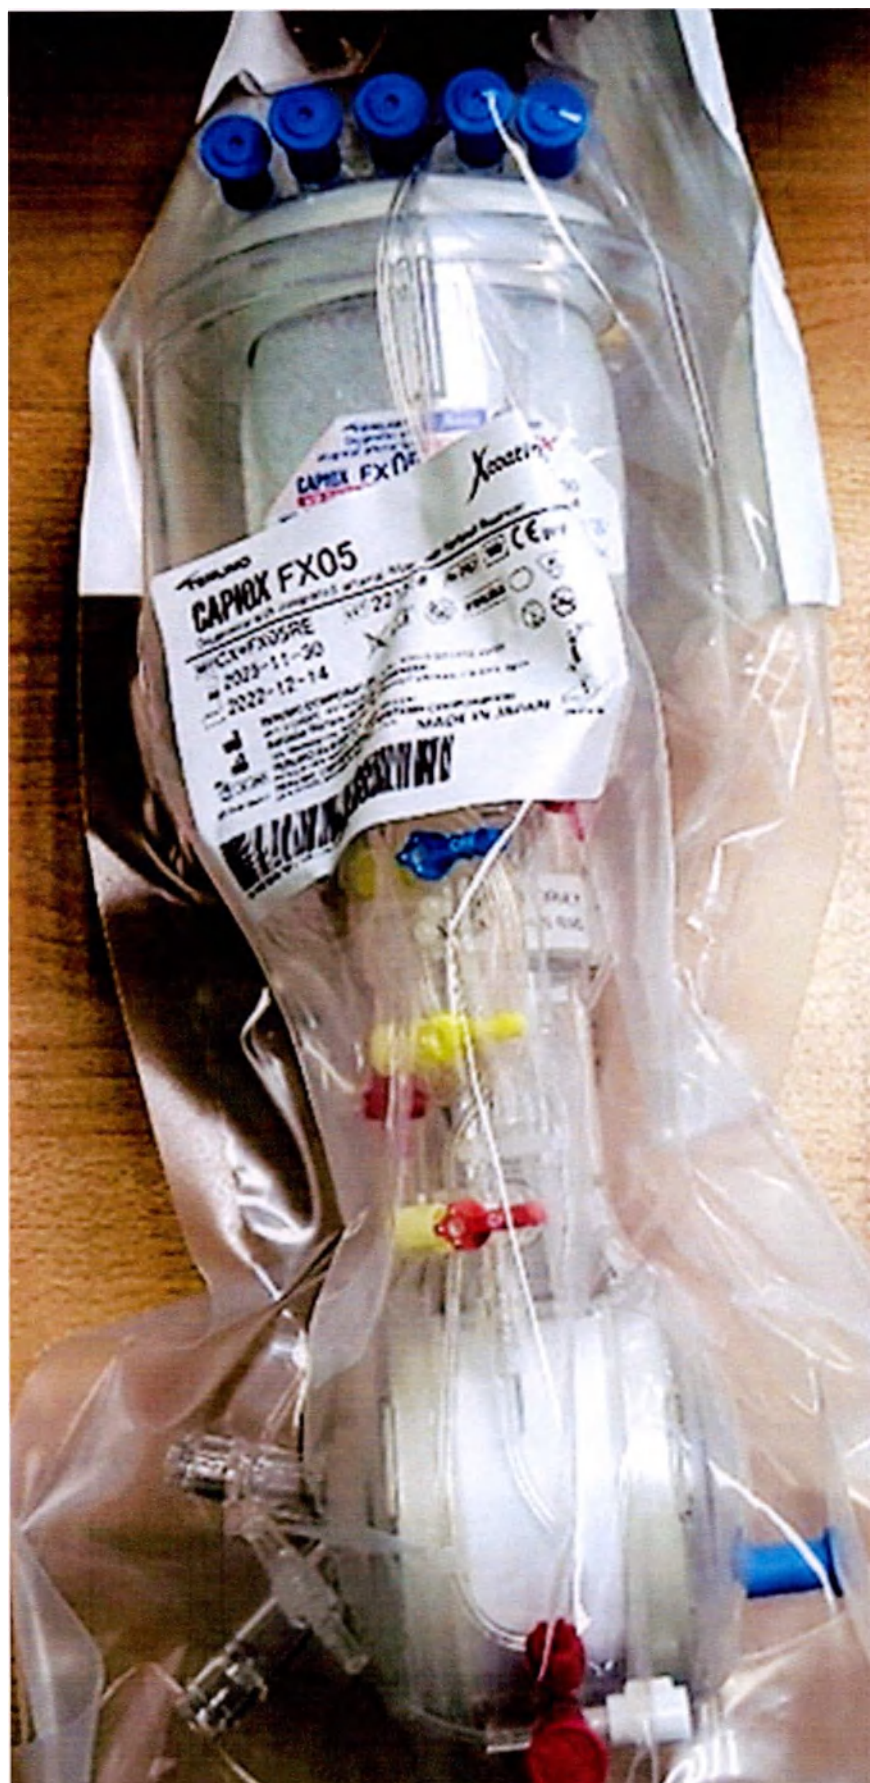


Рис. 3 - Оксигенатор мембранный CAPiox® FX05 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром в стерильной упаковке



Рис. 4 – маркировка на стерильной упаковке оксигенатора мембранного CAPIOX® FX05 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром



Рис. 5 – маркировка на корпусе оксигенатора мембранного CAPIOX® FX05 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром



Рис. 6 – Линия рециркуляции (1 шт.) с адаптерами порта (адаптер порта 3/8 дюйма – 1 шт. и адаптер порта 3/16 дюйма – 4 шт.) в стерильной упаковке к Оксигенатору мембранному CAPIOX® FX05



Рис. 7 – Отдельная коробка оксигенатора мембранного CAPIOX® FX05 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром – вид спереди

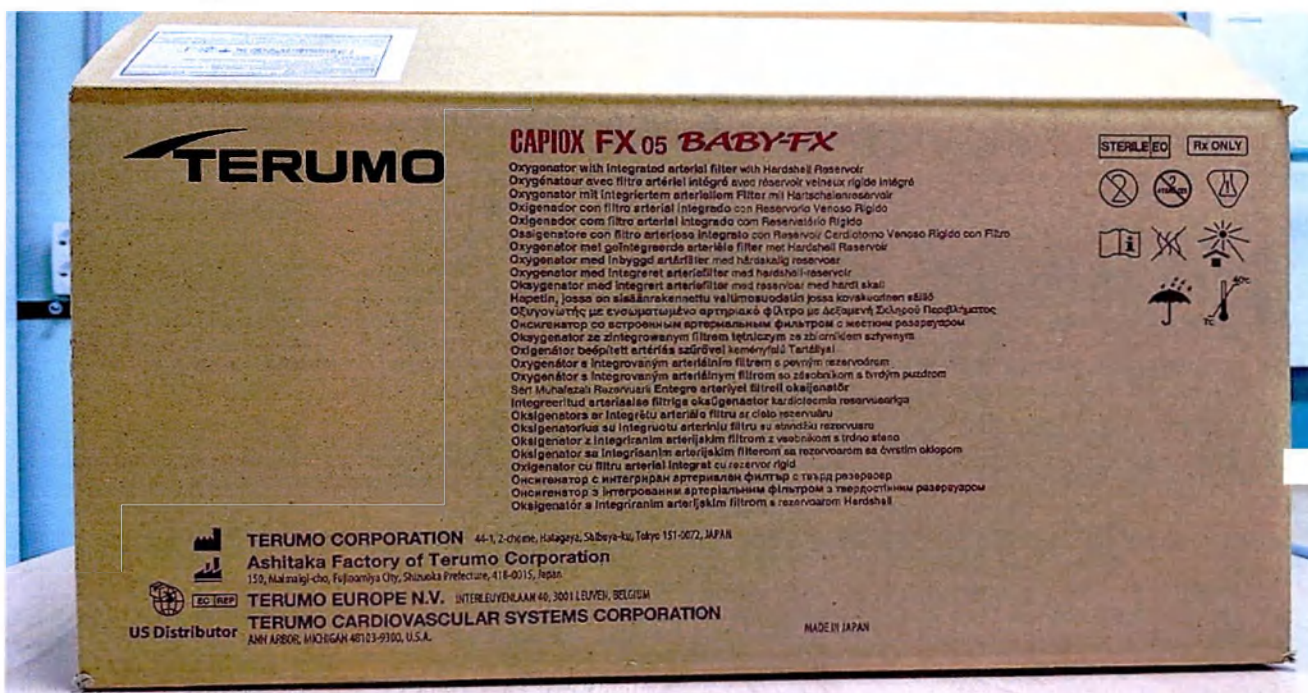


Рис. 8 – Отдельная коробка оксигенатора мембранного CAPIOX® FX05 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром – вид сзади



Рис. 9 - Оксигенатор мембранный CAPIOX® FX15 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром 3000 мл. Вид спереди.

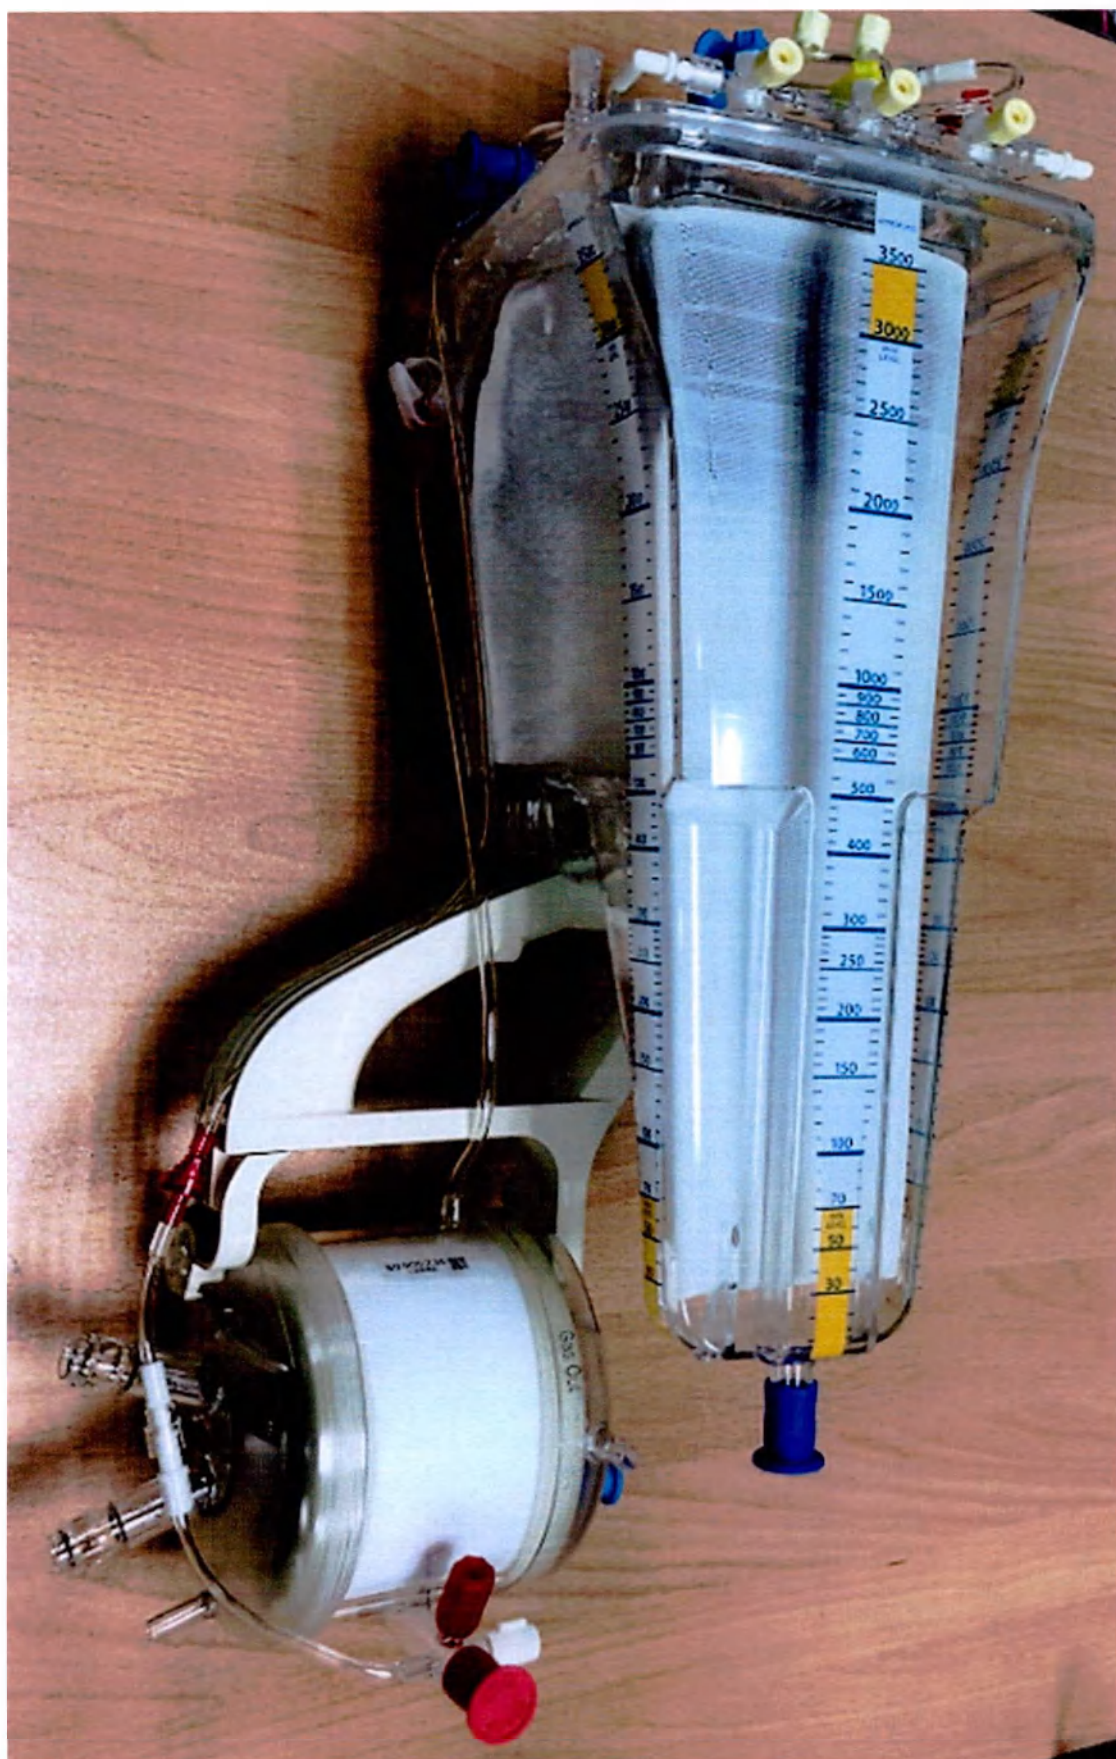


Рис. 10 - Оксигенатор мембранный CARIOX® FX15 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром 3000мл. Вид сзади.

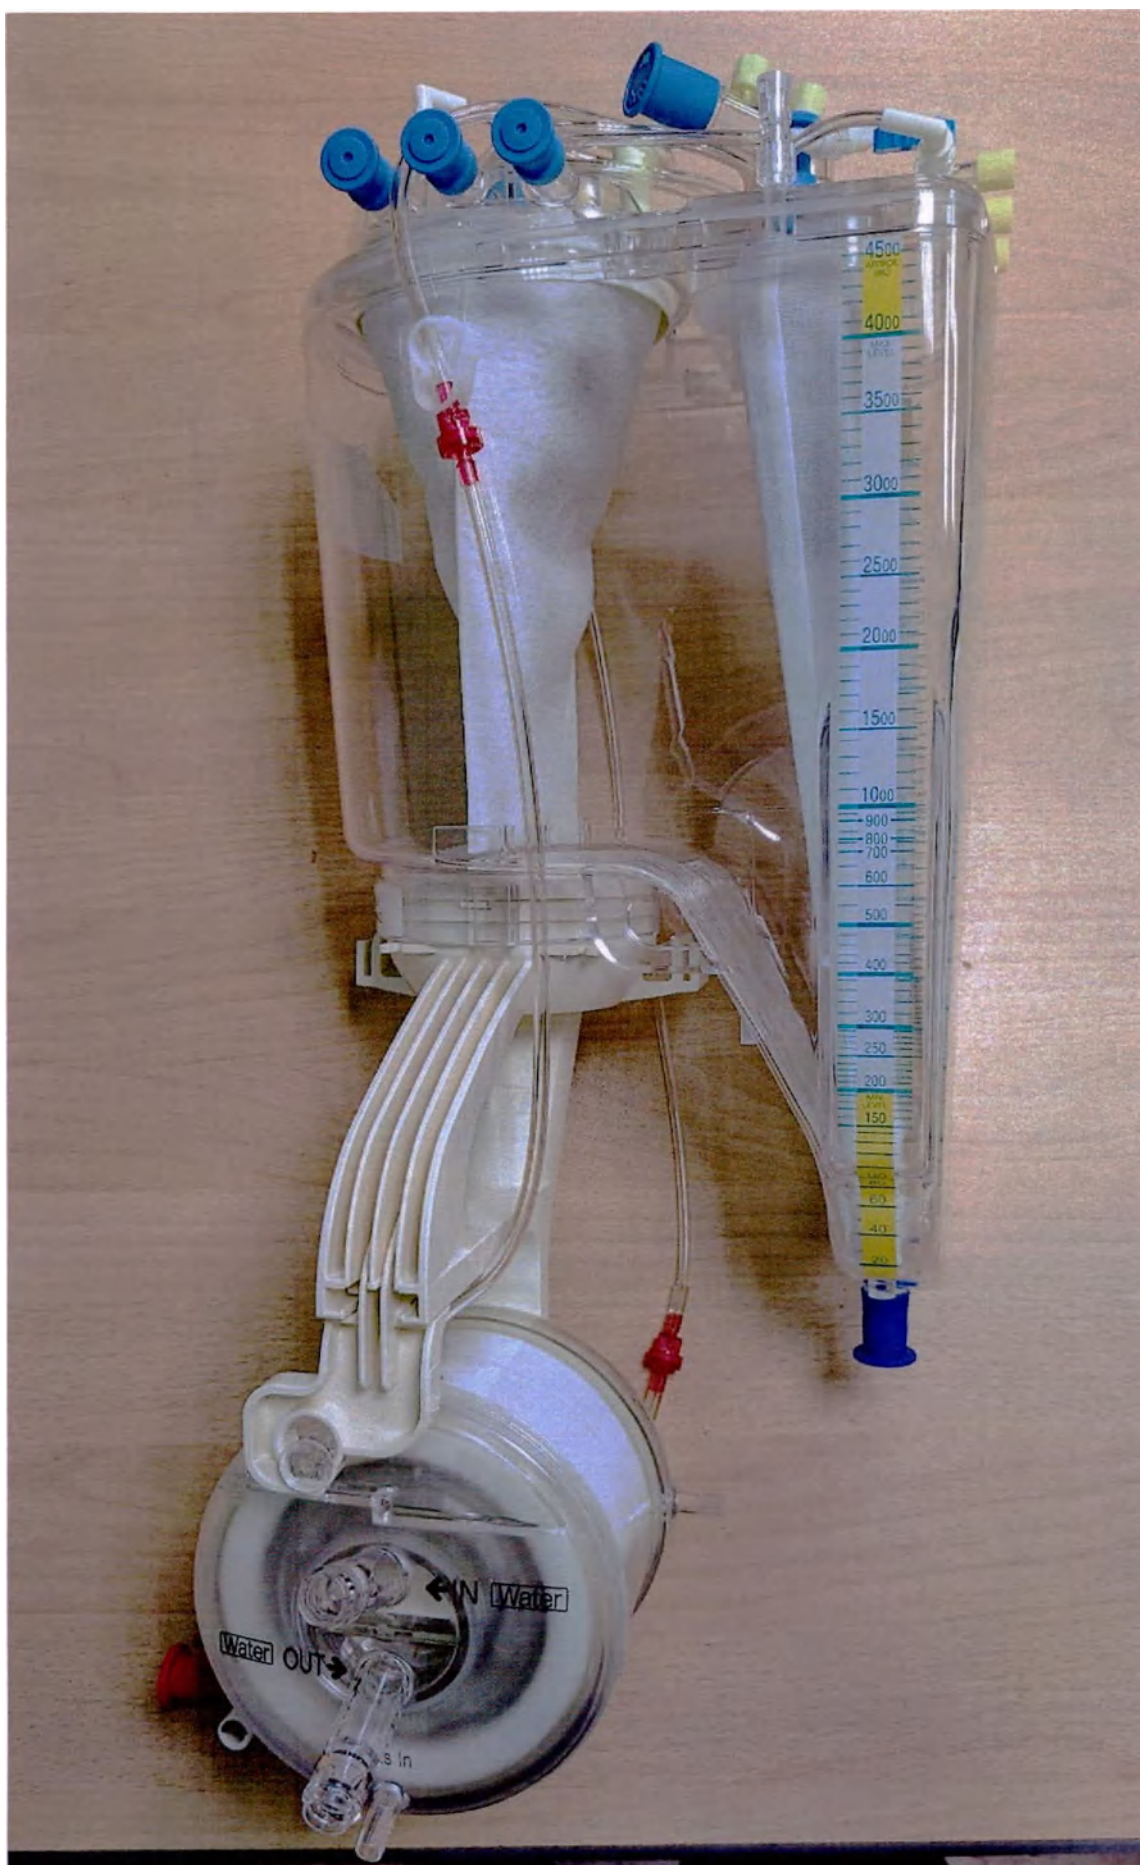


Рис. 11 - Оксигенатор мембранный CAPiox® FX15 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром 4000мл. Вид спереди.

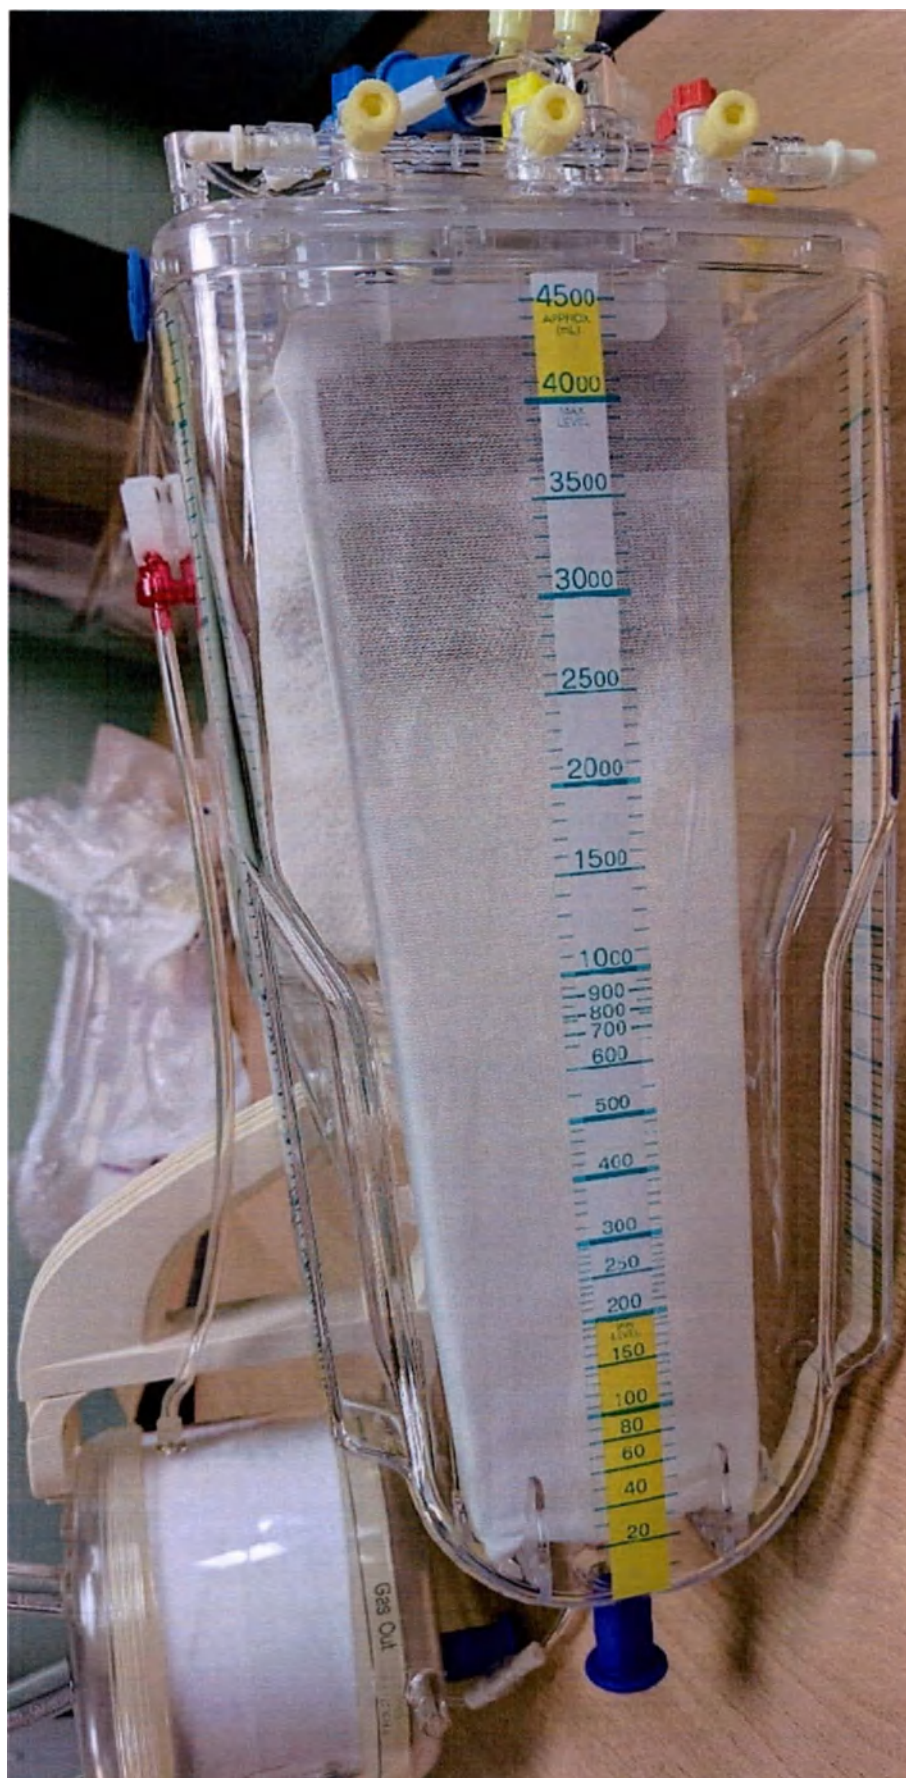


Рис. 12 - Оксигенатор мембранный CARIOX® FX15 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром 4000мл. Вид сзади.



Рис. 13 - Оксигенатор мембранный CAPiox® FX15 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром в стерильной упаковке



Рис. 14 – маркировка на стерильной упаковке оксигенатора мембранного CAPIOX® FX15 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром 3000 мл



Рис. 15 – маркировка на стерильной упаковке оксигенатора мембранного CAPIOX® FX15 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром 4000 мл



Рис. 16 – маркировка на корпусе оксигенатора мембранного CAPIOX® FX15 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром 3000 мл



Рис. 17 – маркировка на корпусе оксигенатора мембранного CAPIOX® FX15 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром 4000 мл



**Рис. 18 – адаптеры порта (адаптер порта 1/4 дюйма – 4 шт.) в индивидуальной упаковке к
Оксигенатору мембранному CAPIOX® FX15 вариантов исполнения CX*FX15RE30 и
CX*FX15RW30**



Рис. 19 – Отдельная коробка оксигенатора мембранного CAPIOX® FX15 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром 3000 мл – вид спереди



Рис. 20 – Отдельная коробка оксигенатора мембранного CAPIOX® FX15 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром 3000 мл – вид сзади



Рис. 23 - Оксигенатор мембранный CARIOX® FX25 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром. Вид спереди.



Рис. 24 - Оксигенатор мембранный CARIOX® FX25 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром. Вид сзади.



Рис. 25 - Оксигенатор мембранный CAPiox® FX25 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром в стерильной упаковке

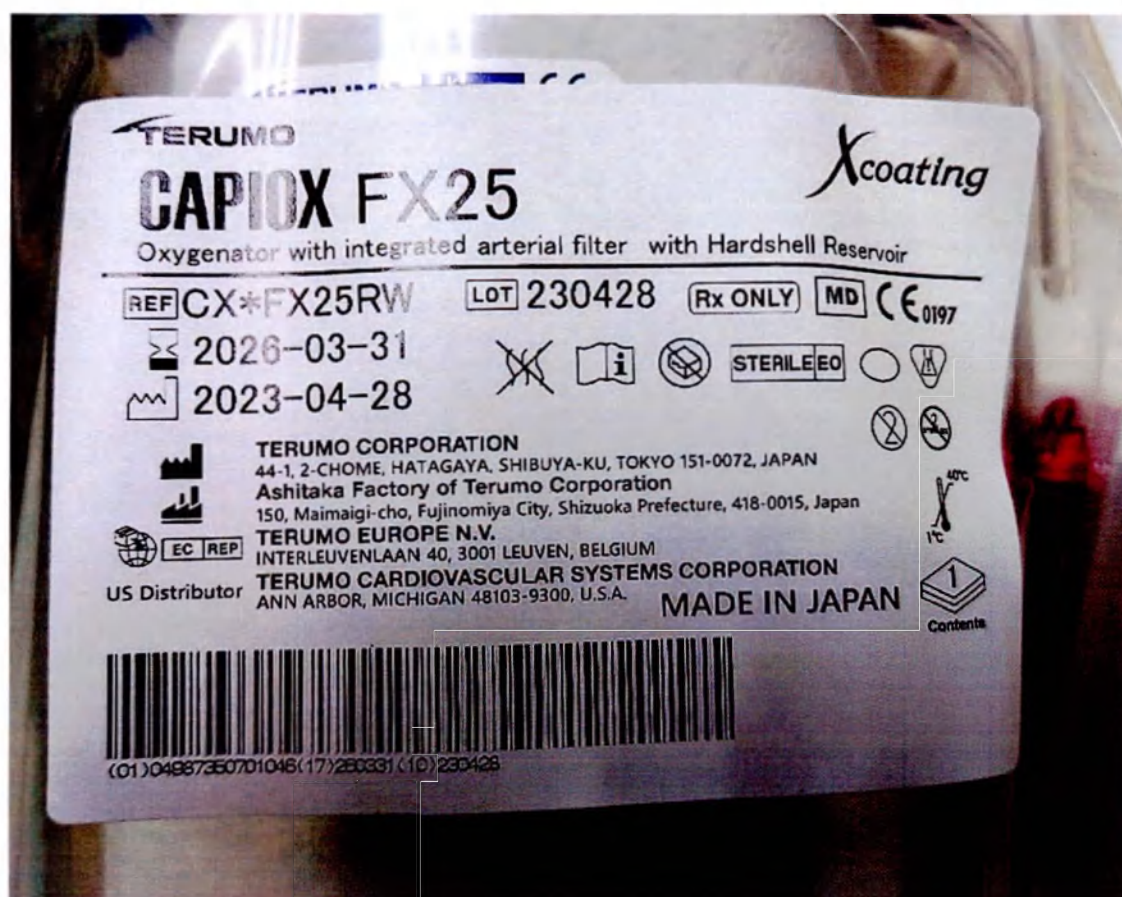


Рис. 26 – маркировка на стерильной упаковке оксигенатора мембранного CAPIOX® FX25 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром.



Рис. 27 – маркировка на корпусе оксигенатора мембранного CAPIOX® FX25 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром.



Рис. 28 – Отдельная коробка оксигенатора мембранного CAPIOX® FX25 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром – вид спереди

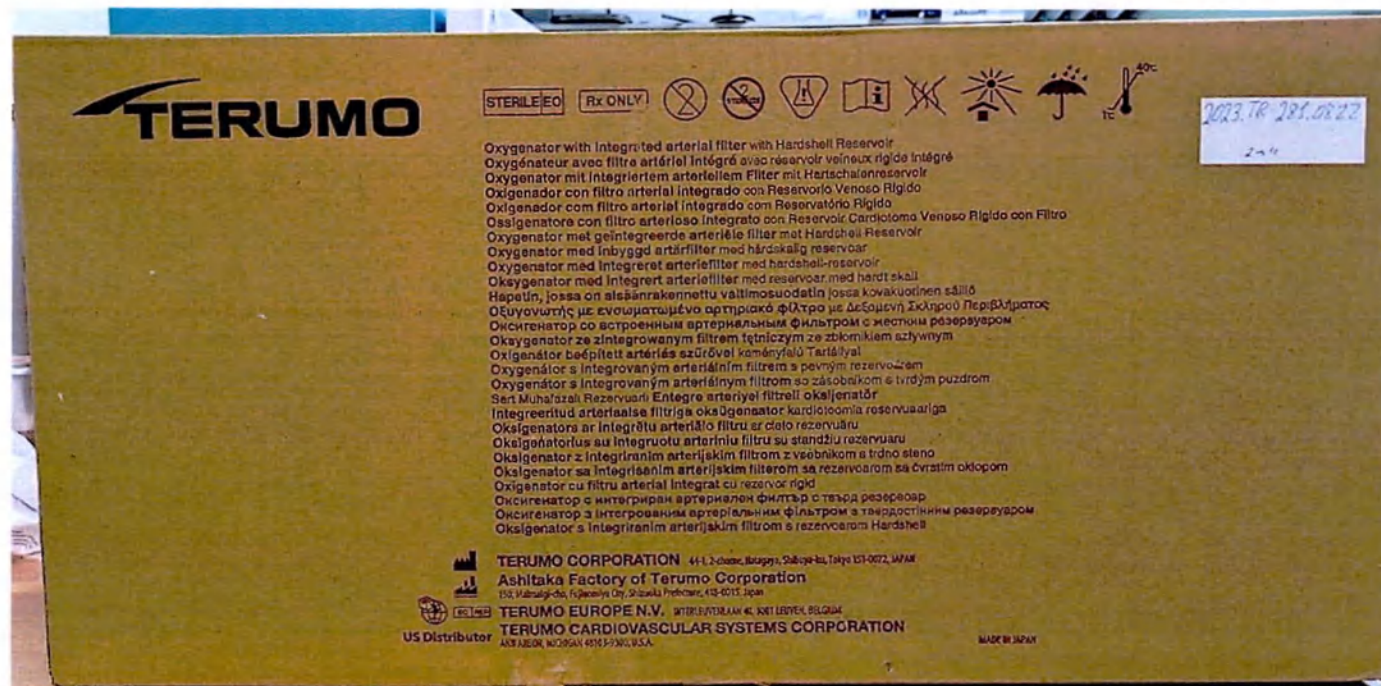


Рис. 29 – Отдельная коробка оксигенатора мембранного CAPIOX® FX25 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром – вид спереди



Рис. 30 – Держатель для оксигенатора XX*CXH18R вид спереди



Рис. 31 – Держатель для оксигенатора XX*CXH18R вид в упаковке

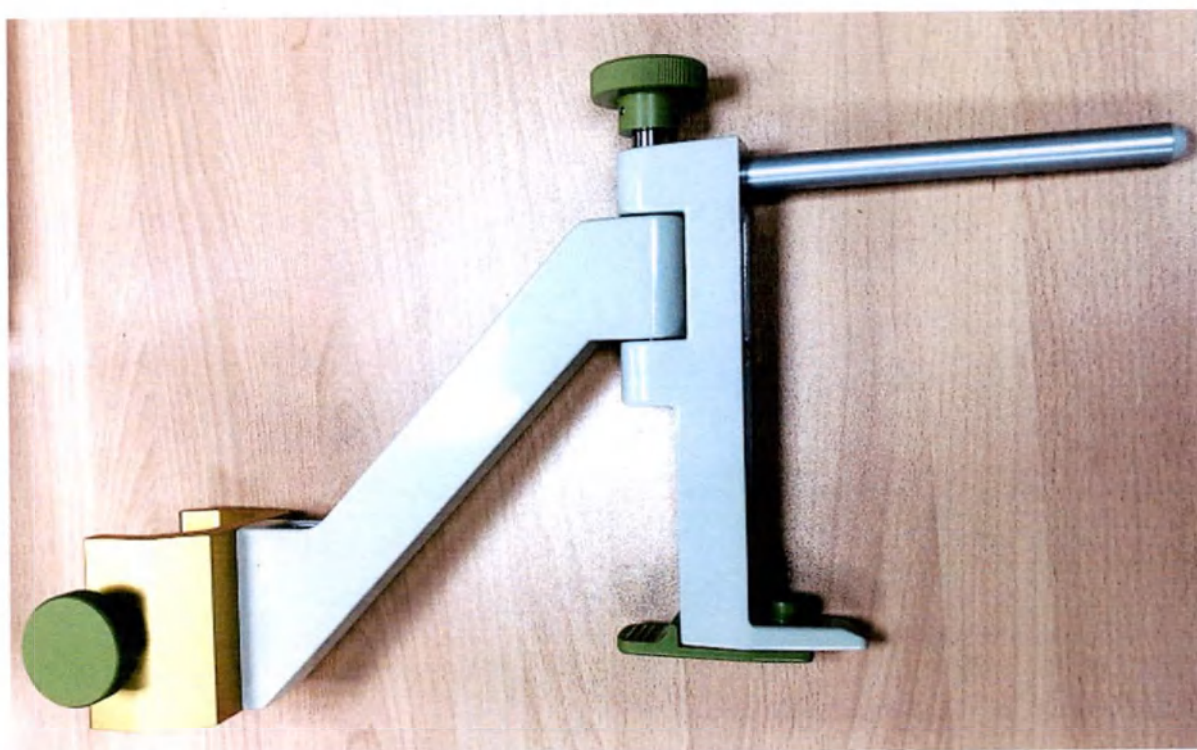


Рис. 32 – Держатель для оксигенатора XX*CXH18R вид сзади

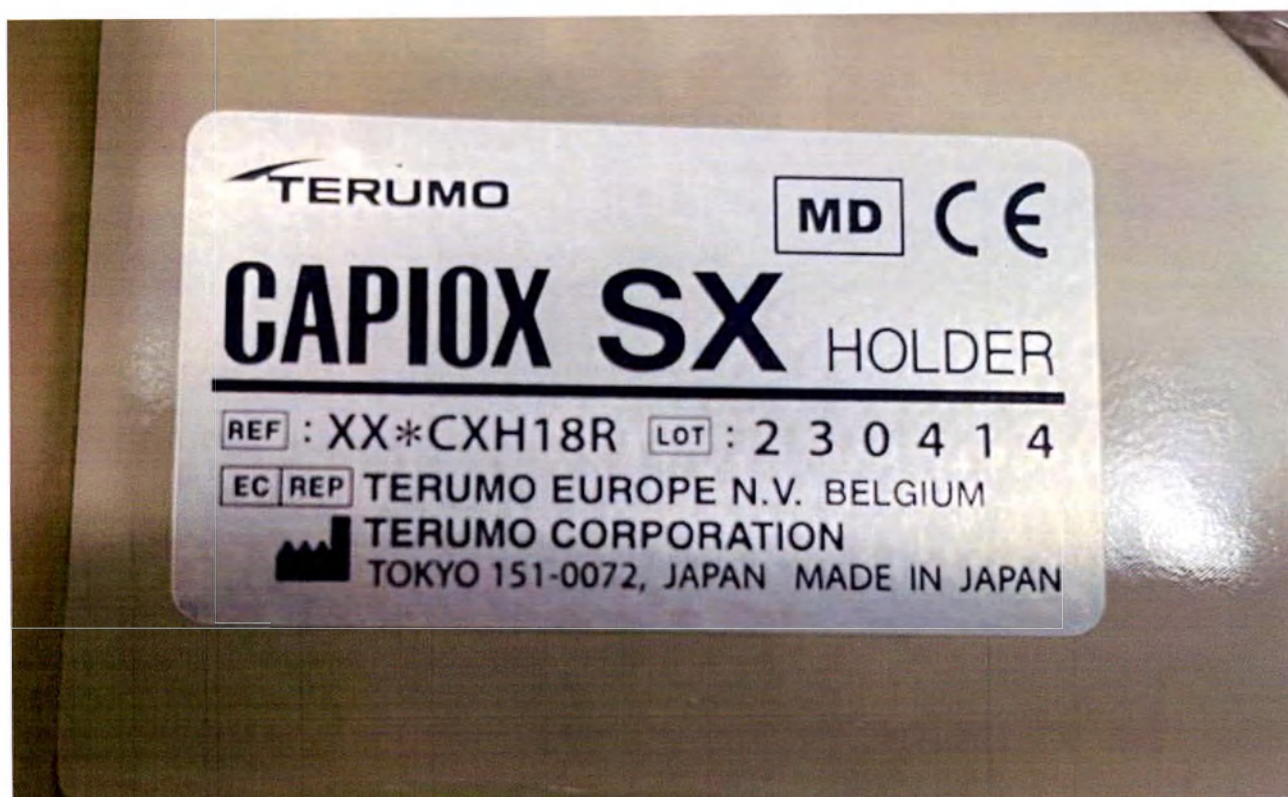


Рис. 33 – Маркировка держателя для оксигенатора XX*CXH18R

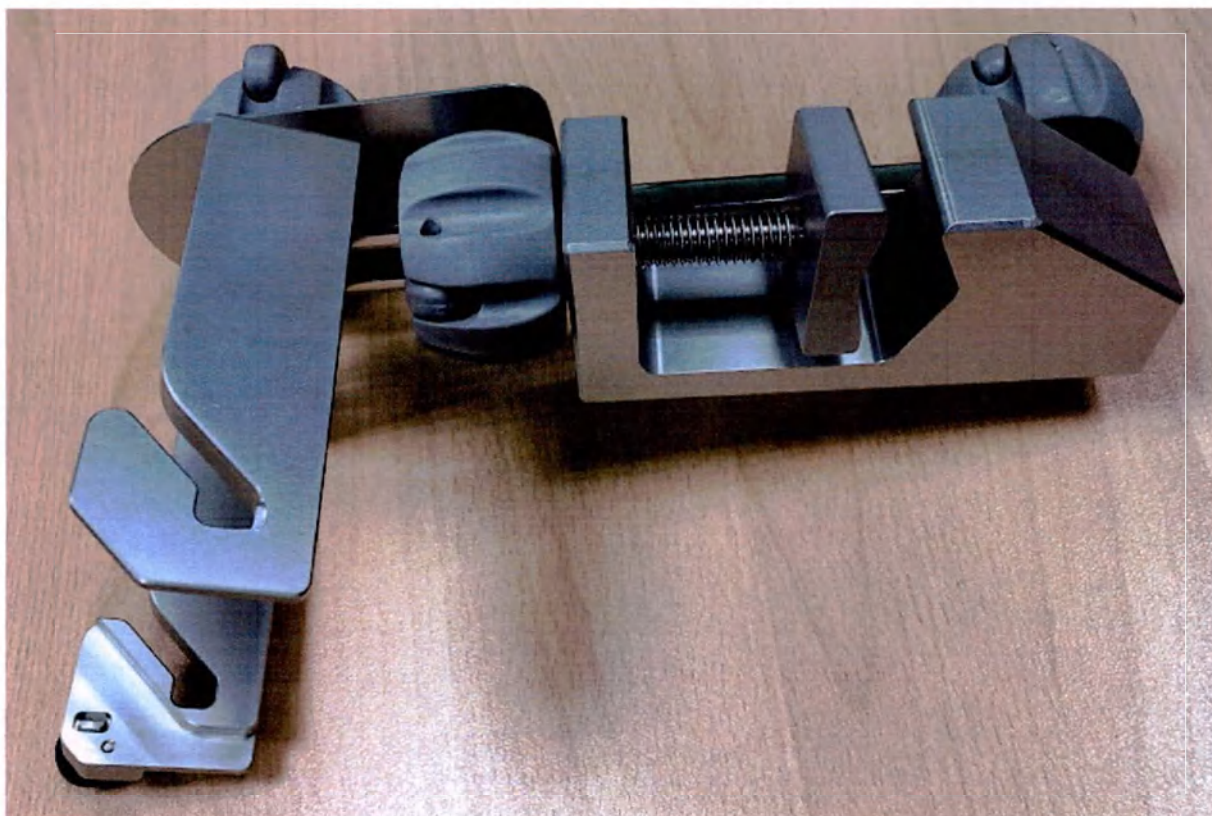


Рис. 34 – Держатель для оксигенатора XX* CXH15 вид спереди



Рис. 35 – Держатель для оксигенатора XX* CXH15 в упаковке

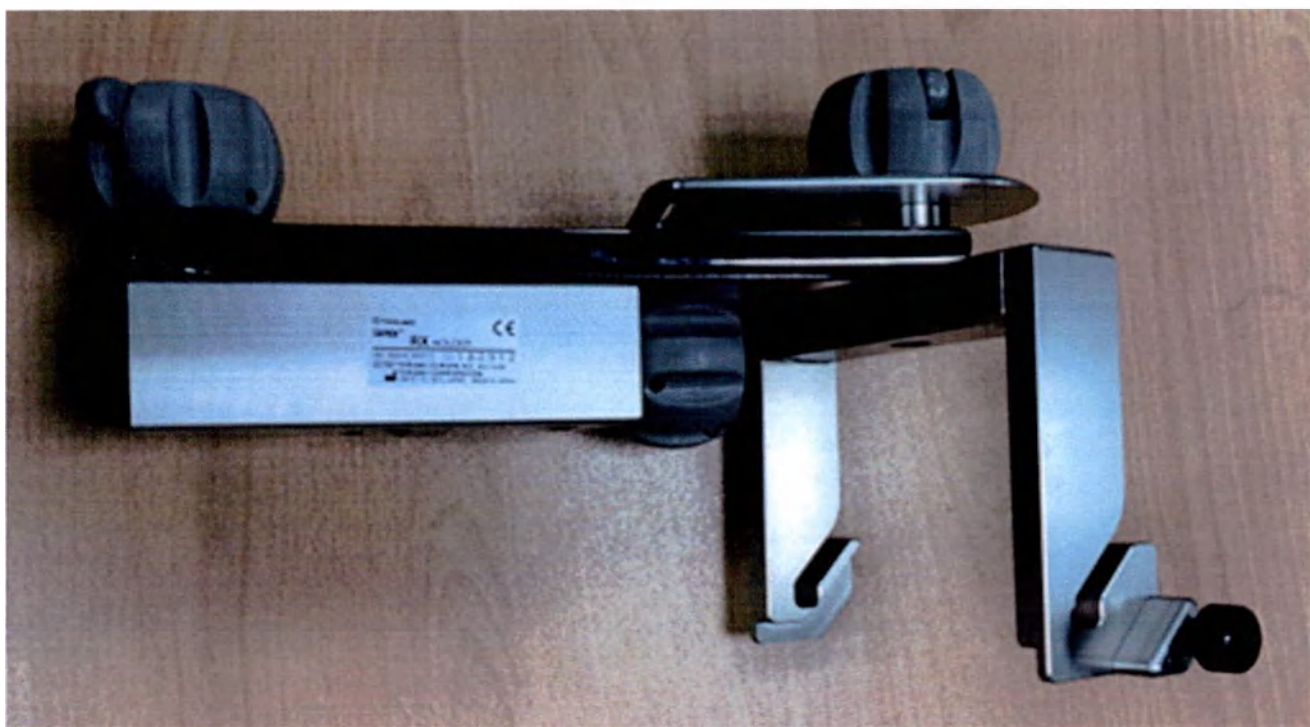


Рис. 36 – Держатель для оксигенатора XX* CXH15 вид сзади

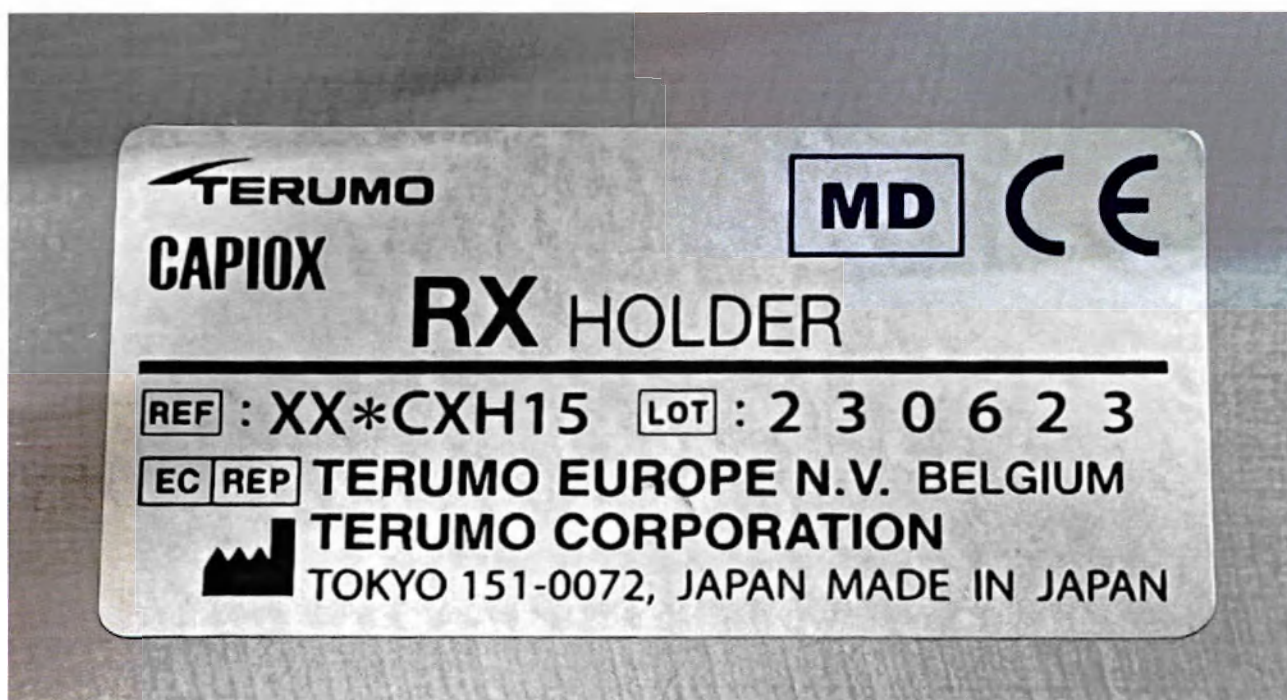


Рис. 37 – Маркировка держателя для оксигенатора XX* CXH15



Рис. 38 – Держатель для оксигенатора XX*ХН032, вид спереди



Рис. 39 – Держатель для оксигенатора XX*ХН032, вид в упаковке

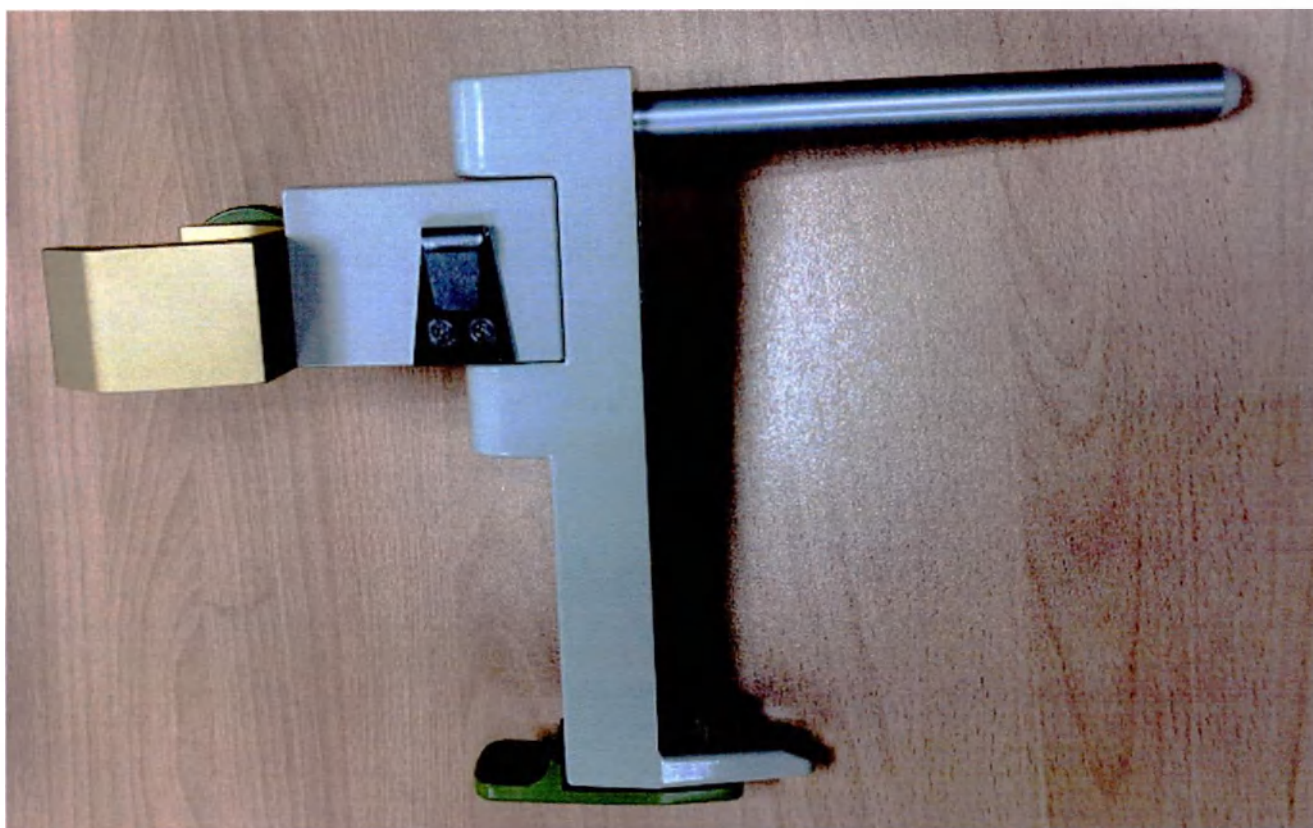


Рис. 40 – Держатель для оксигенатора XX*XH032, вид сзади



Рис. 41 – Маркировка держателя для оксигенатора XX*XH032



Рис. 42 – Держатель для оксигенатора XX*CXH25F, вид спереди



Рис. 43 – Держатель для оксигенатора XX*CXH25F в упаковке

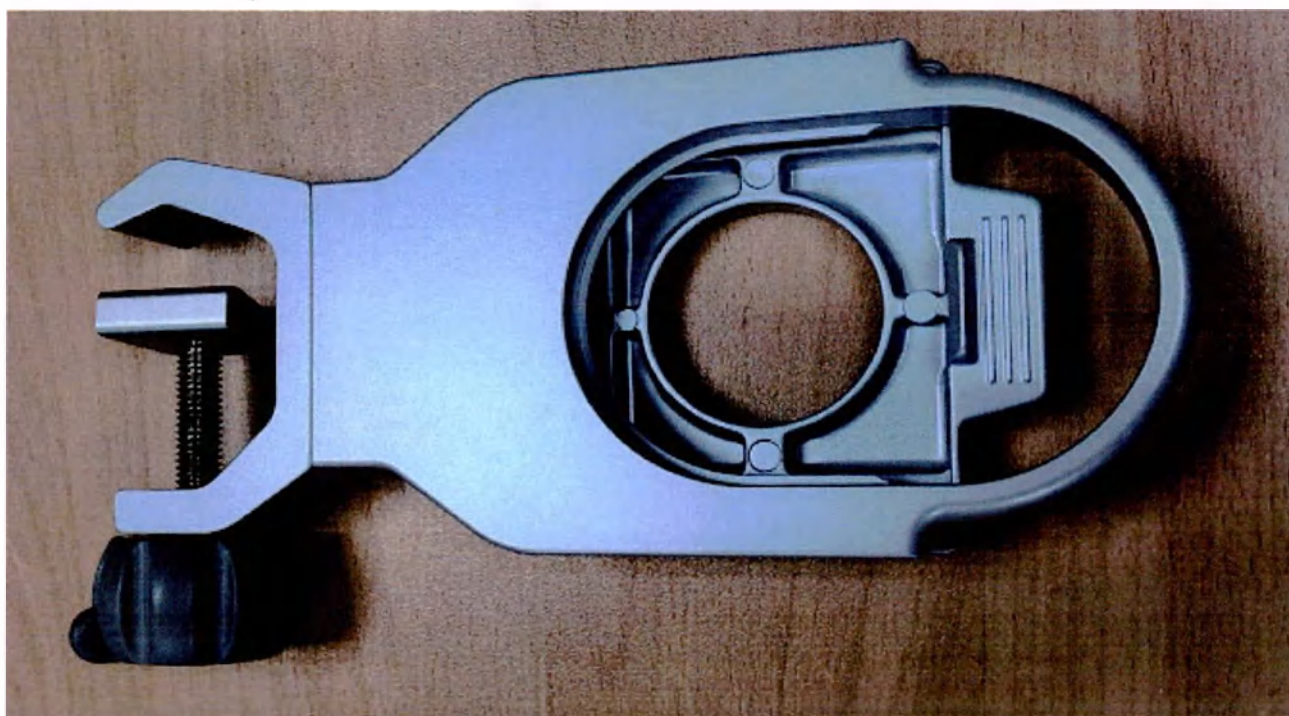


Рис. 44 – Держатель для оксигенатора XX*CXH25F, вид сзади



Рис. 45 – Маркировка держателя для оксигенатора XX*CXH25F

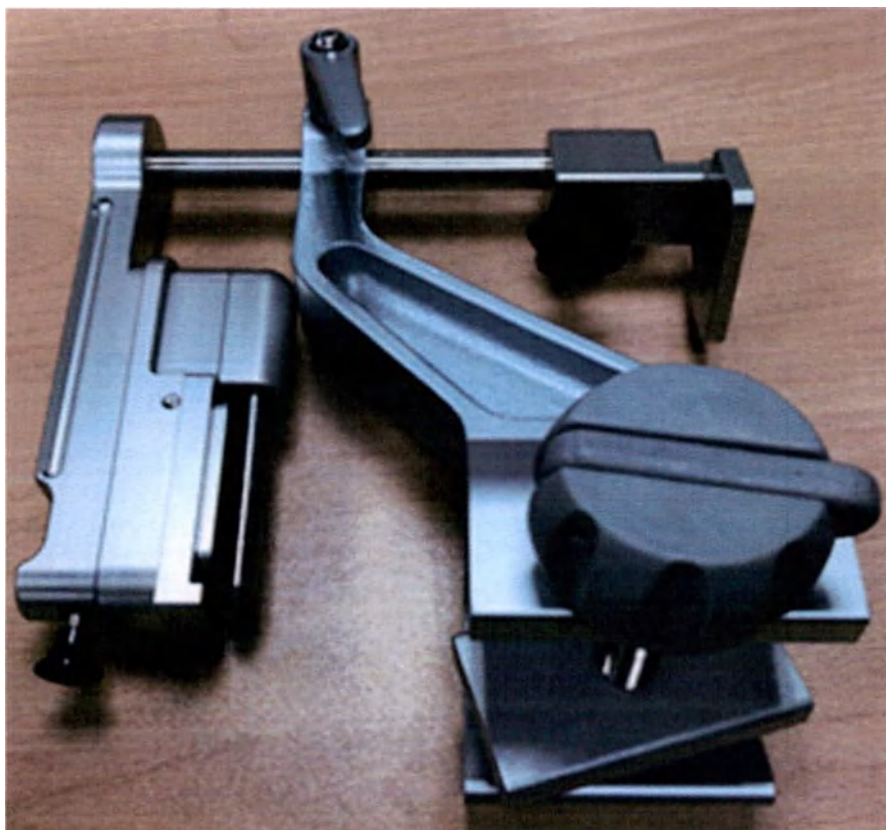


Рис. 46 – Держатель для оксигенатора XX*CXH05R, вид спереди



Рис. 47 – Держатель для оксигенатора XX*CXH05R в упаковке



Рис. 48 – Держатель для оксигенатора XX*CXH05R, вид сзади



Рис. 49 – Маркировка держателя для оксигенатора XX*CXH05R



Рис. 50 – Синий кабель термисторного датчика CX*BP021



Рис. 51 – Синий кабель термисторного датчика CX*BP021 в упаковке



Рис. 52 – Синий кабель термисторного датчика CX*BP021 - маркировка

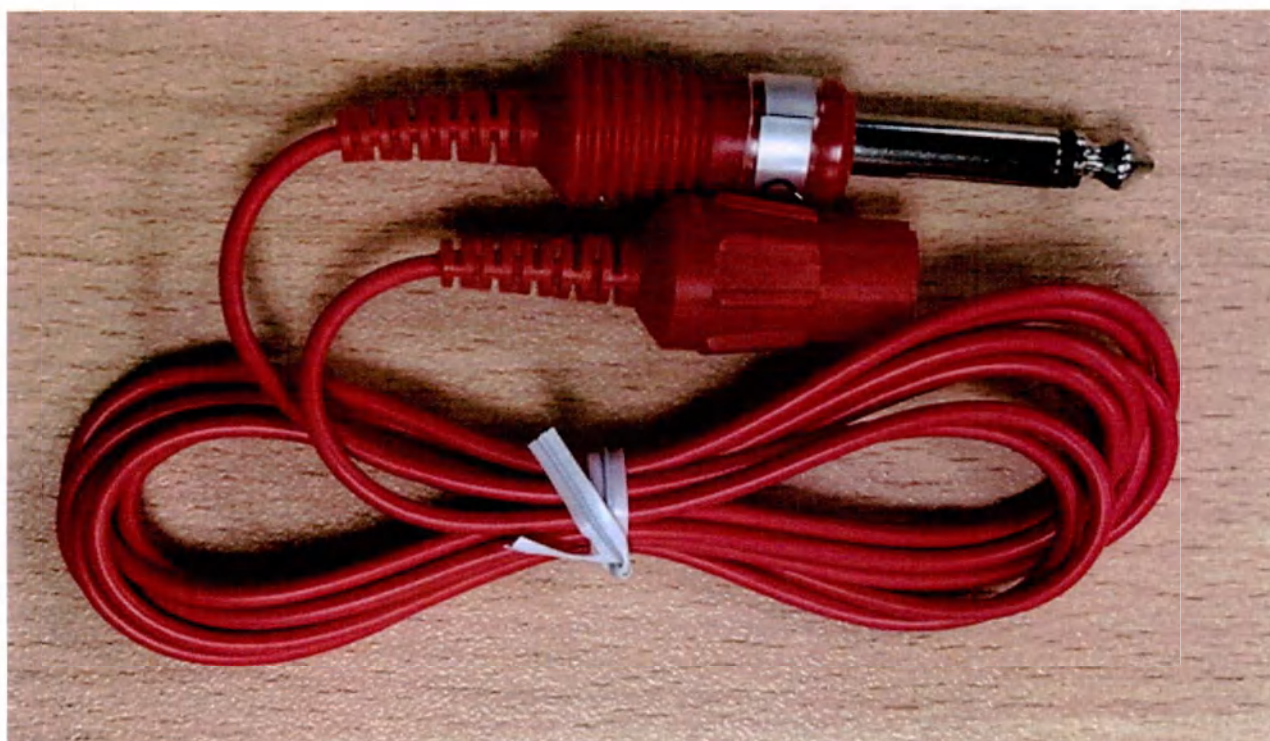


Рис. 53 – Красный кабель термисторного датчика CX*BP022



Рис. 54 – Красный кабель термисторного датчика CX*BP022 в упаковке



Рис. 55 – Красный кабель термисторного датчика CX*BP022 - маркировка

