

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

По доверенности
Сюнь Вэй
2021г.
10 декабря



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Resona I9 с принадлежностями.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

_____ Сюн Вэй

«___» _____ 2021г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Resona I9 с
принадлежностями.

Все составляющие и принадлежности медицинского изделия «Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Resona I9 с принадлежностями» идентичны независимо от варианта исполнения, кроме основного блока медицинского изделия. Основной блок данного медицинского изделия имеет одно внешнее отличие, которое заключается в том, что на панели управления основного блока указывается вариант исполнения: Resona I9, Resona I9 Exp, Resona I9S, Resona I9T, Resona I9 Easi, Resona I9 Nasa. Маркировка основного блока является идентичной для всех вариантов исполнения медицинского изделия «Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Resona I9 с принадлежностями, варианты исполнения». Отличие маркировки состоит только в указании наименования варианта исполнения основного блока.

1.1.1 Основной блок, вариант исполнения Resona I9 – 1 шт.



1.1.2 Основной блок, вариант исполнения Resona I9 – 1 шт.



1.2.1 Основной блок, вариант исполнения Resona I9 Exp – 1 шт .



1.2.2 Основной блок, вариант исполнения Resona I9 Exp – 1 шт .



1.3.1 Основной блок, вариант исполнения Resona I9S – 1 шт.



1.3.2 Основной блок, вариант исполнения Resona I9S – 1 шт.



1.4.1 Основной блок, вариант исполнения Resona I9T – 1 шт.



1.4.2 Основной блок, вариант исполнения Resona I9T – 1 шт.



1.5.1 Основной блок, вариант исполнения Resona I9 Easi – 1 шт.



1.5.2 Основной блок, вариант исполнения Resona I9 Easi – 1 шт.



1.6.1 Основной блок, вариант исполнения Resona I9 Nasa – 1 шт.



1. 7 Вид сзади.



1.8 Вид сбоку.




1.9 Вид сбоку 2.




1.10 Фотографическое изображение маркировки основного блока медицинского изделия «Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Resona I9 с принадлежностями, варианты исполнения: Resona I9».

Наименование
варианта исполнения


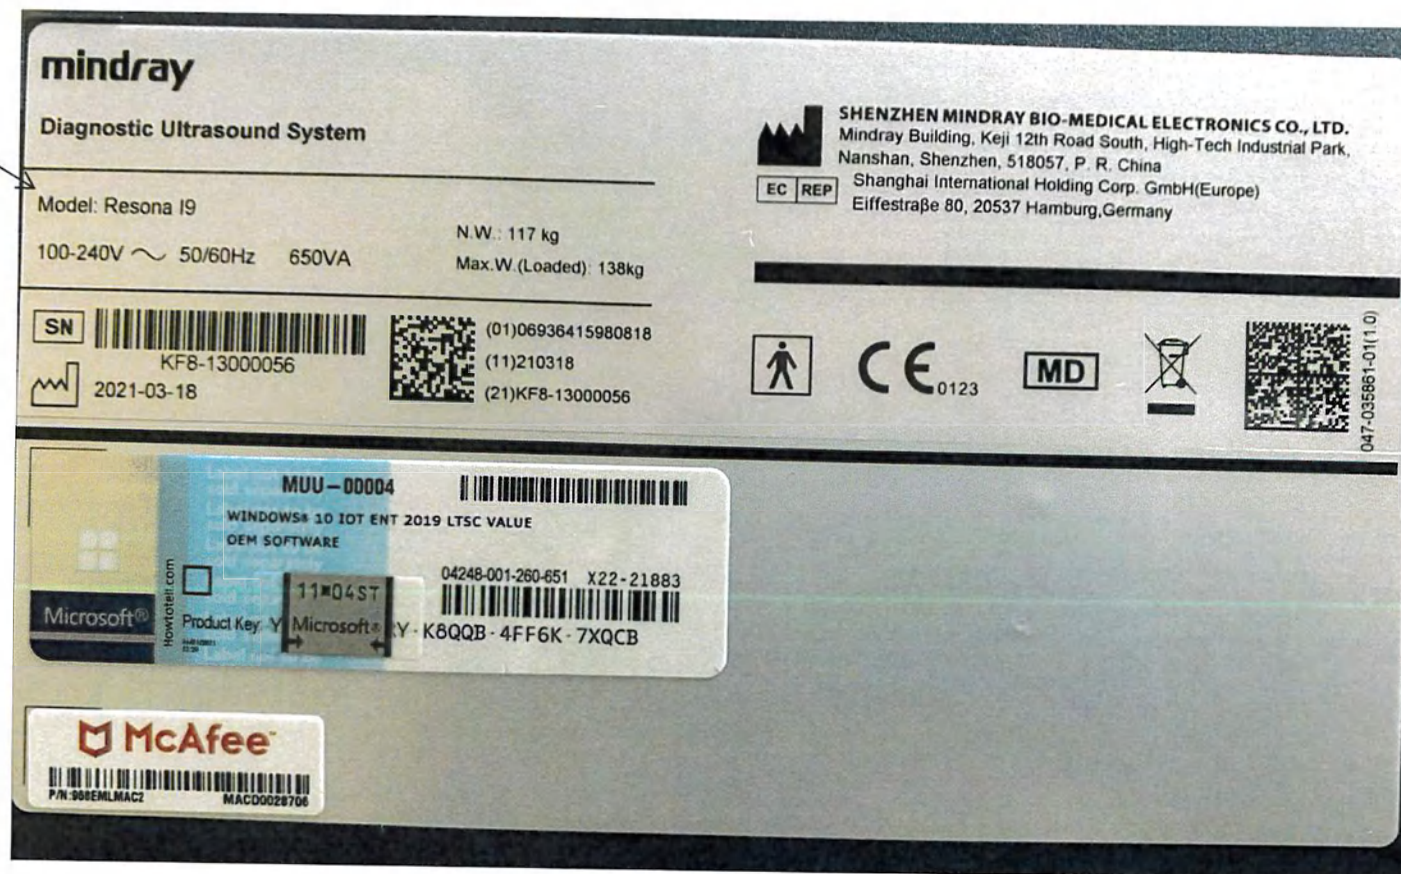




4. Кабель питания основного блока.

4.1 Кабель питания основного блока

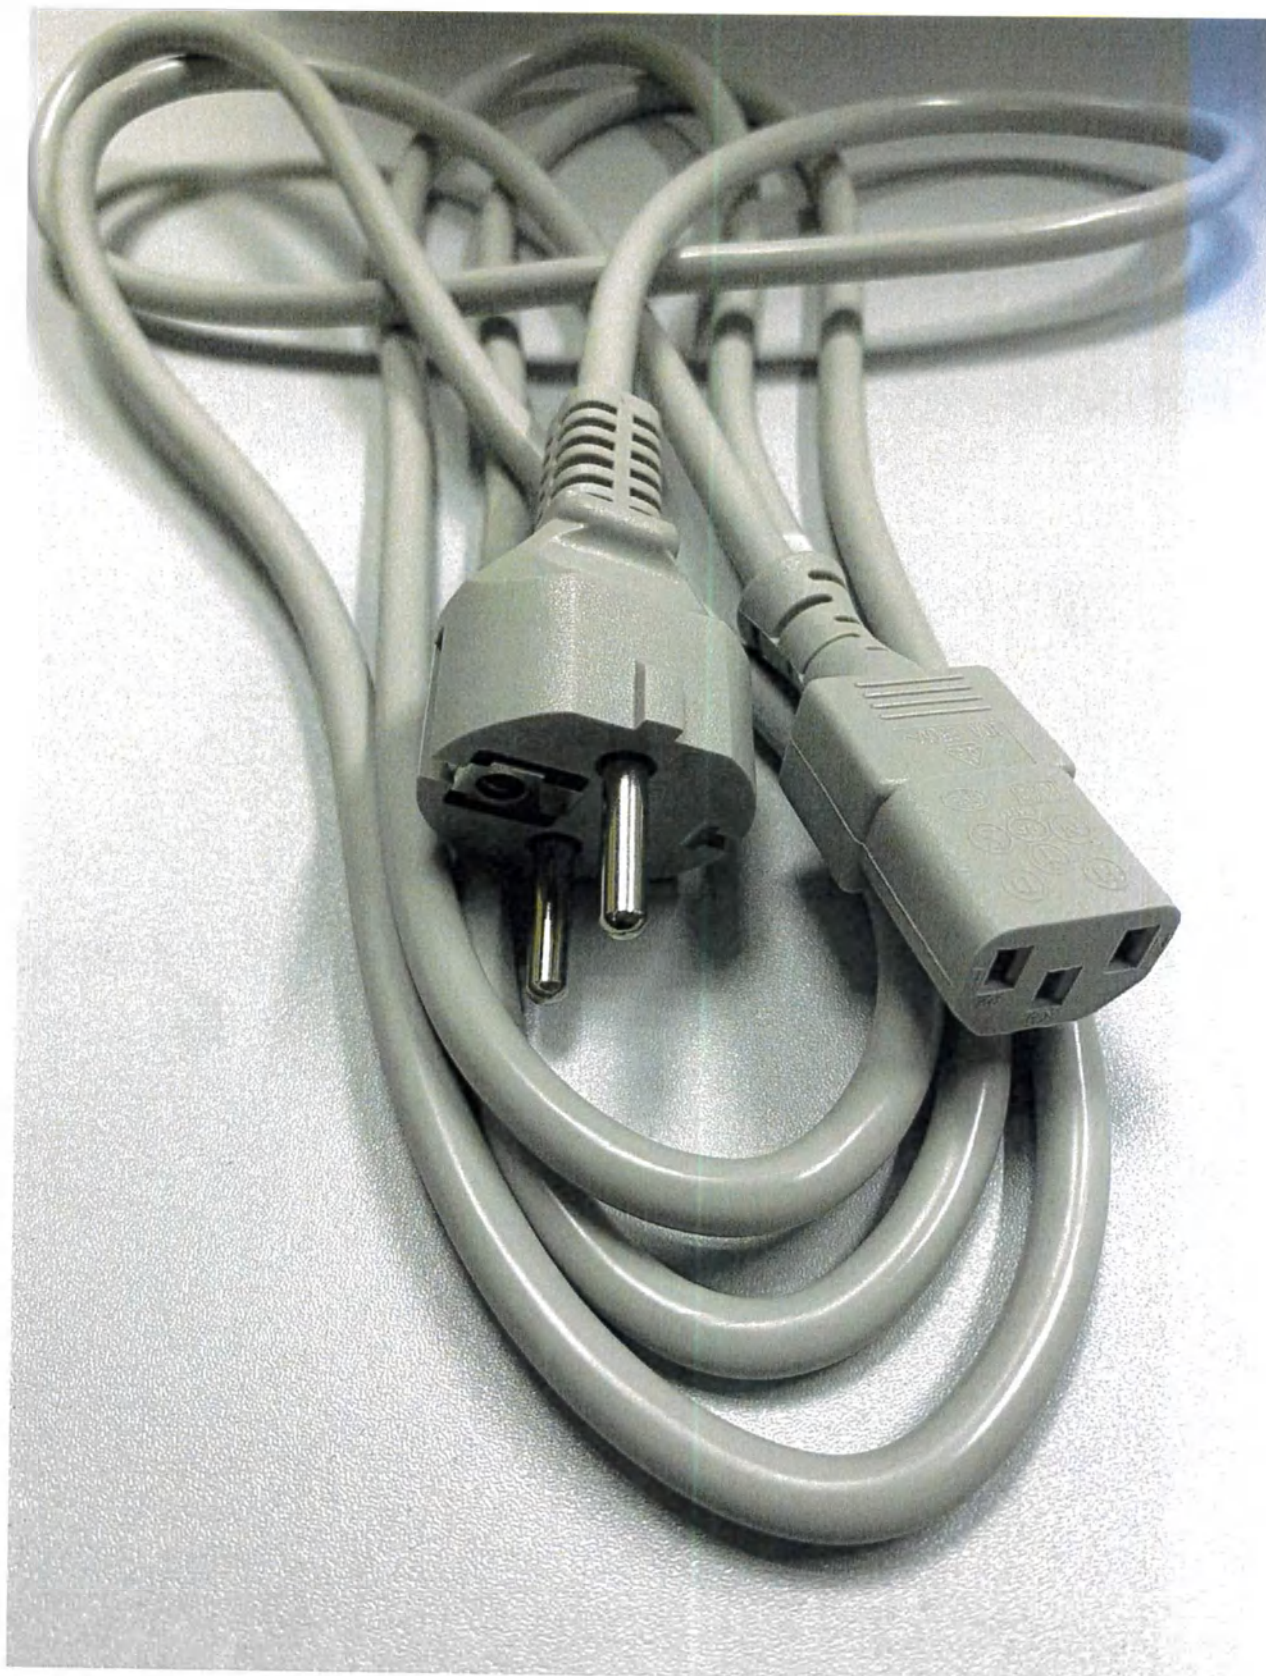


4. 2 Маркировка кабеля питания основного блока

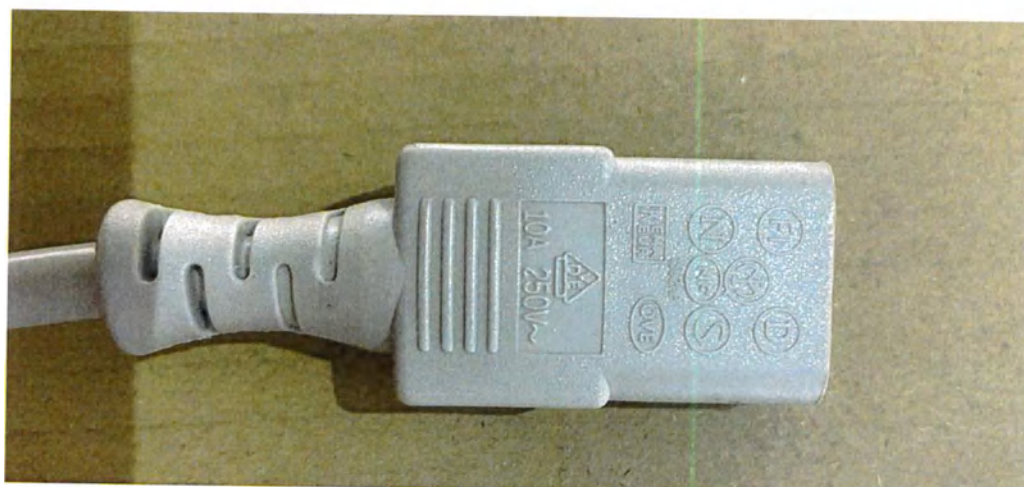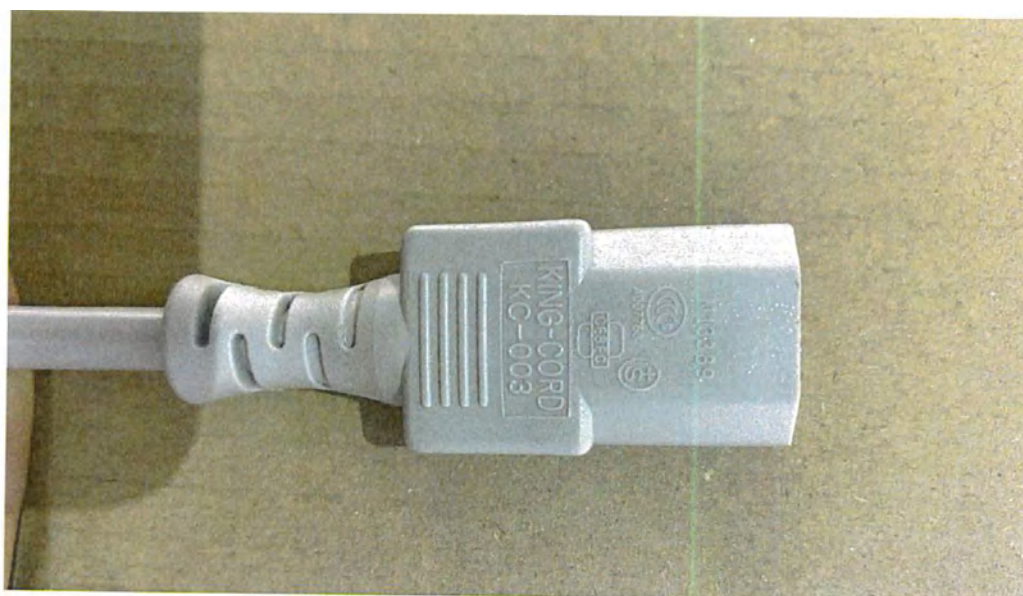

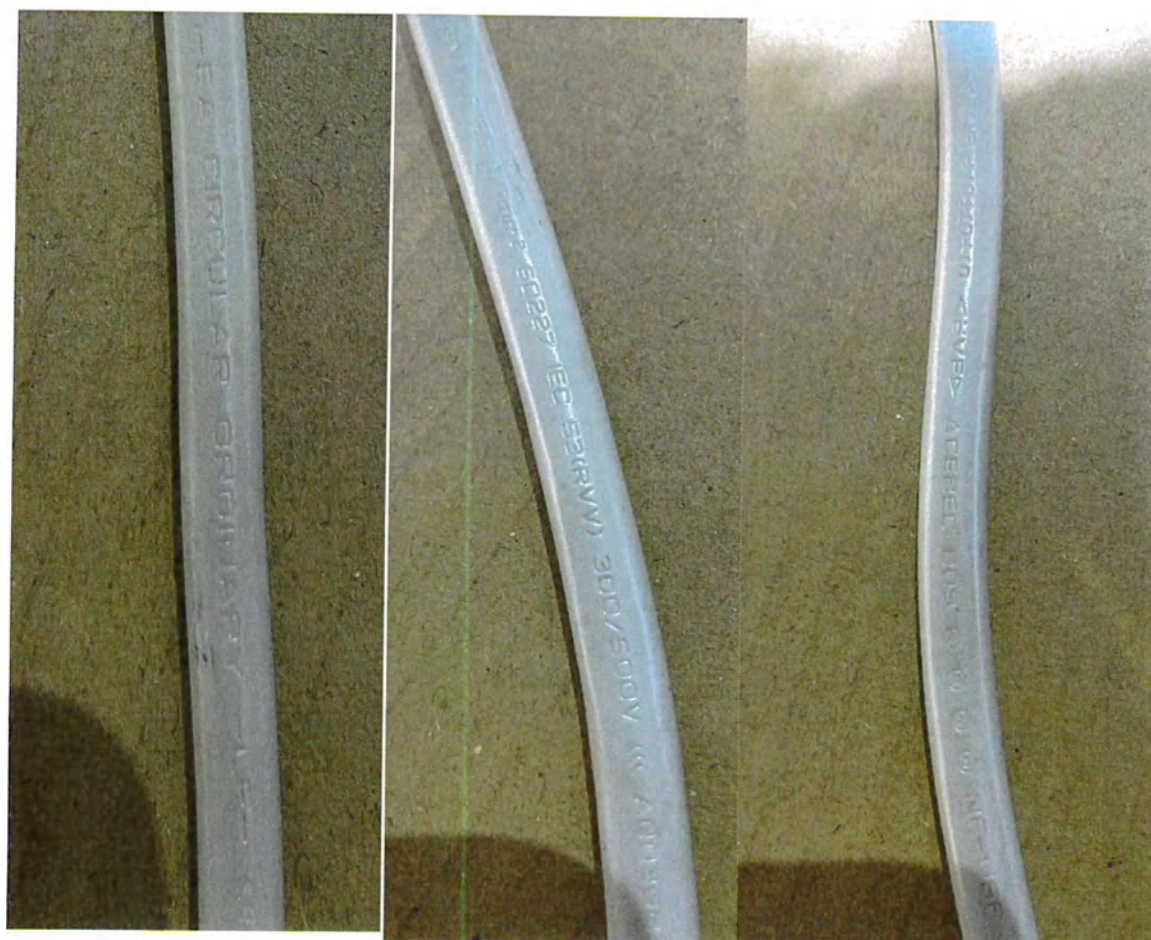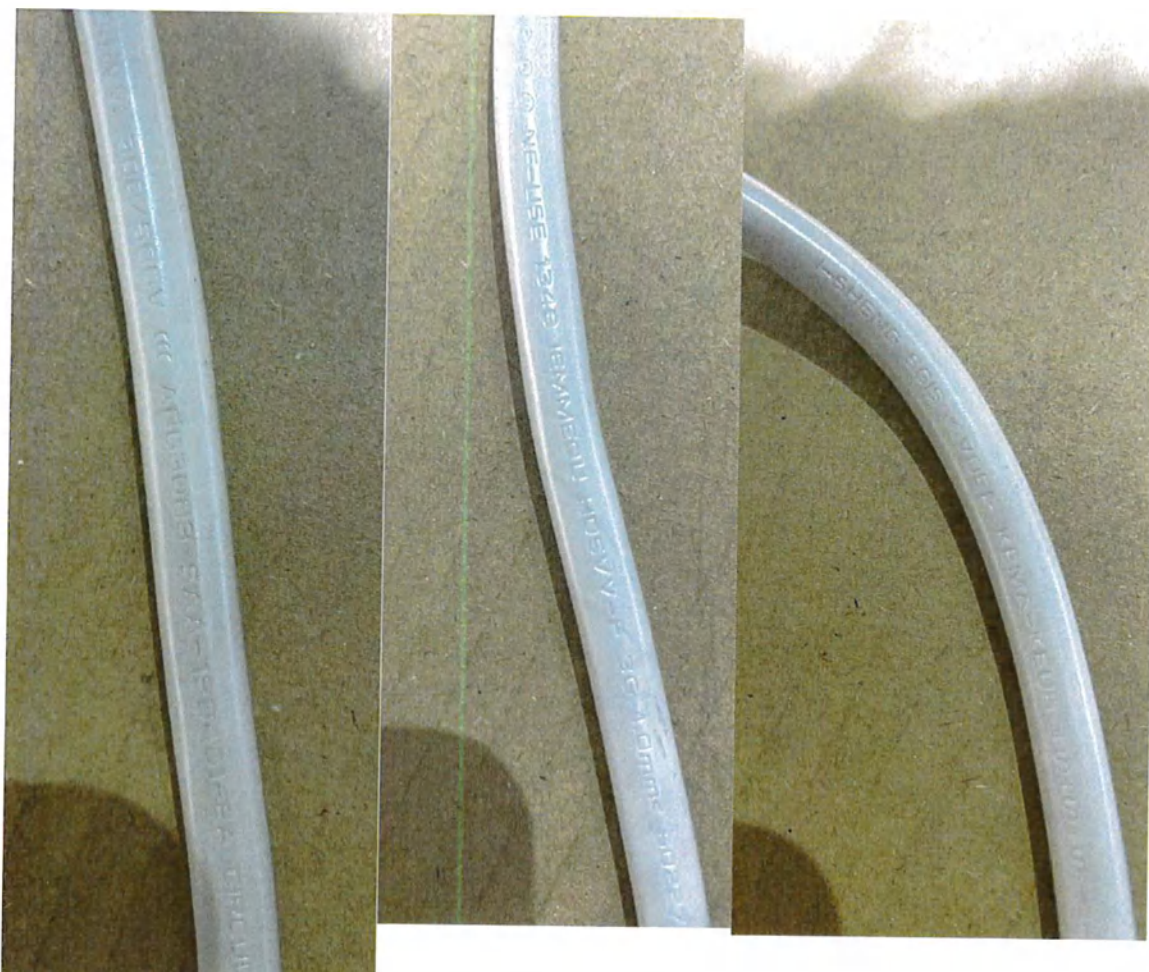

4.3 Маркировка упаковки кабеля питания основного блока.

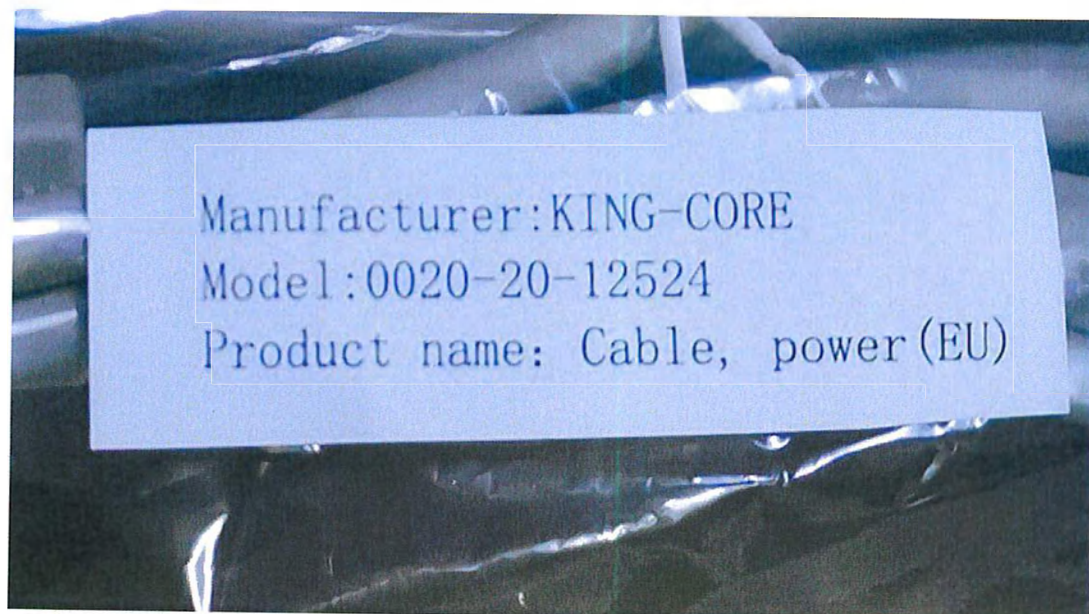



Manufacturer:	Производитель
Model:	Модель
Product name: Cable power (EU)	Наименование: Кабель питания основного блока

5. Кабель питания периферийных устройств
5.1 Кабель питания периферийных устройств



5.2 Маркировка кабеля питания периферийных устройств



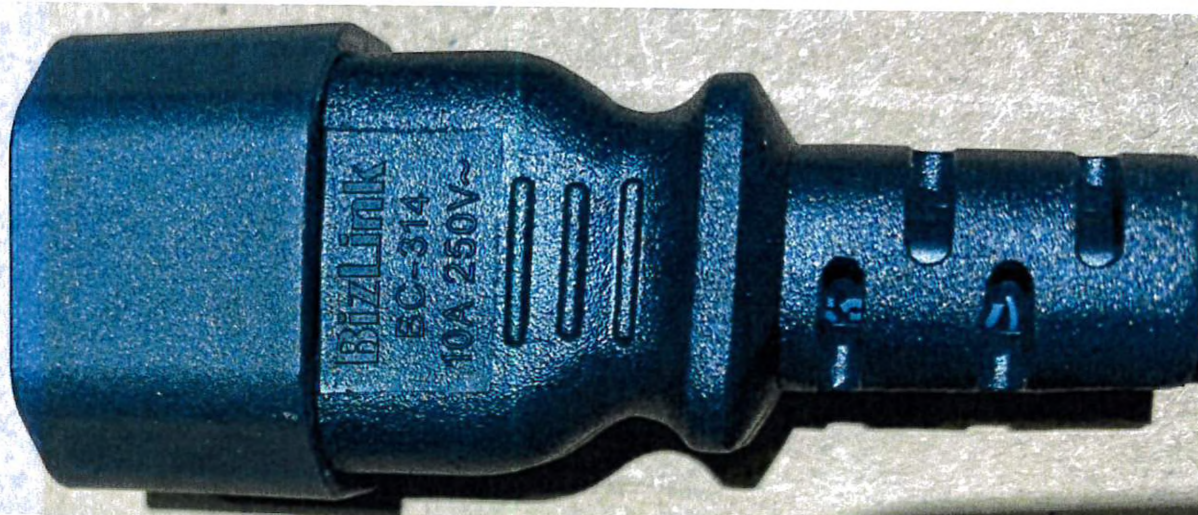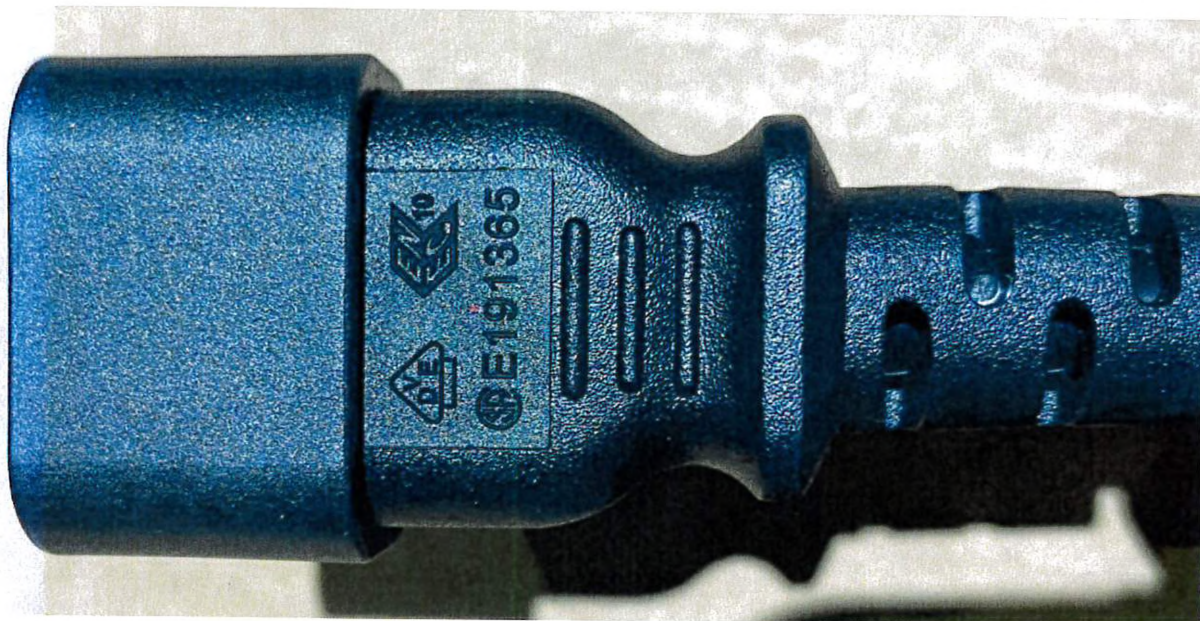


5.3 Маркировка упаковки кабеля питания периферийных устройств




Manufacturer:	Производитель
Product name: Power Cable for Peripheral Devices	Наименование: Кабель питания периферийных устройств

6. Кабель заземления

6.1 Кабель заземления

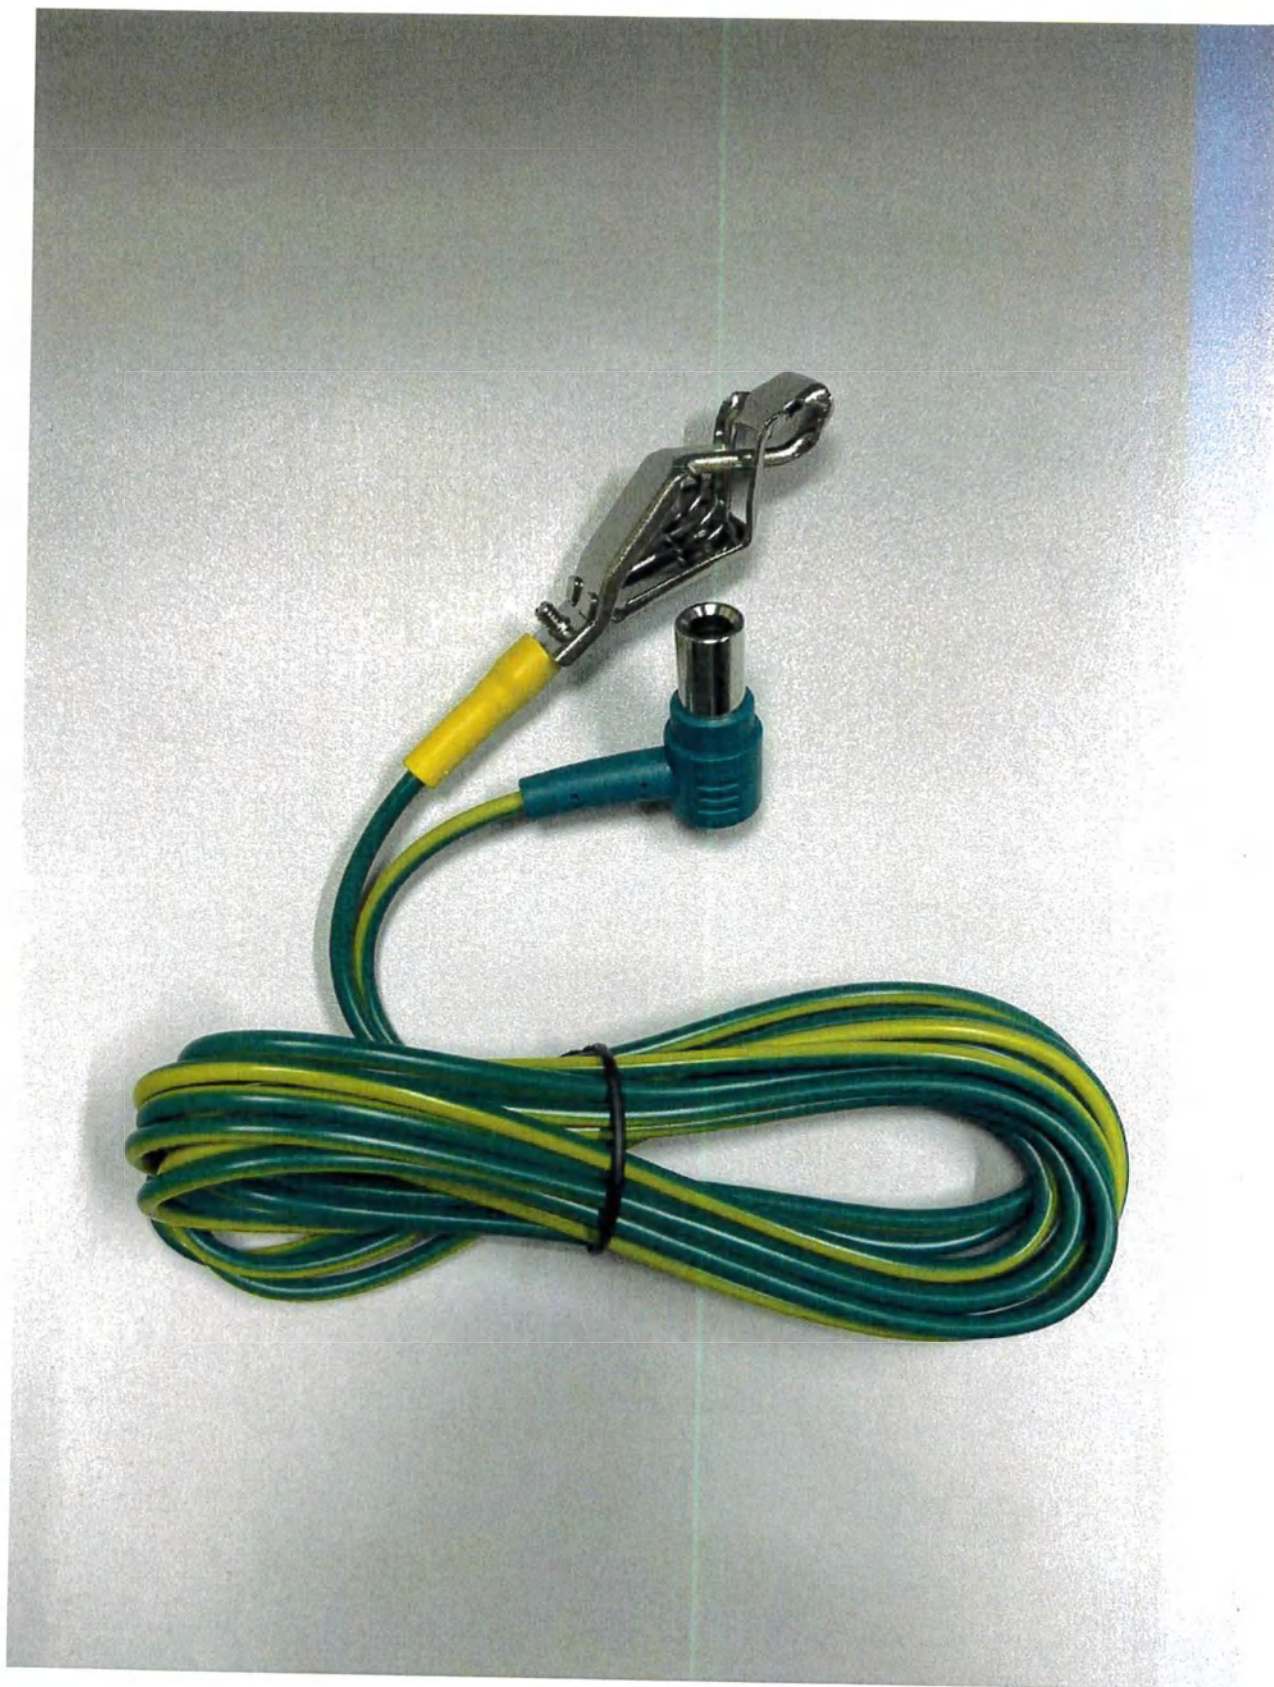

6.2 Маркировка кабеля заземления.

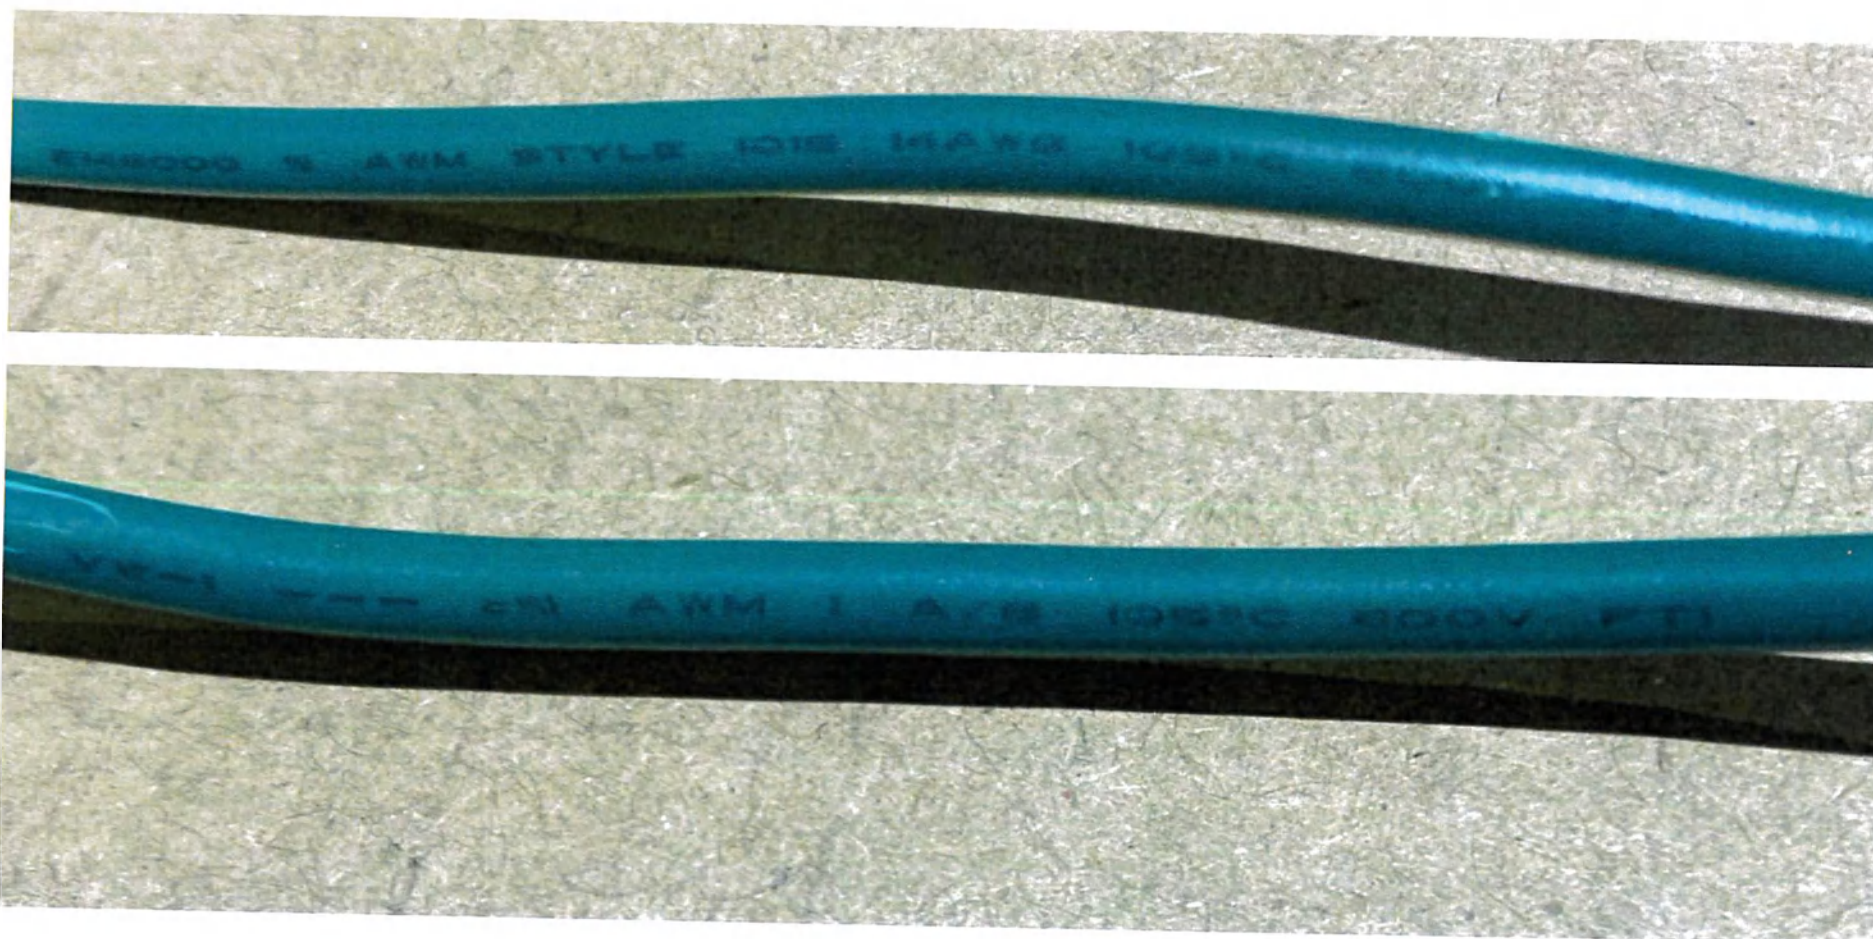


6.3 Маркировка упаковки кабеля заземления.




Manufacturer:	Производитель
Product name: Grounding cable	Наименование: Кабель заземления


7. Накладка на панель управления с переводом на русский язык

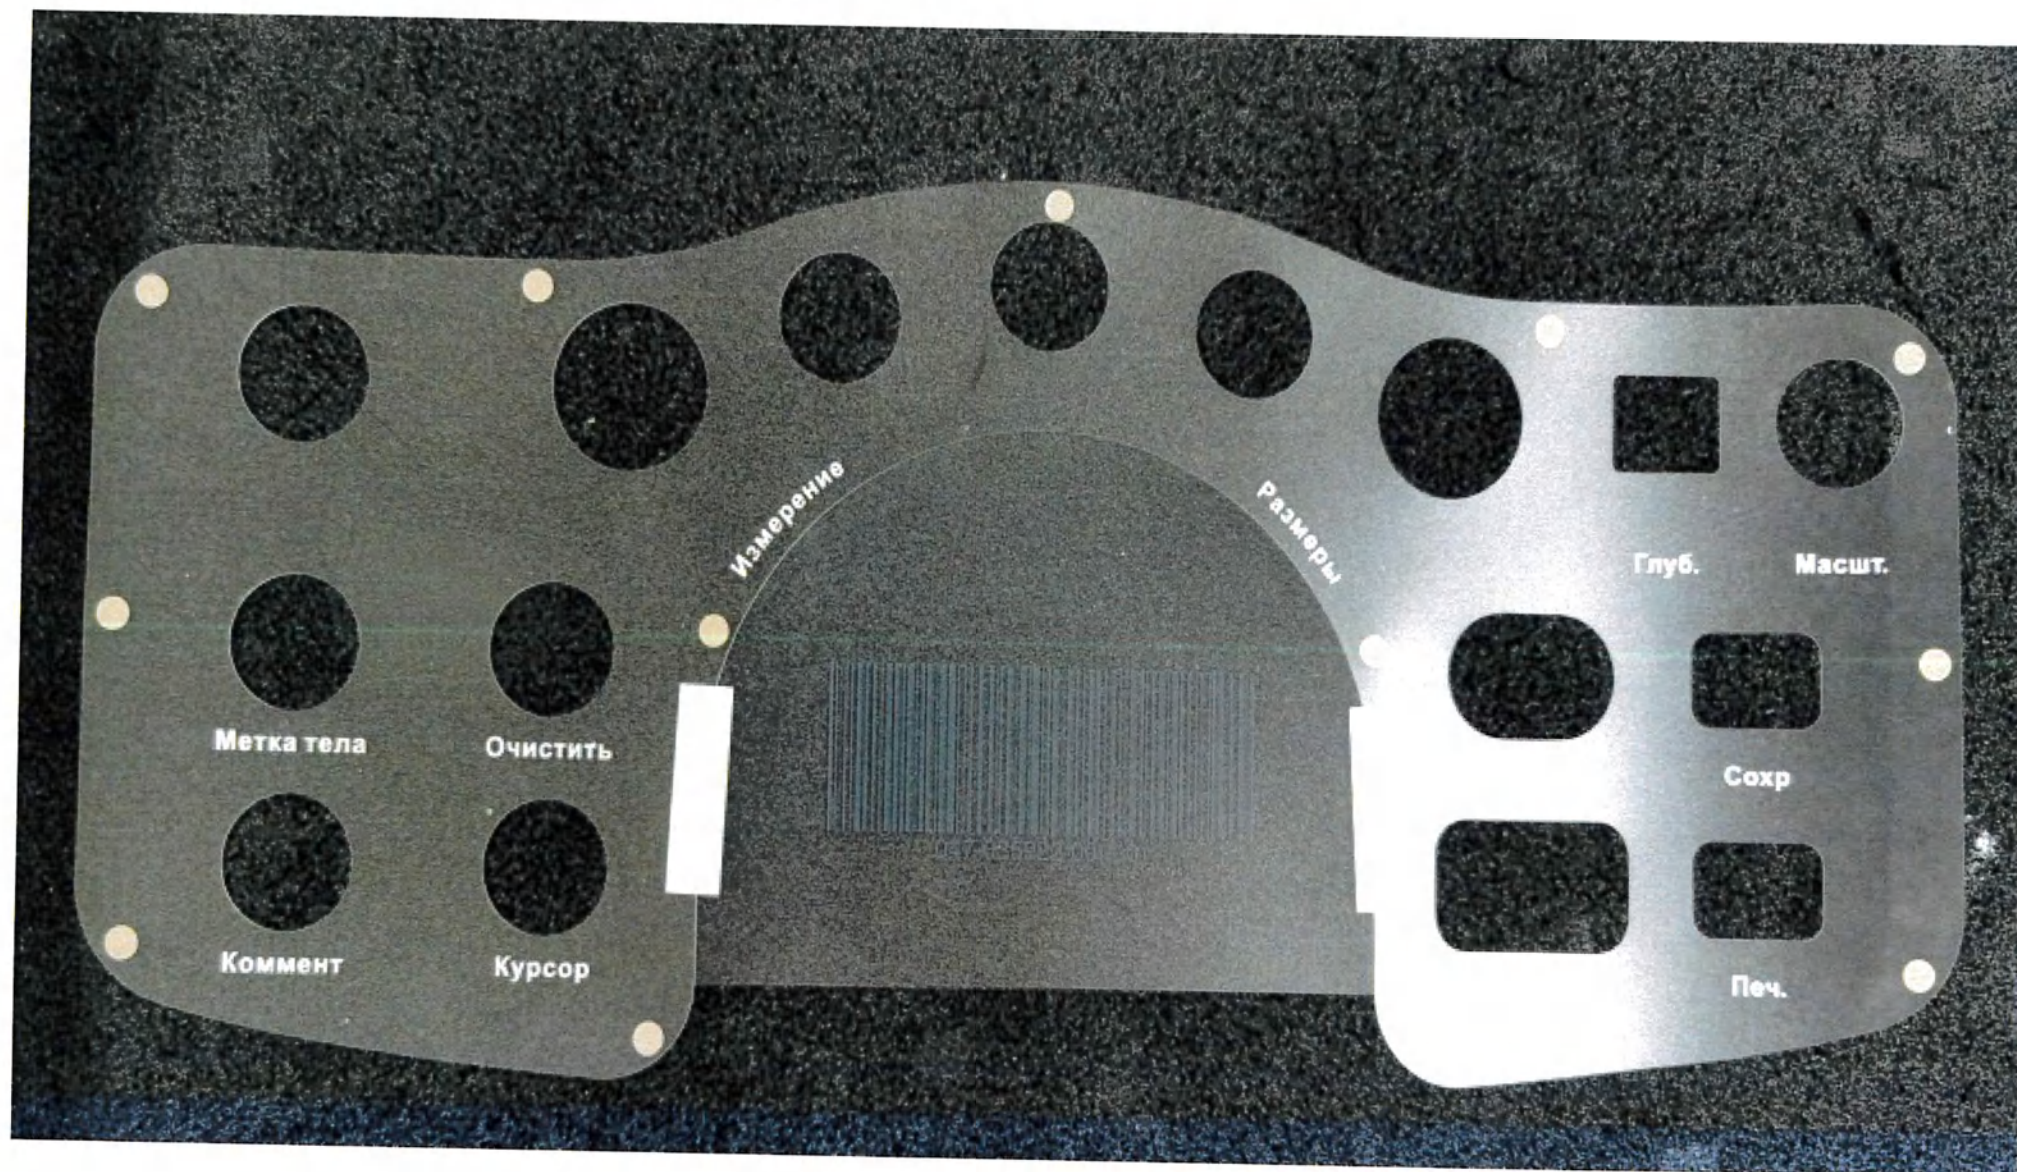

8. Штырьковый адаптер для подключения ультразвуковых датчиков портативных систем PCM-ES01

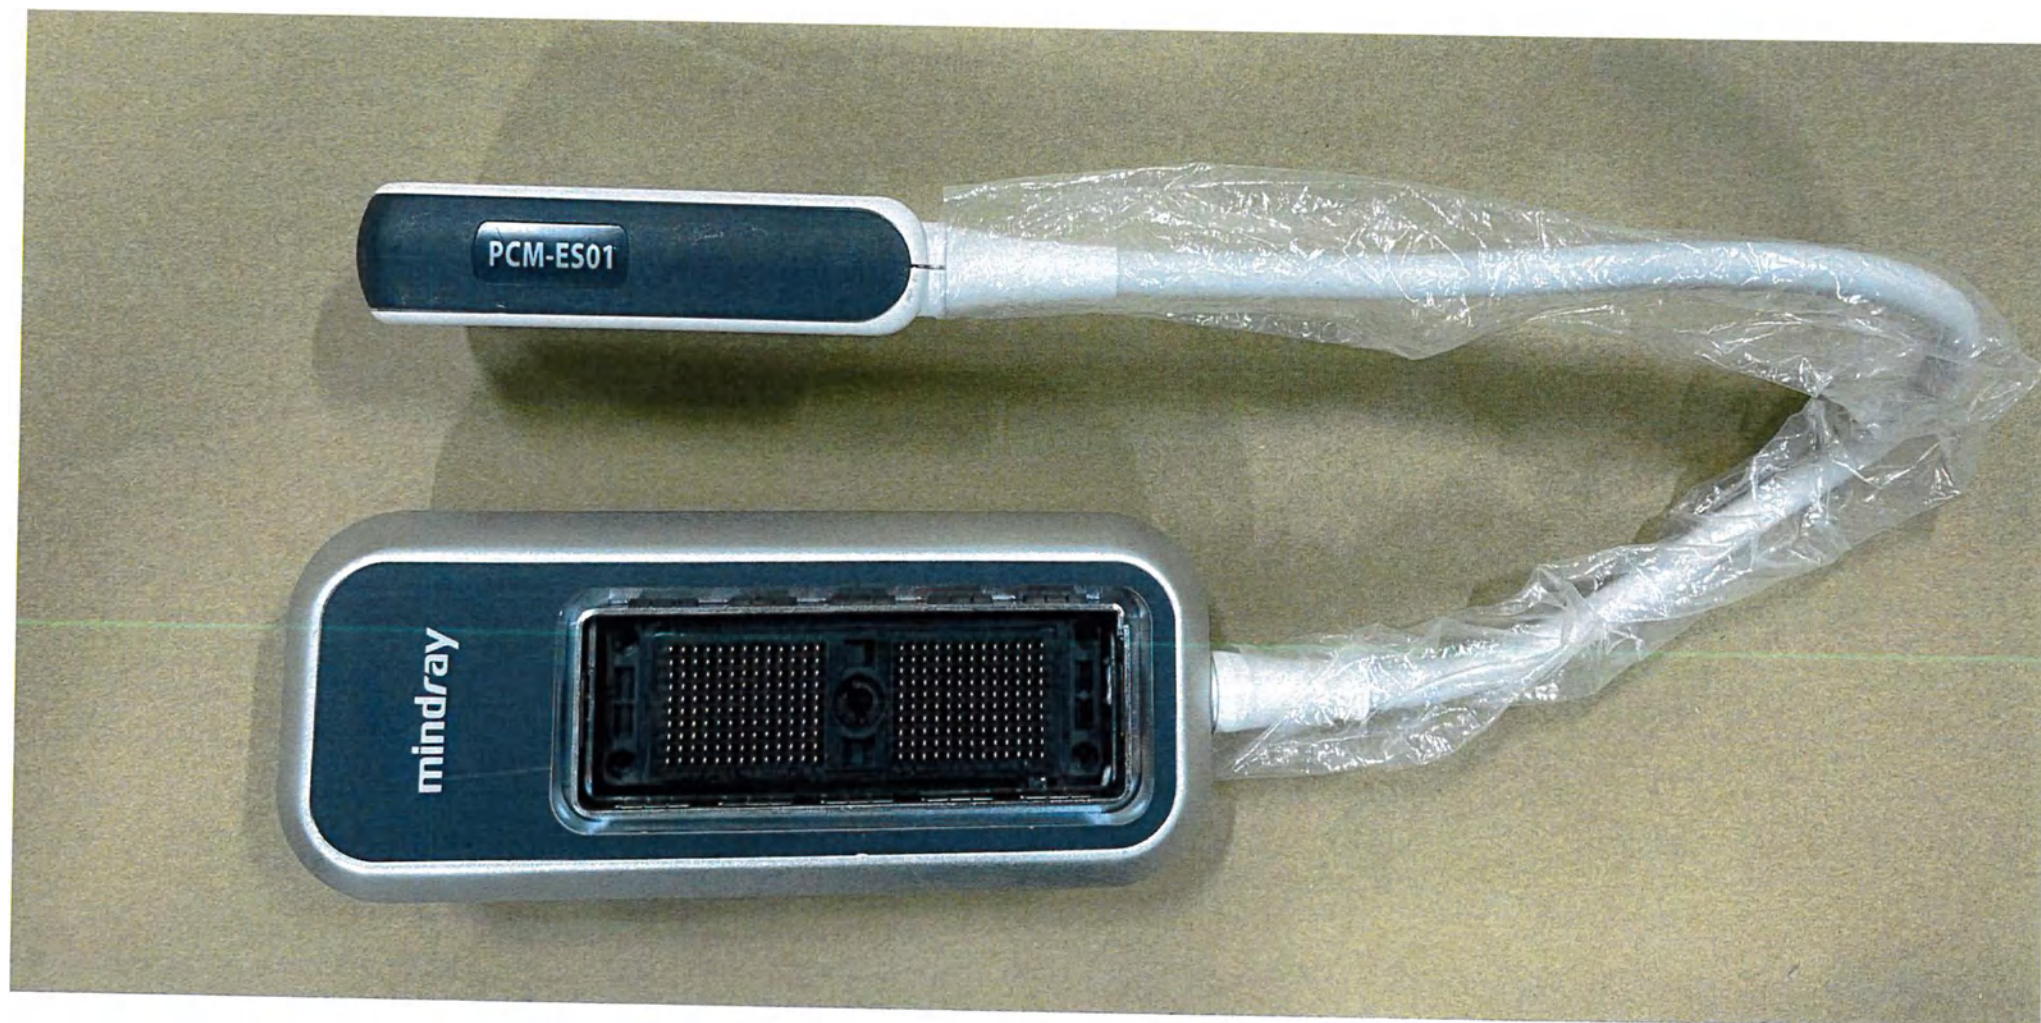

9. Беспроводной адаптер для подключения ультразвуковых датчиков портативных систем PCM-US01

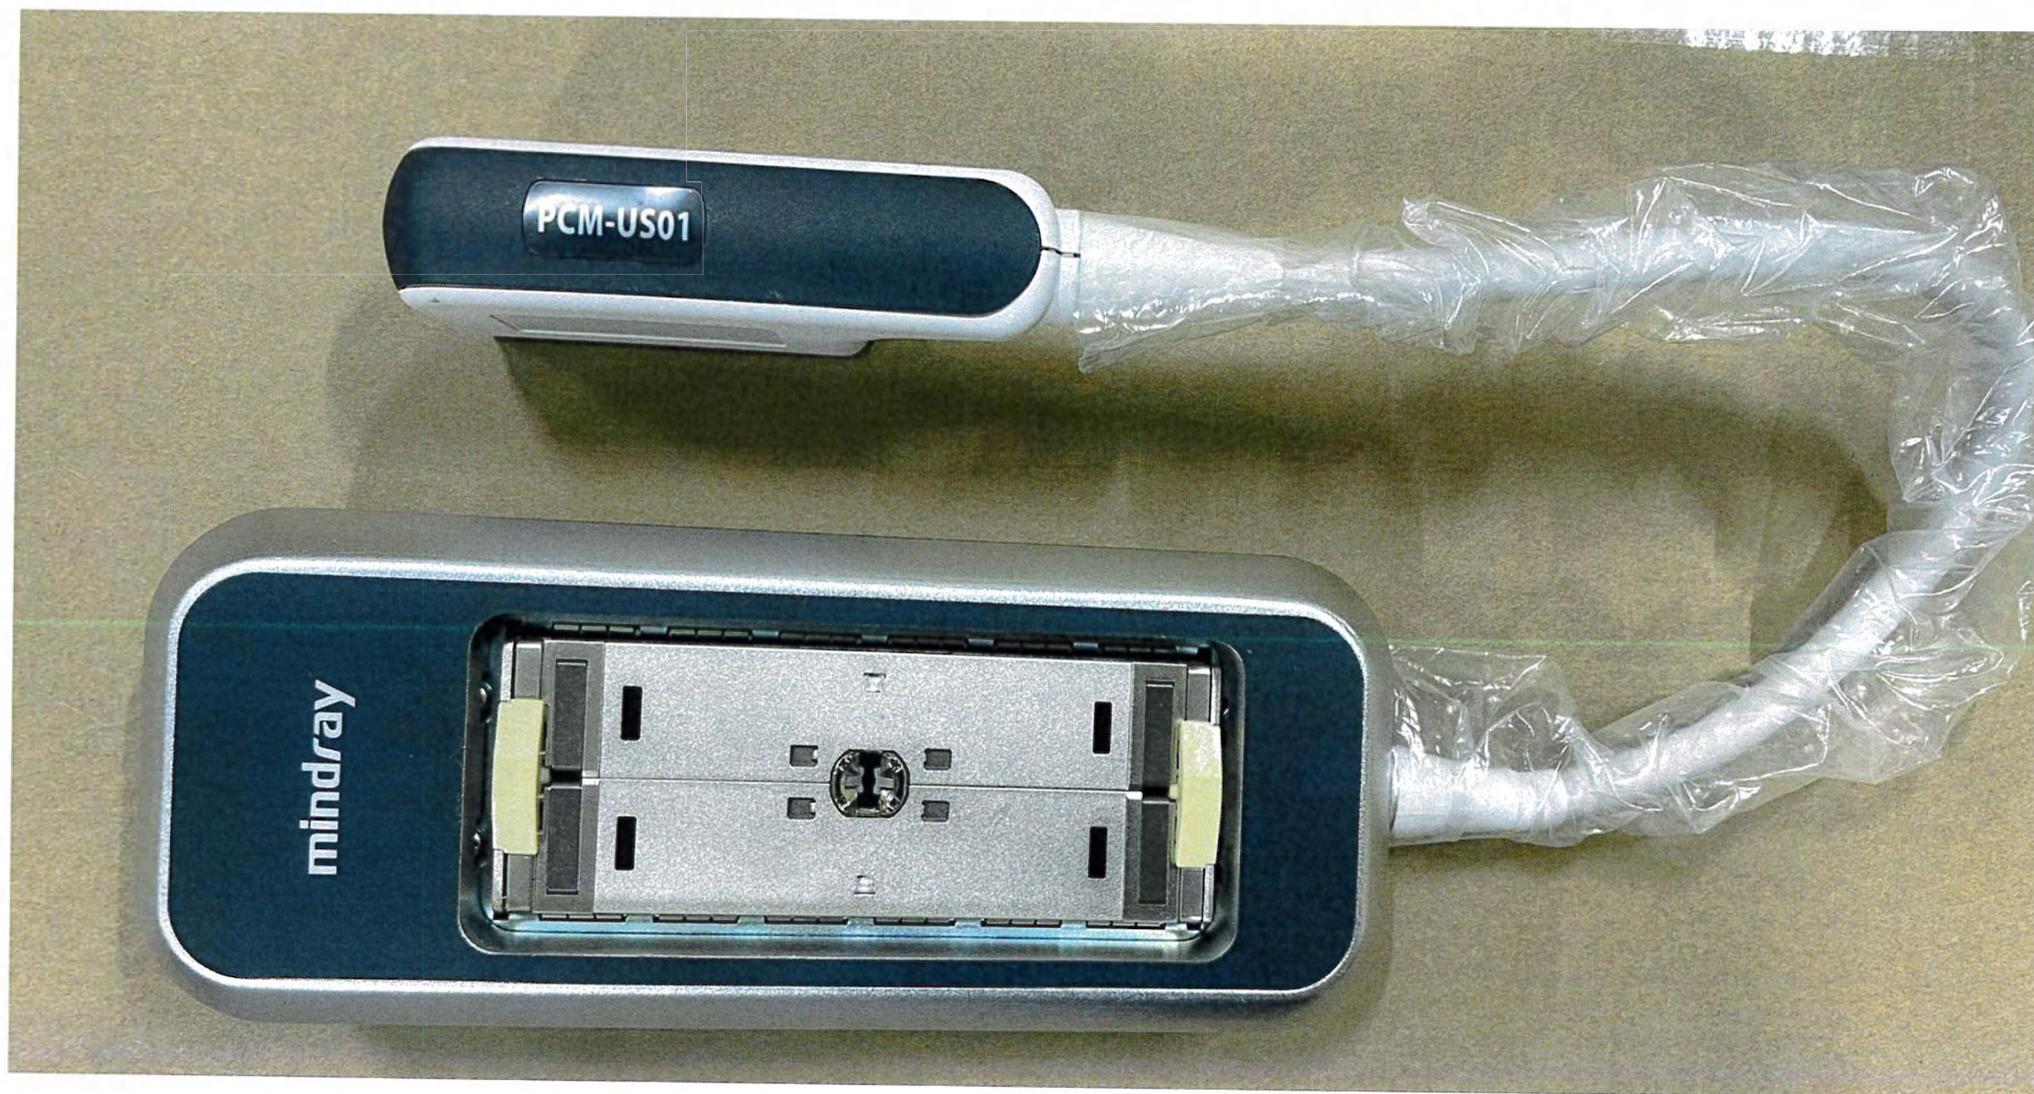

10. Клавиатура с русской раскладкой



11. Емкость для хранения



12. Держатель для карандашного датчика




13. Кабель карандашного датчика




14. Защитный колпачок для держателя геля




15. Полка для принтера

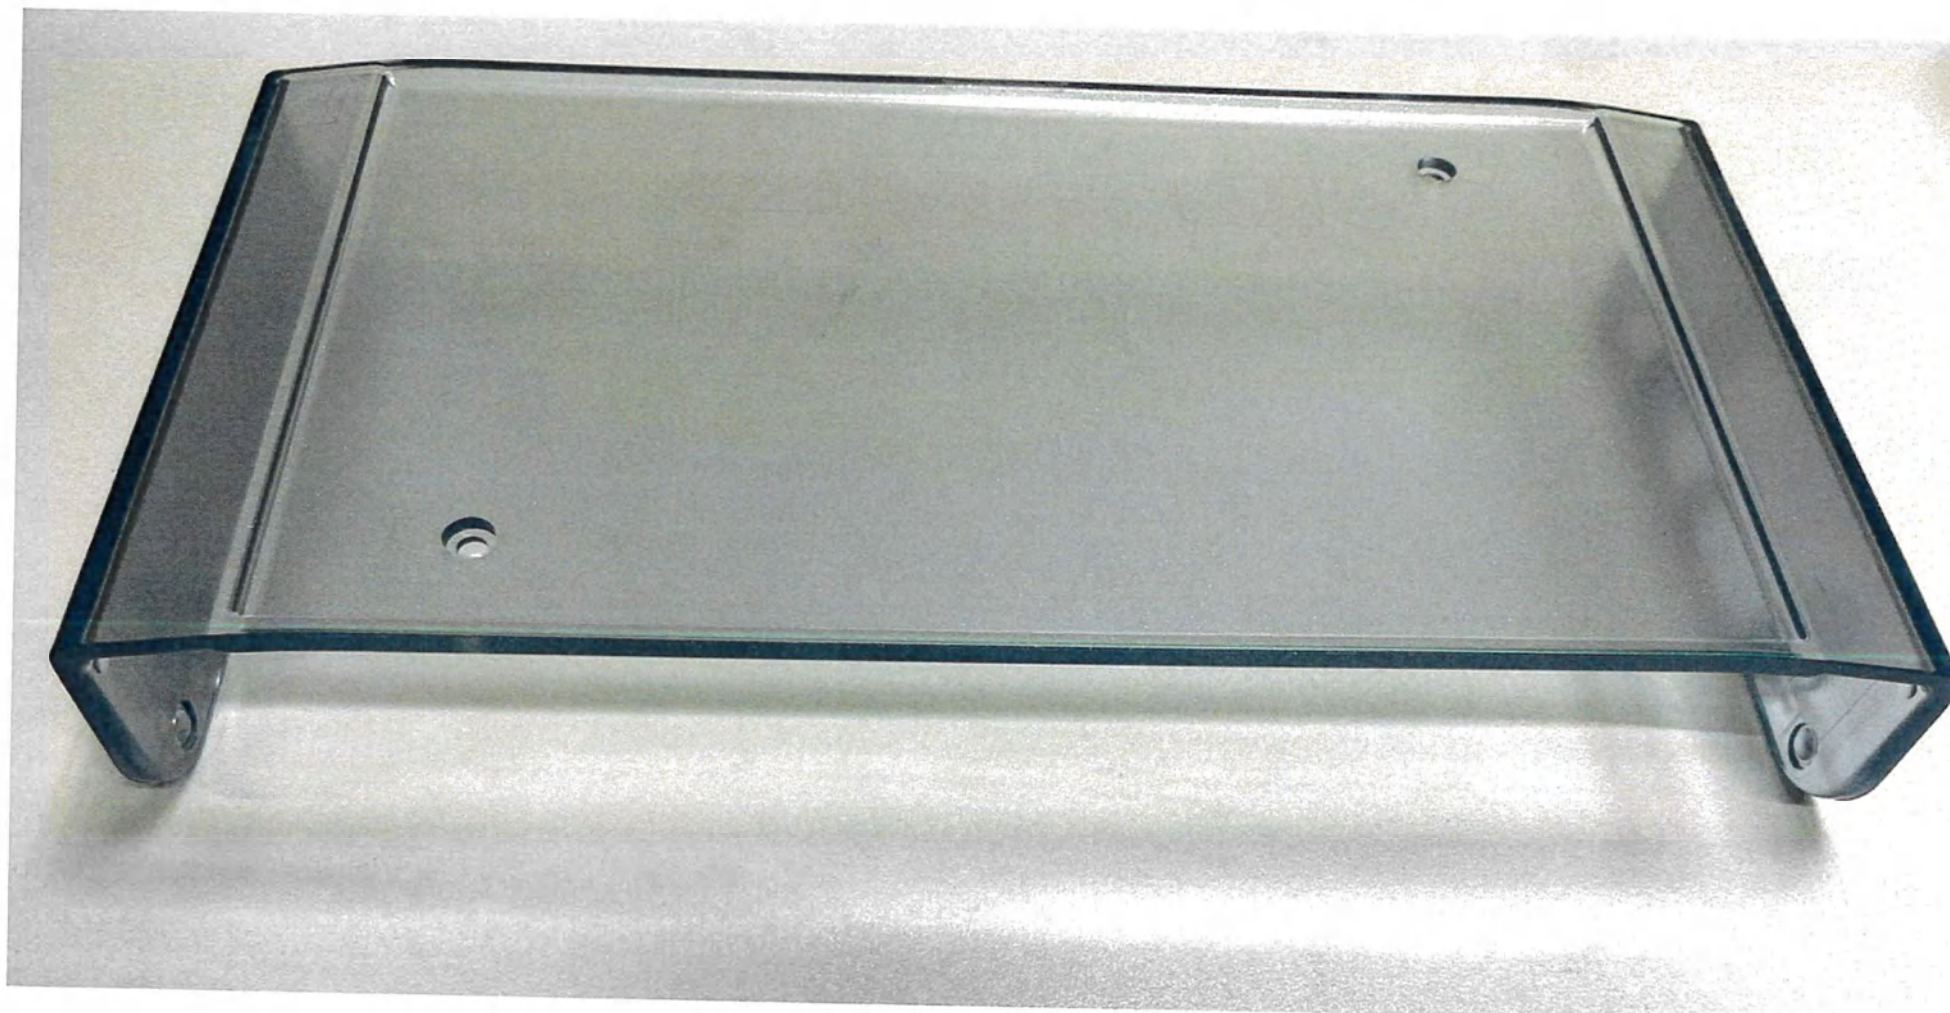

16. Защитный чехол для основного блока

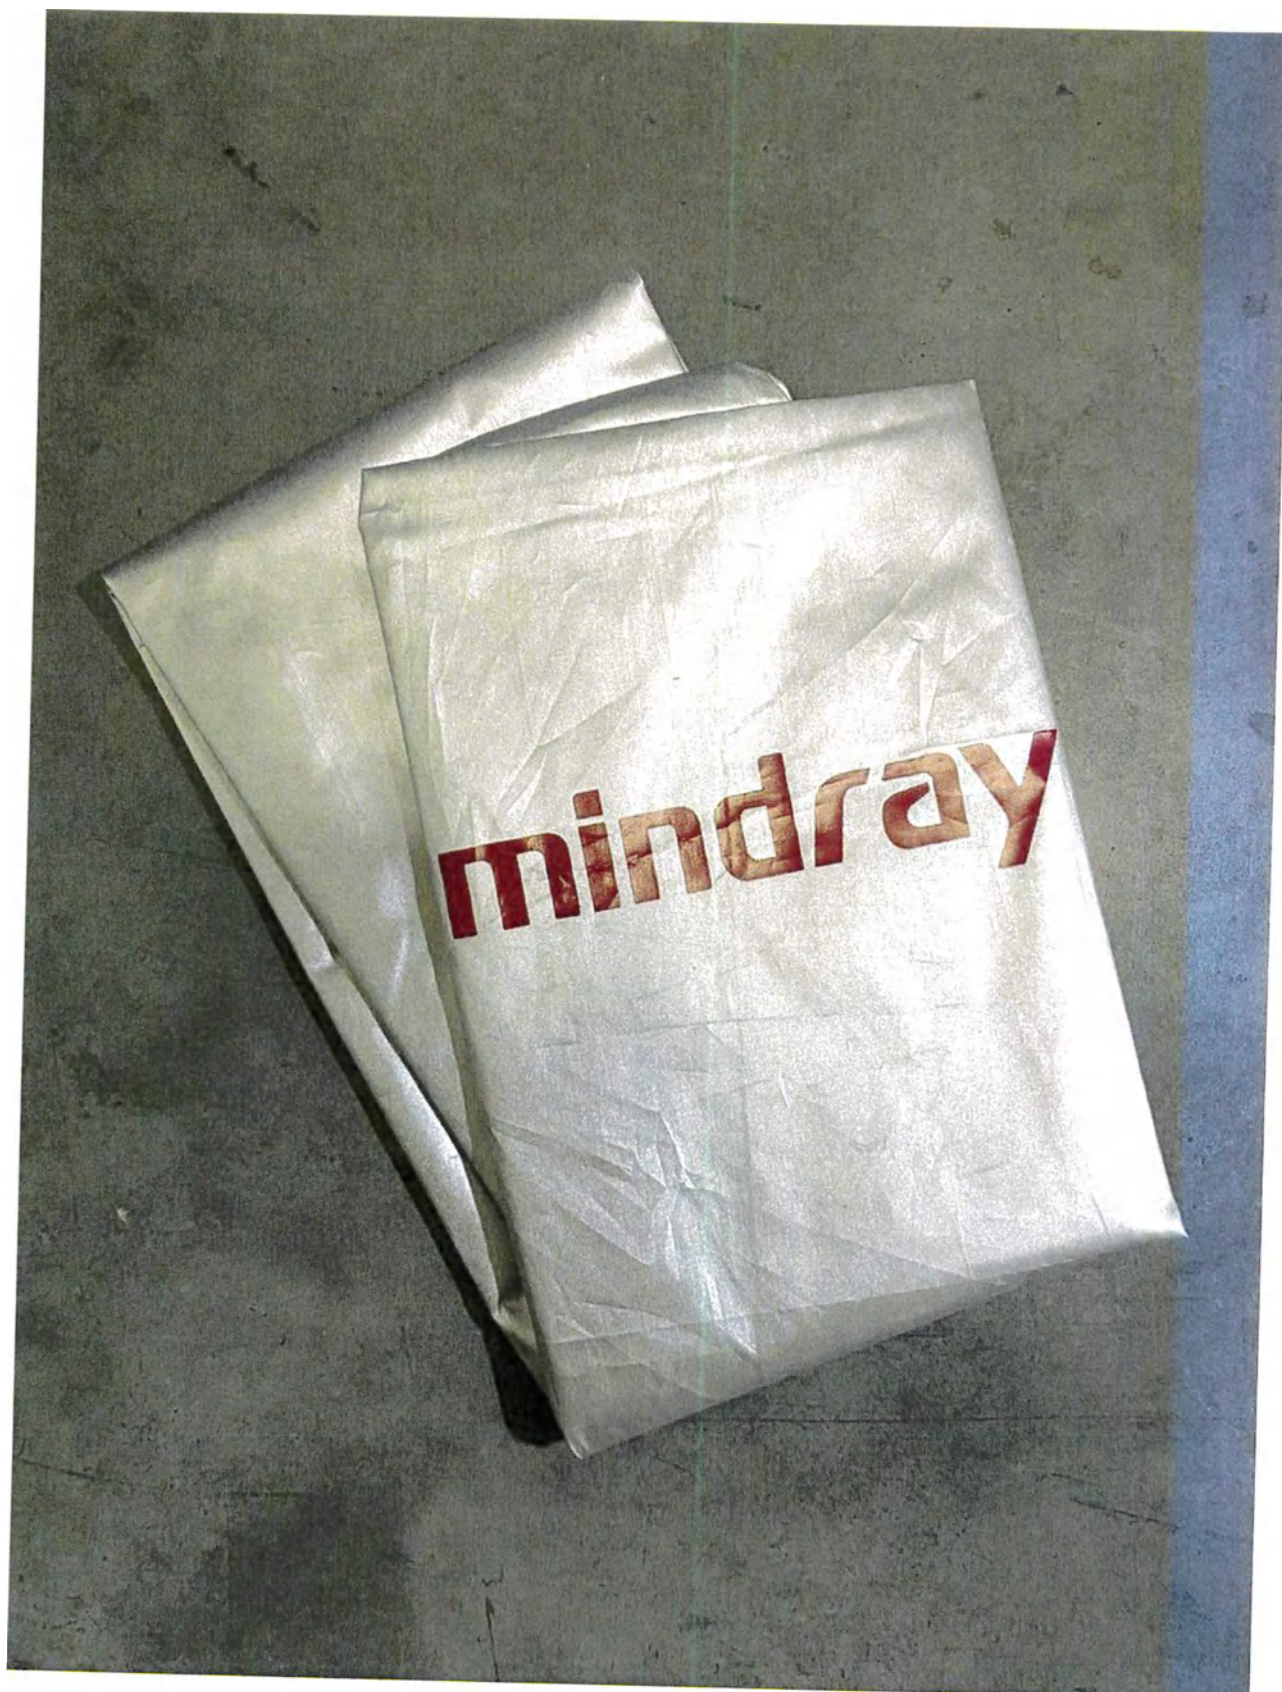

17. Пылезащитная крышка

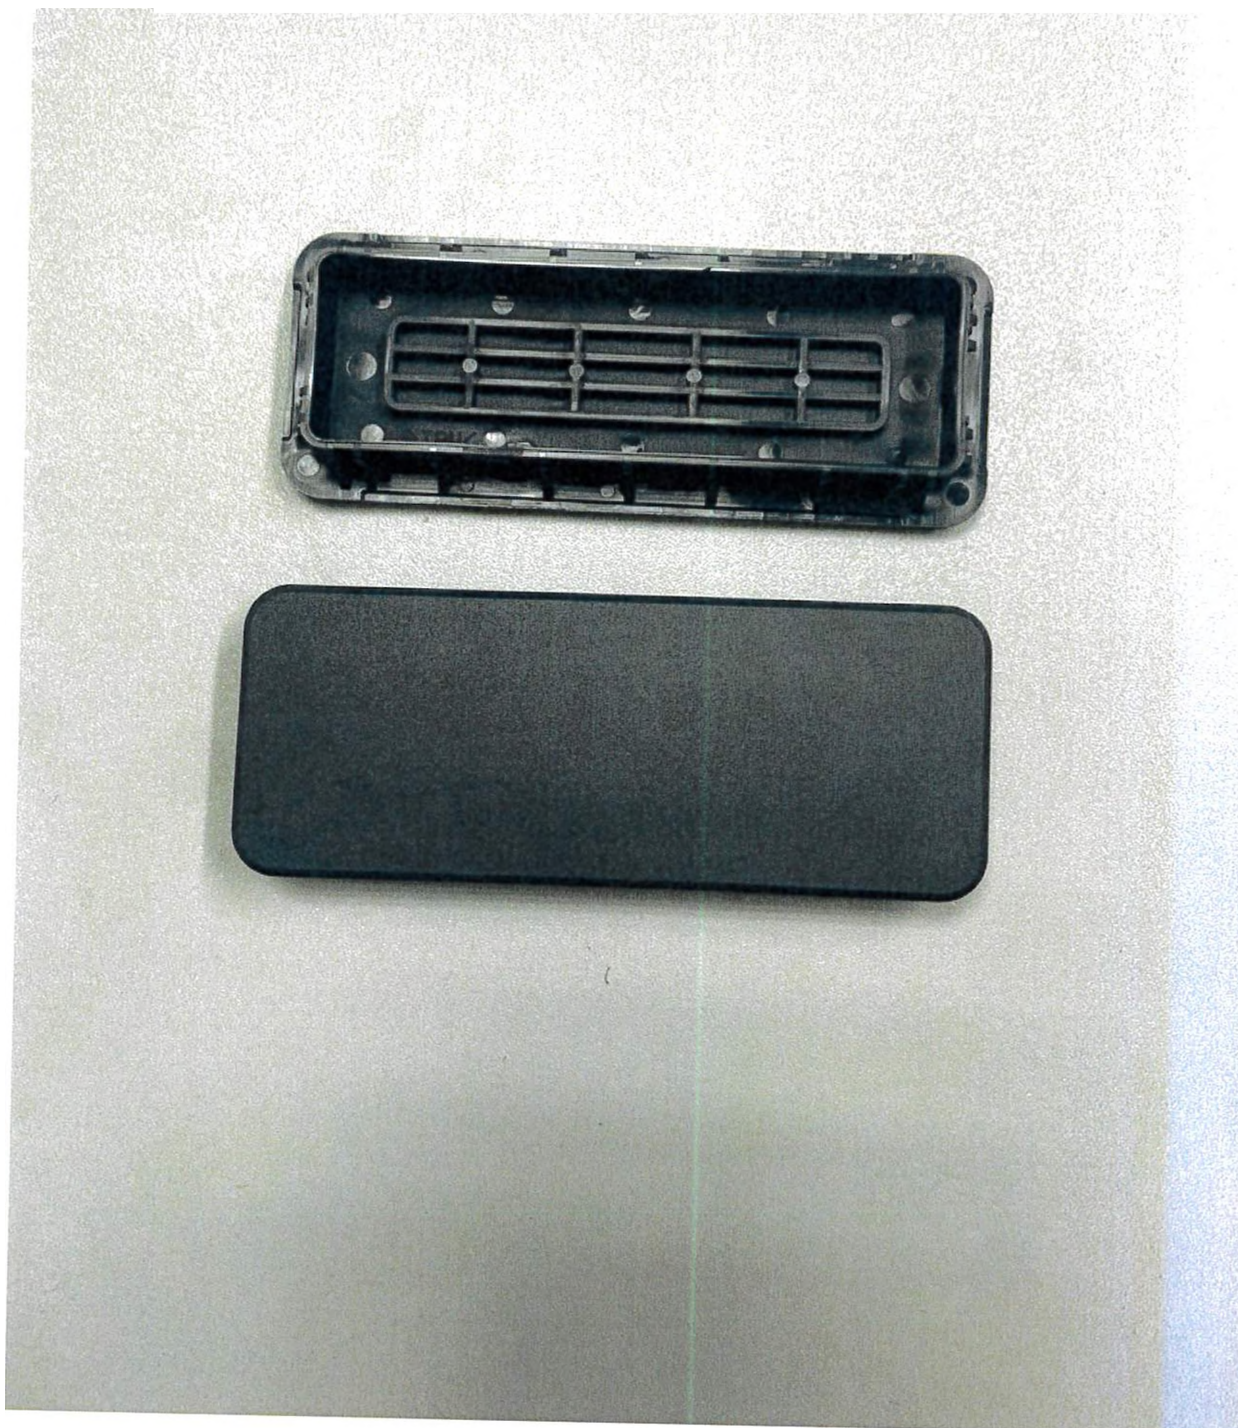

18. Саморез с цилиндрической головкой без наконечника



19. Набор для сборки DVD привода

19.1 HP USB внешний DVDRW привод




19.2 Верхняя крышка для DVD привода



19.3 Нижняя крышка для DVD привода



19.4 Прижимные прокладки DVD привода

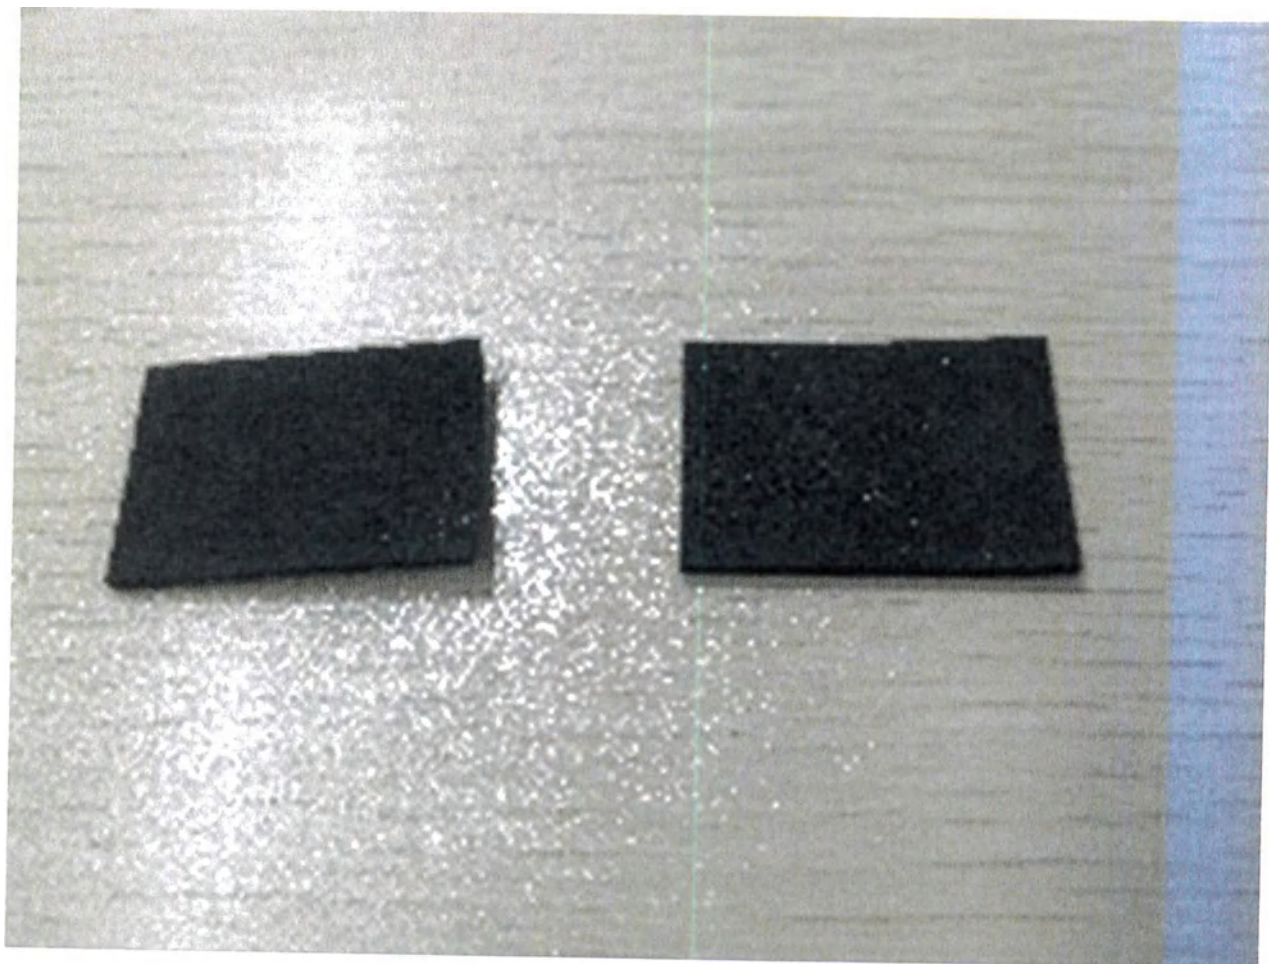


19.5 Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, М4Х12



19.6 Комбинированный болт ,М3Х8



19.7 Маркировка упаковки набора для сборки DVD привода.

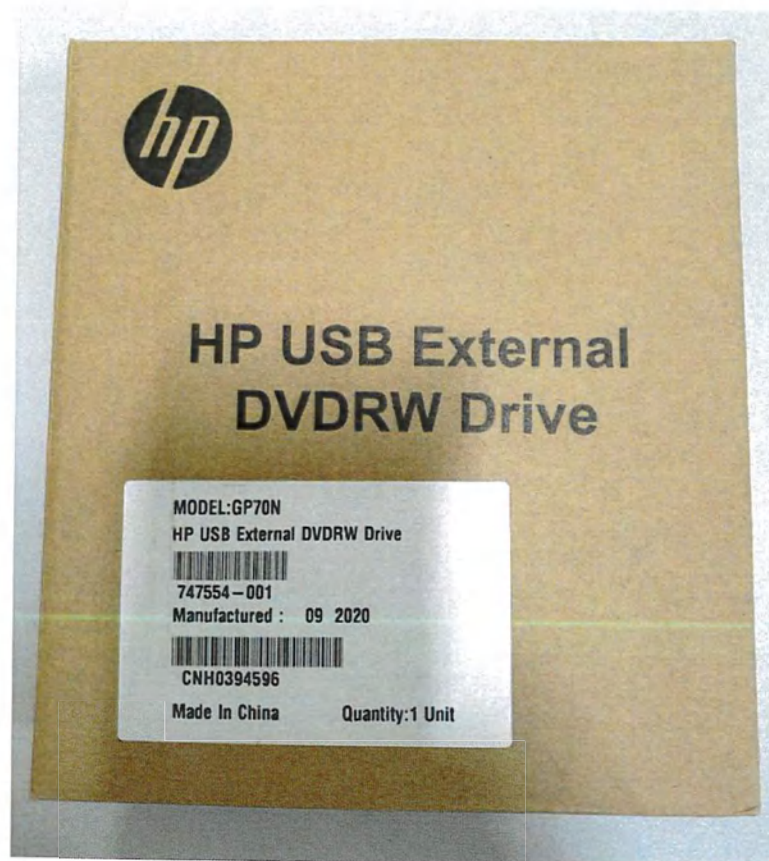

MODEL	Модель
HP USB External DVDRW Drive	HP USB внешний DVDRW привод
Manufactured	Произведено
Made in China	Сделано в Китае
Quantity	Количество


19.8 Маркировка HP USB внешнего DVDRW привода.



MODEL	Модель
HP USB External DVDRW Drive	HP USB внешний DVDRW привод
Manufactured: September 20	Произведено: Сентябрь 2020
Made in China	Сделано в Китае
Quantity	Количество

20. Модуль аккумулятора Mindray (2ч)

20.1 Модуль аккумулятора Mindray (2ч) (общий вид и маркировка)

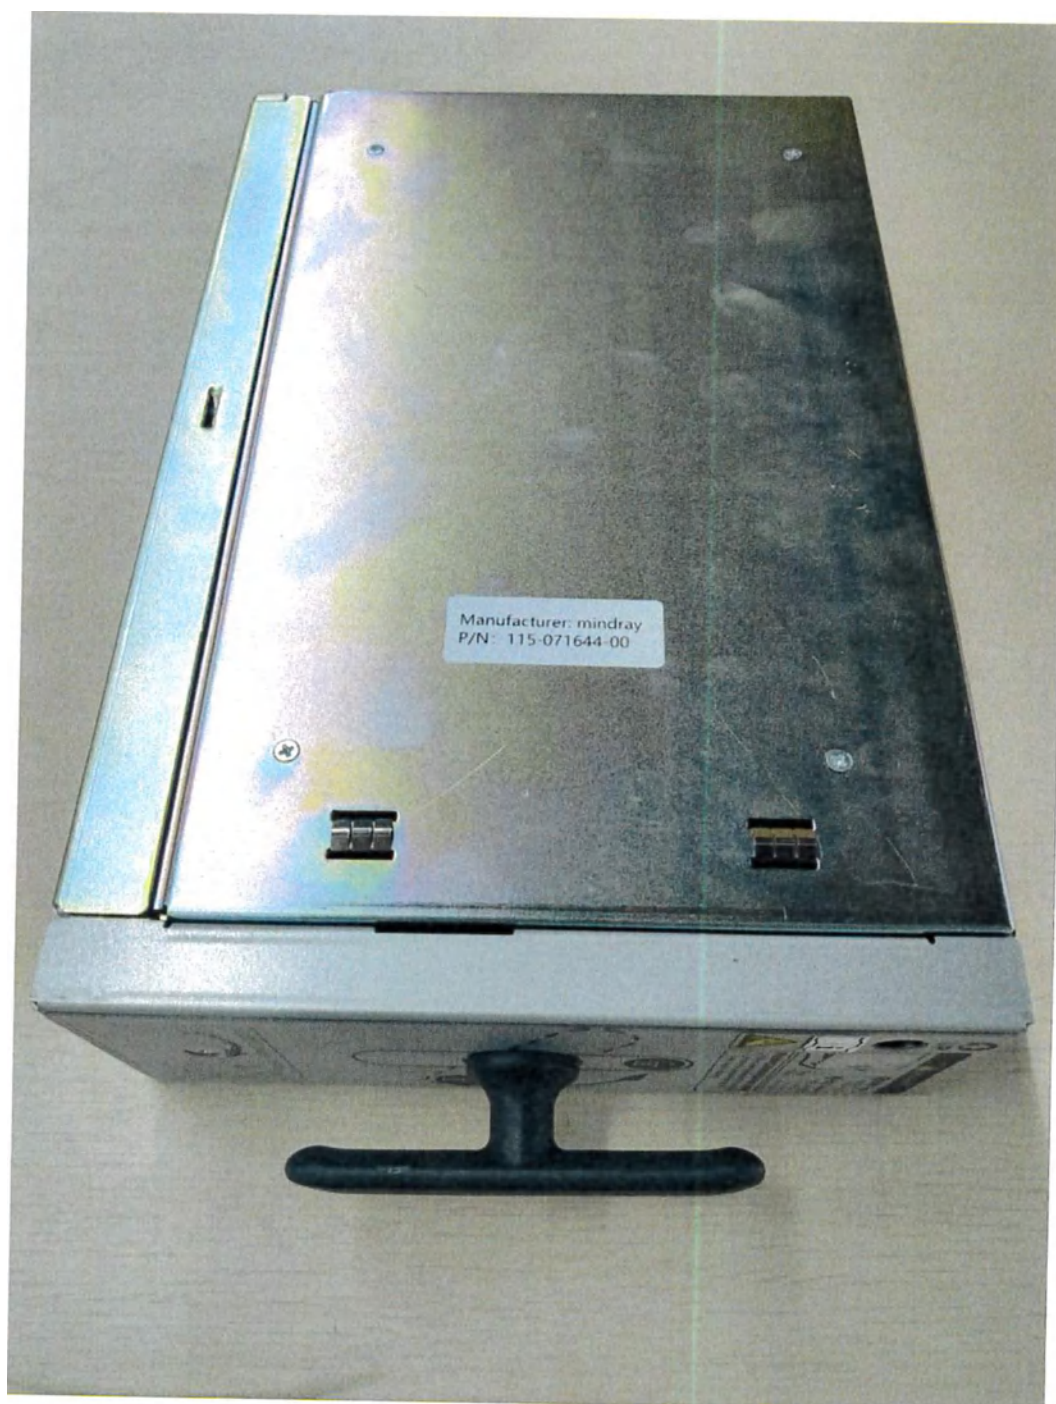



20. 2 Маркировка упаковки модуля аккумулятора Mindray (2ч)

mindray

物料描述(Name)
Module battery 2h

P / N: 
115-071644-00

Ordering No.: 
21385769.370



☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
地址:深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层
电话:(0755)26582888 传真:(0755)26582680 邮编:518057
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057 P.R. China Tel:86-755-26582888 Fax:86-755-26582680

20. Модуль аккумулятора Mindray (4ч)

20.1 Модуль аккумулятора Mindray (4ч) (общий вид и маркировка)






20. 2 Маркировка упаковки модуля аккумулятора Mindray (4ч)

mindray

物料描述(Name):
Module battery 4h

P / N: 
115-067409-00

Ordering No.: 
21385769.370




深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
地址:深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层
电话:(0755)26582888 传真:(0755)26582680 邮编:518057
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan.
Shenzhen, 518057 P.R. China Tel:86-755-26582888 Fax:86-755-26582680

Name: Module battery 4h Mindray

Наименование: Модуль аккумулятора
Mindray (4ч)

22. Бокс для устройства магнитной навигации (контроллера)

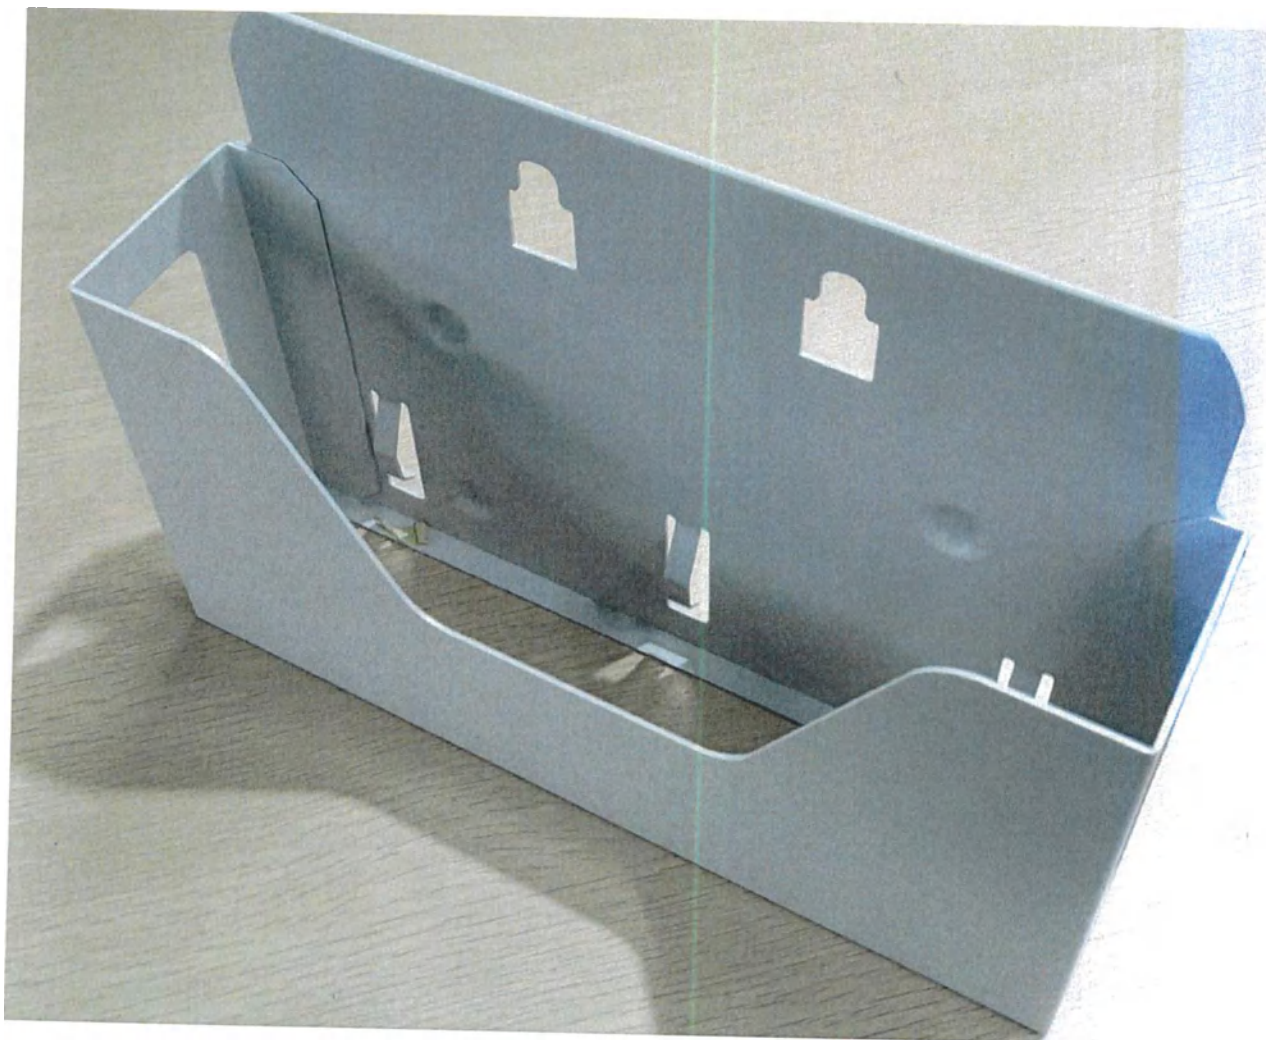

23. Держатель для полотенец




24. Чаша подогревателя геля



25. Держатель подогревателя геля, в составе:


1. Держатель подогревателя геля; 2. Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, М4Х12

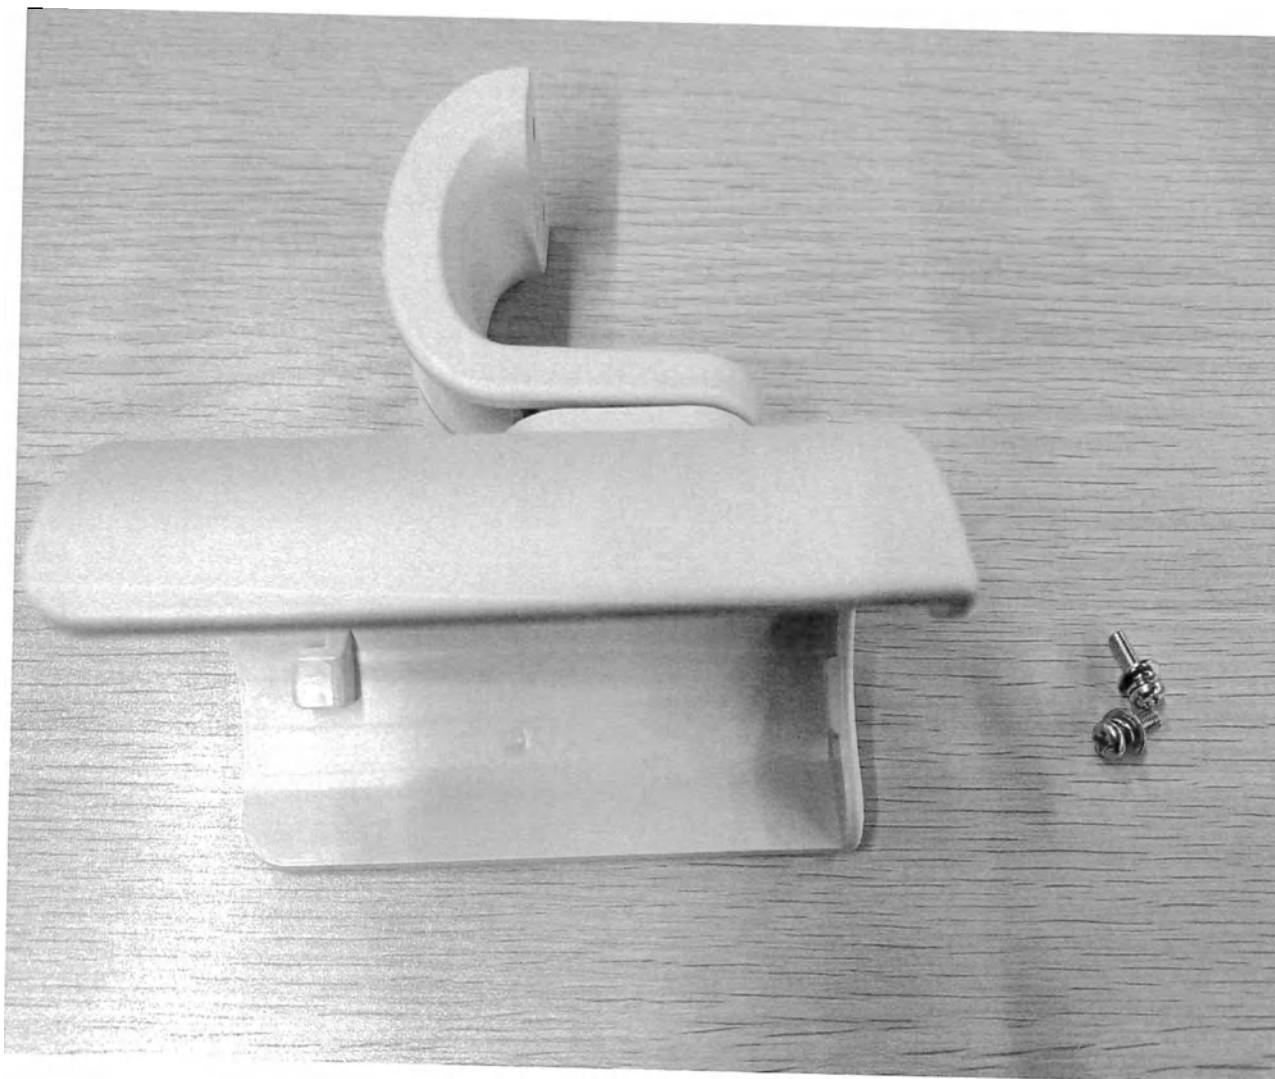

26. Плата постоянно-волнового доплера



27. Плата 4D/TEE

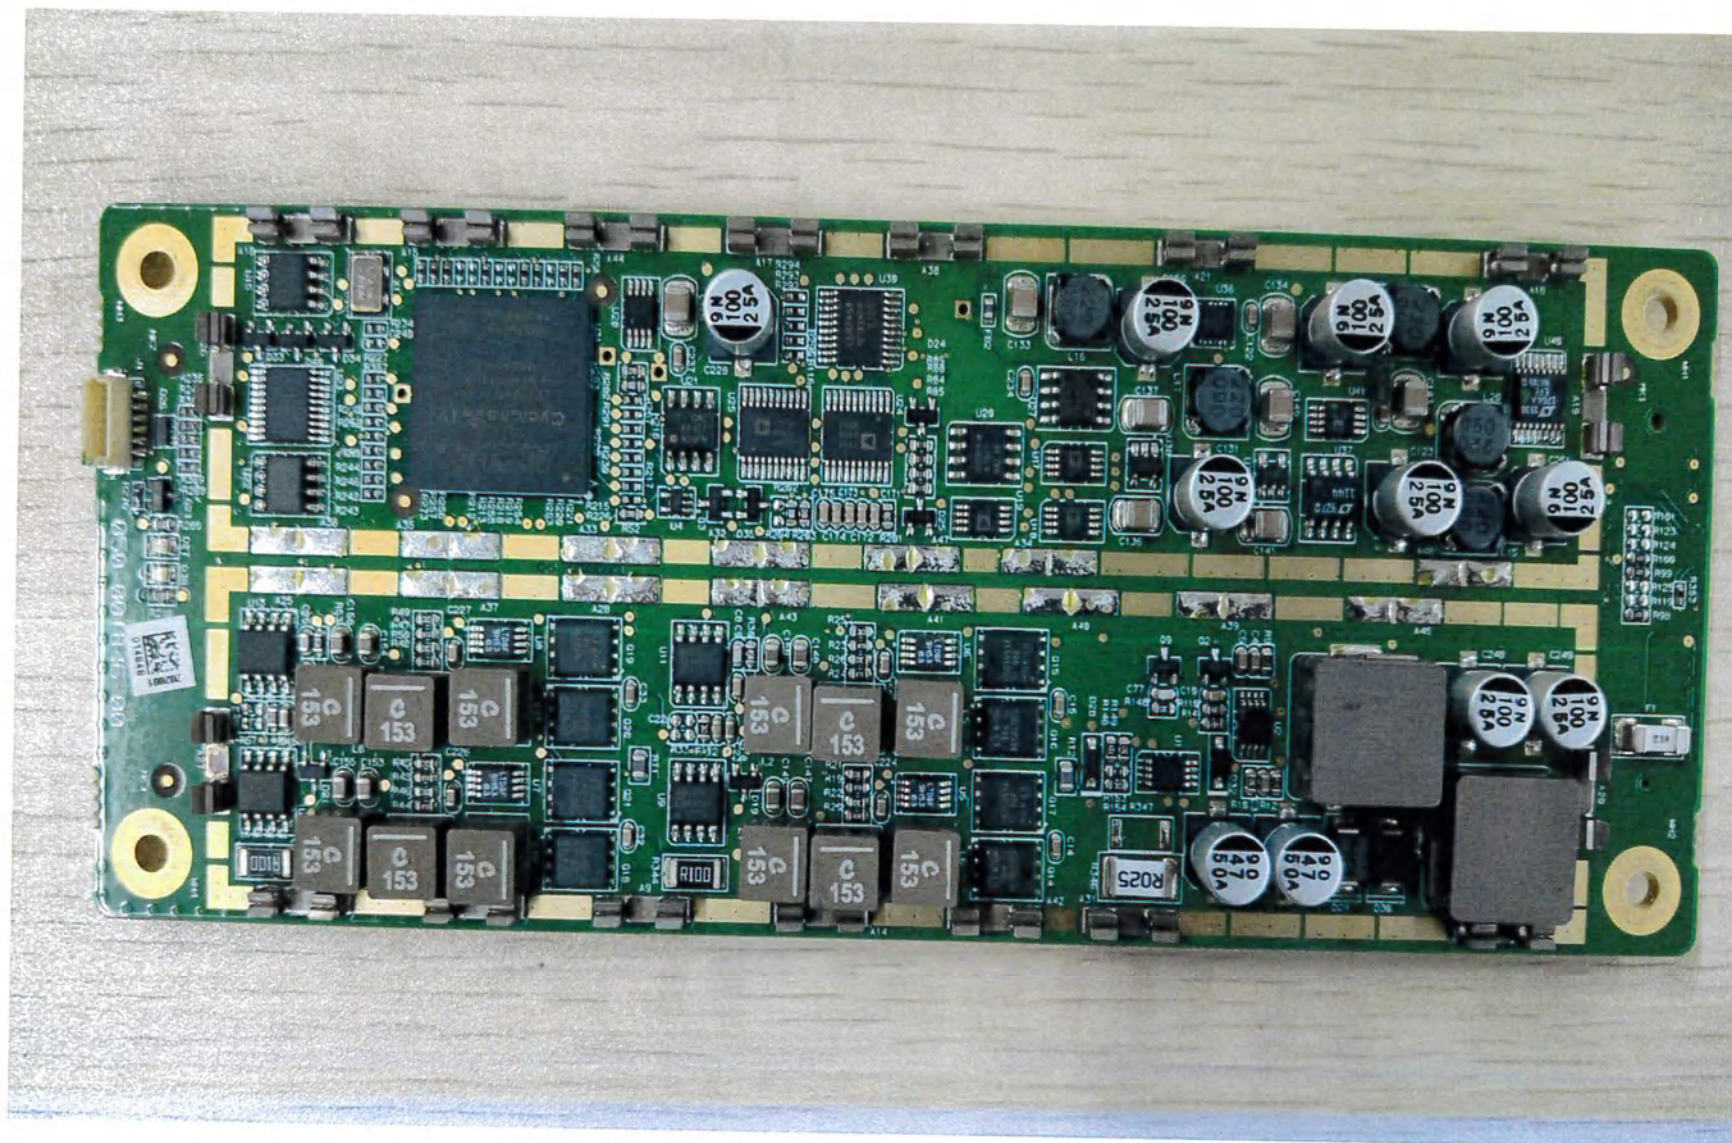

28. Карта модуля WiFi


28.1 Модуль WiFi



28.2 Кожух



28.3 Антенна двухдиапазонная

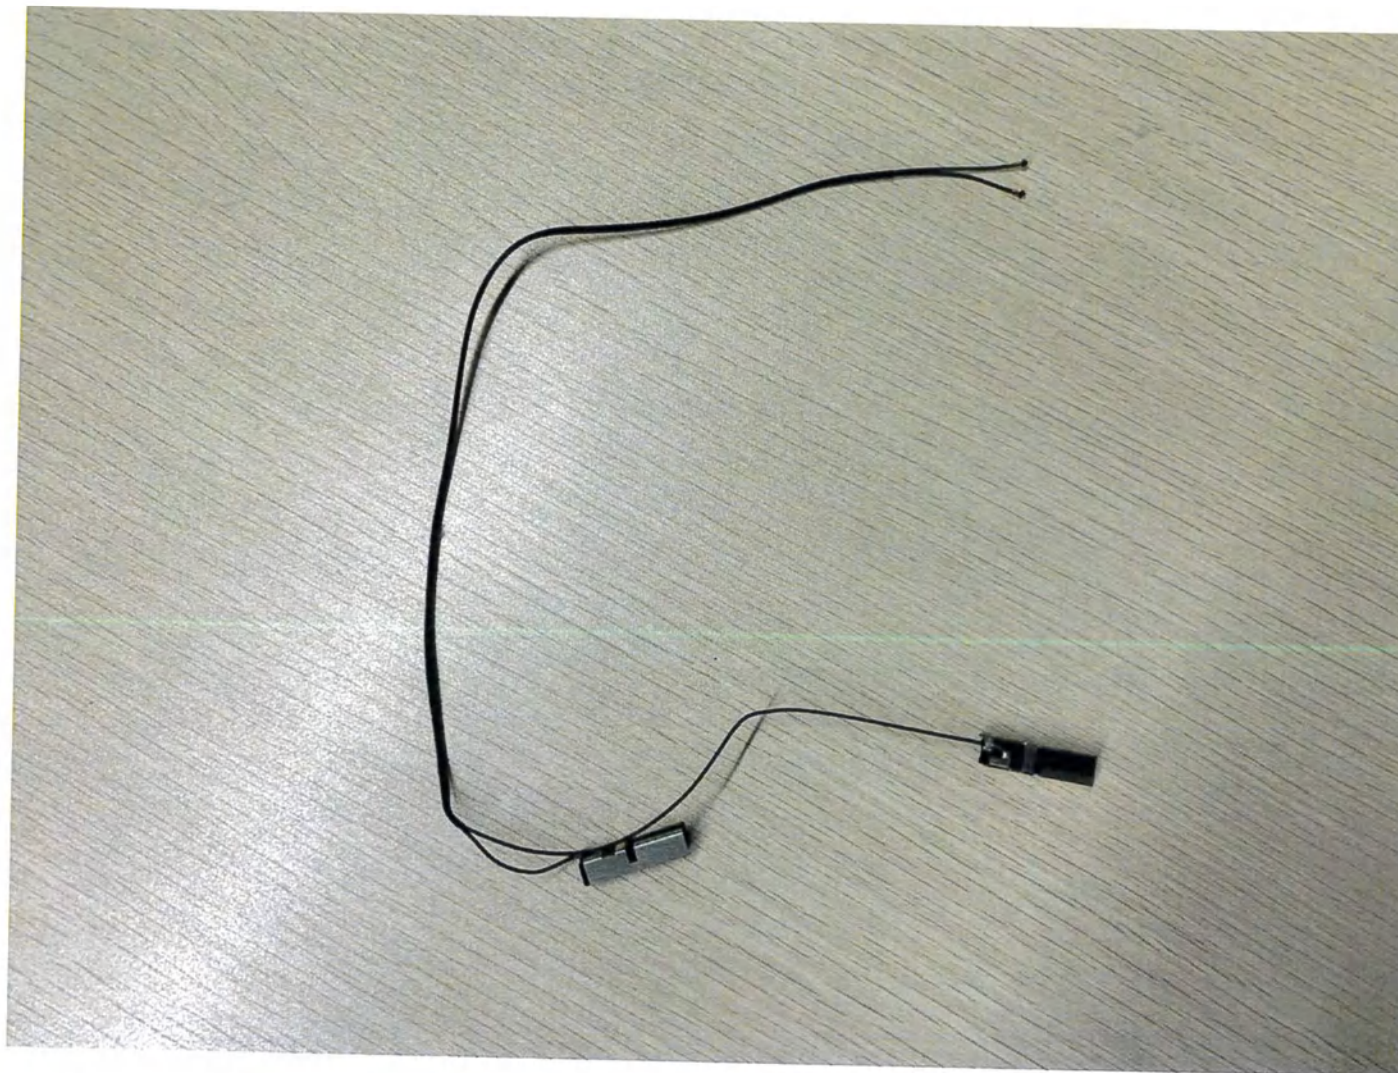

28.4 Винт крепежный



29. Держатель датчика
29.1 Опора датчика



29.2 Крепление держателя датчика



29.3 Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, М4Х12



30. Аппаратный ключ для опции iClear+Dongle



31. Комплект устройств для совмещенной ультразвуковой визуализации NDI

31.1 Генератор магнитного поля



31.2. Устройство магнитной навигации 3D Guidance trakSTAR (коннектор).



31.3. Датчик для совмещенной ультразвуковой визуализации.




31.4 Кабель питания




31.5 USB кабель передачи данных



31.6 Кабель для COM-порта (серийного порта)

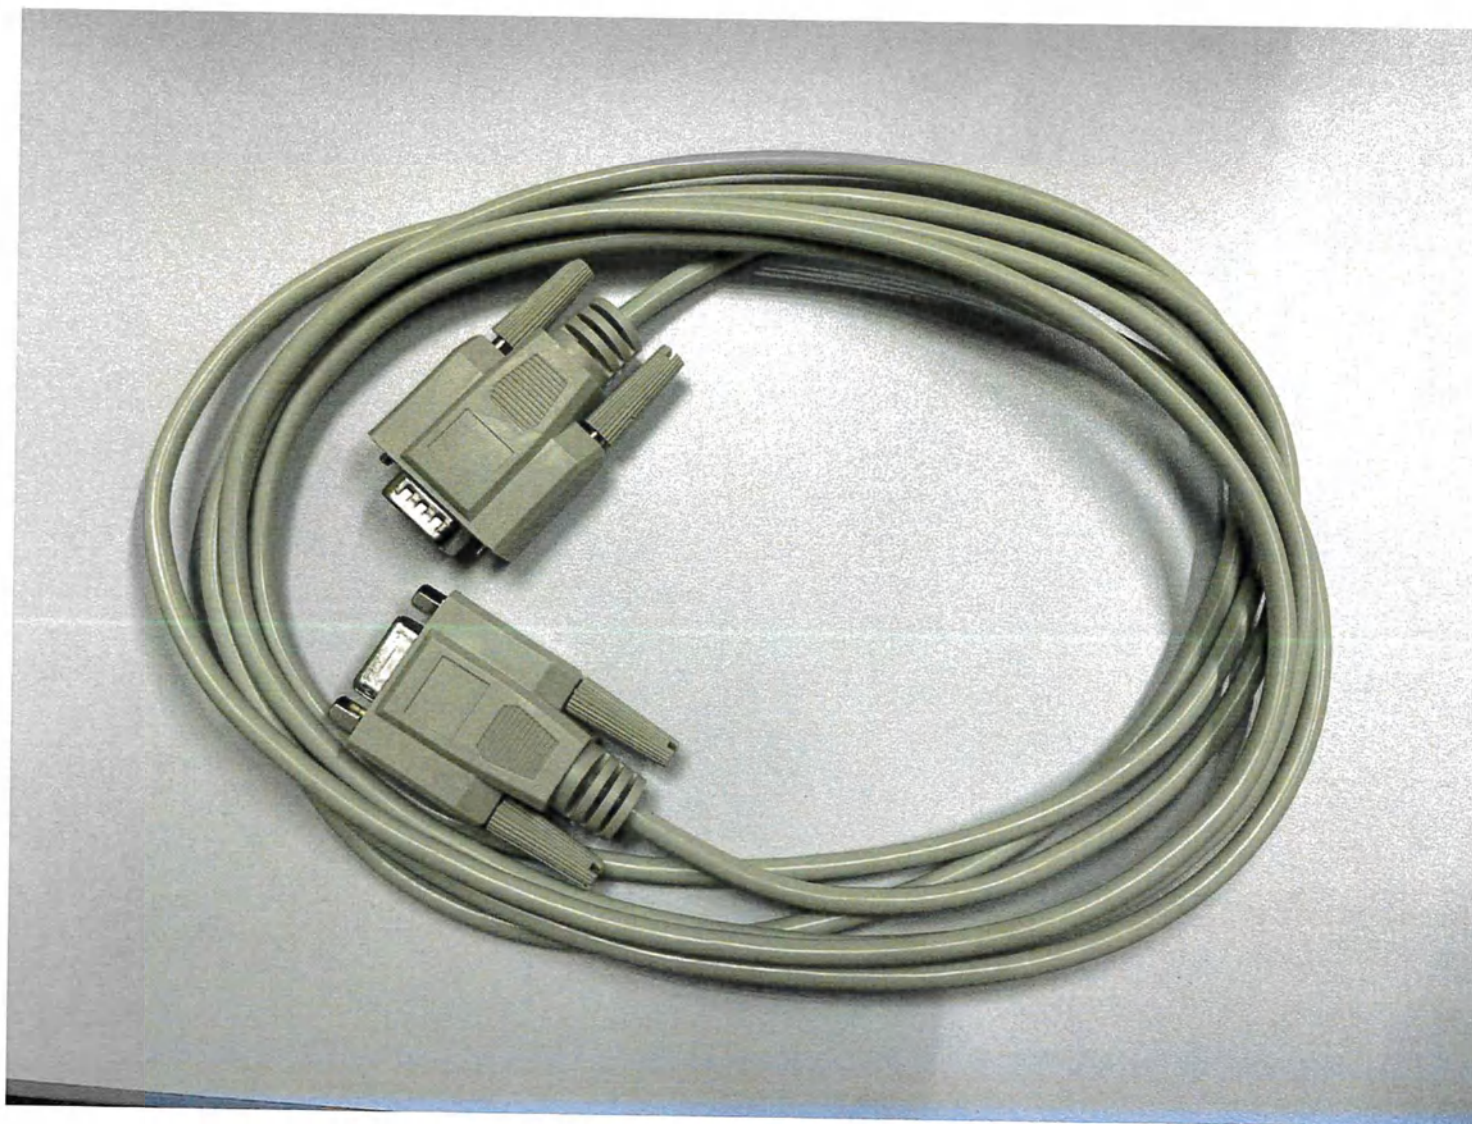

31.7 CD-диск с драйвером

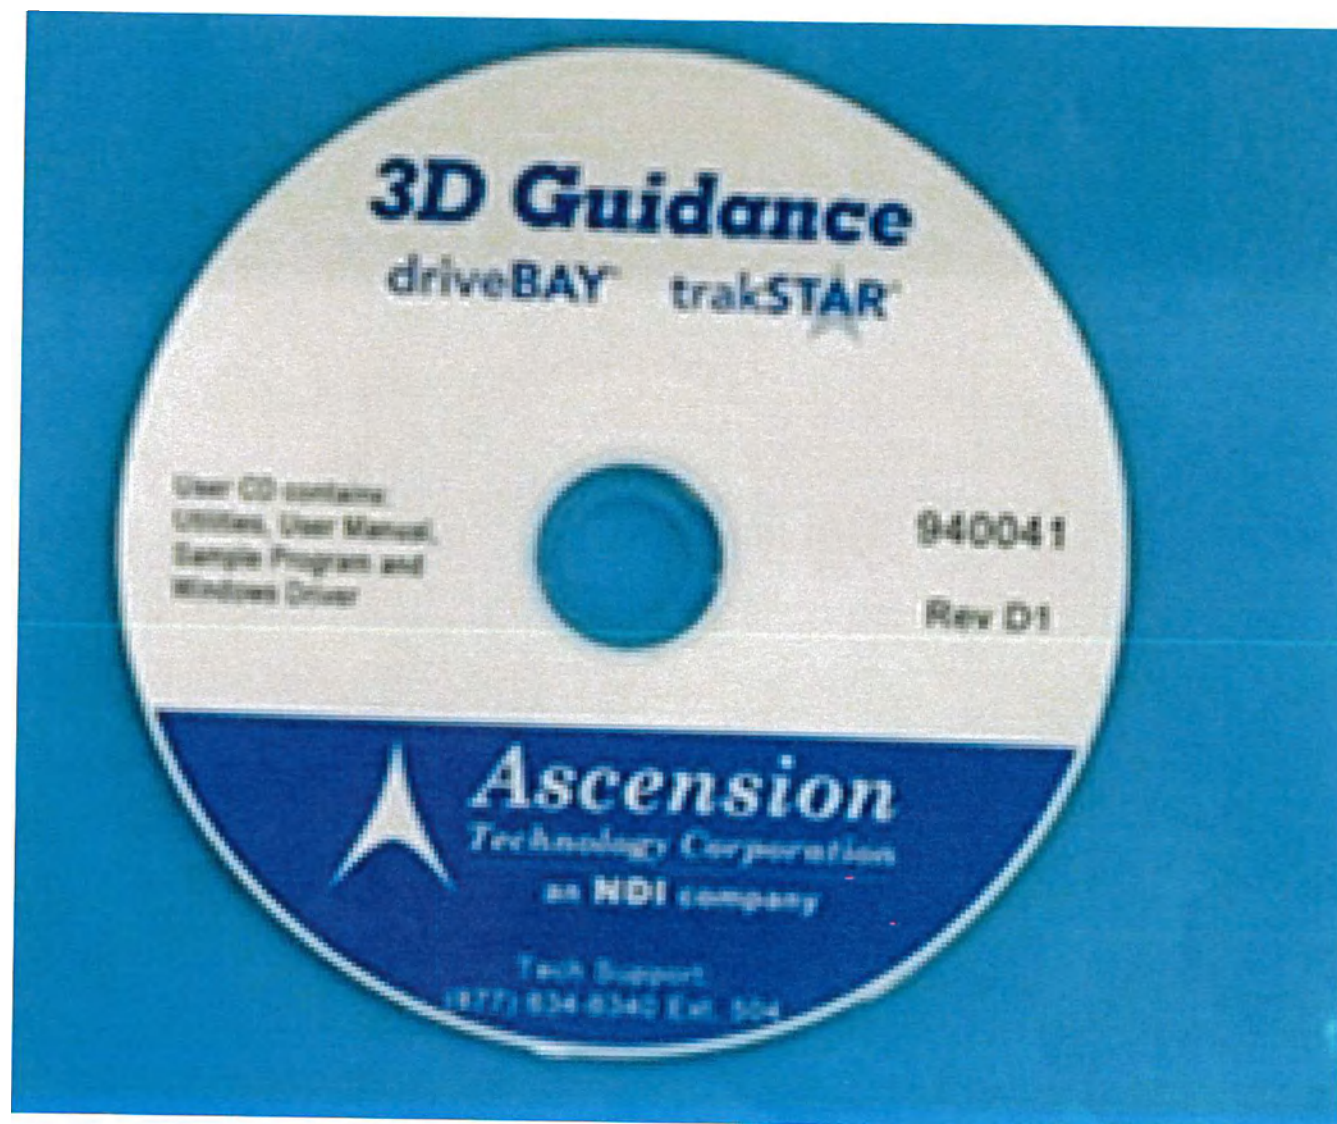

31.8 Держатель абдоминального датчика движения.



31.9 Маркировка упаковки комплекта устройств для совмещенной ультразвуковой визуализации NDI.

NAME :Set of devices for combined ultrasound imaging NDI		Qty : 1
W#:	 93975152	BOX OF
Ordering No:	 21385769.370	
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China Tel:+86-755-56582888 Fax:+86-755-26582680	

**Name: Set of devices for combined
ultrasound imaging NDI**

**Наименование: Комплект устройств
для совмещенной ультразвуковой
визуализации NDI**

31.10 Маркировка генератора магнитного поля.



31.11 Маркировка устройства магнитной навигации 3D Guidance trakSTAR.



31.12 Маркировка датчика для совмещенной ультразвуковой визуализации наносится на упаковку. Данная маркировка.



31.13 Маркировка кабеля питания.





31.14 Маркировка USB кабеля передачи данных.



31.15 Маркировка кабеля для COM-порта.



32. Тележка для генератора магнитного поля


32.1 Основа крепления тележки на колесах




32.2 Плечо в сборе



32.3 Штатив

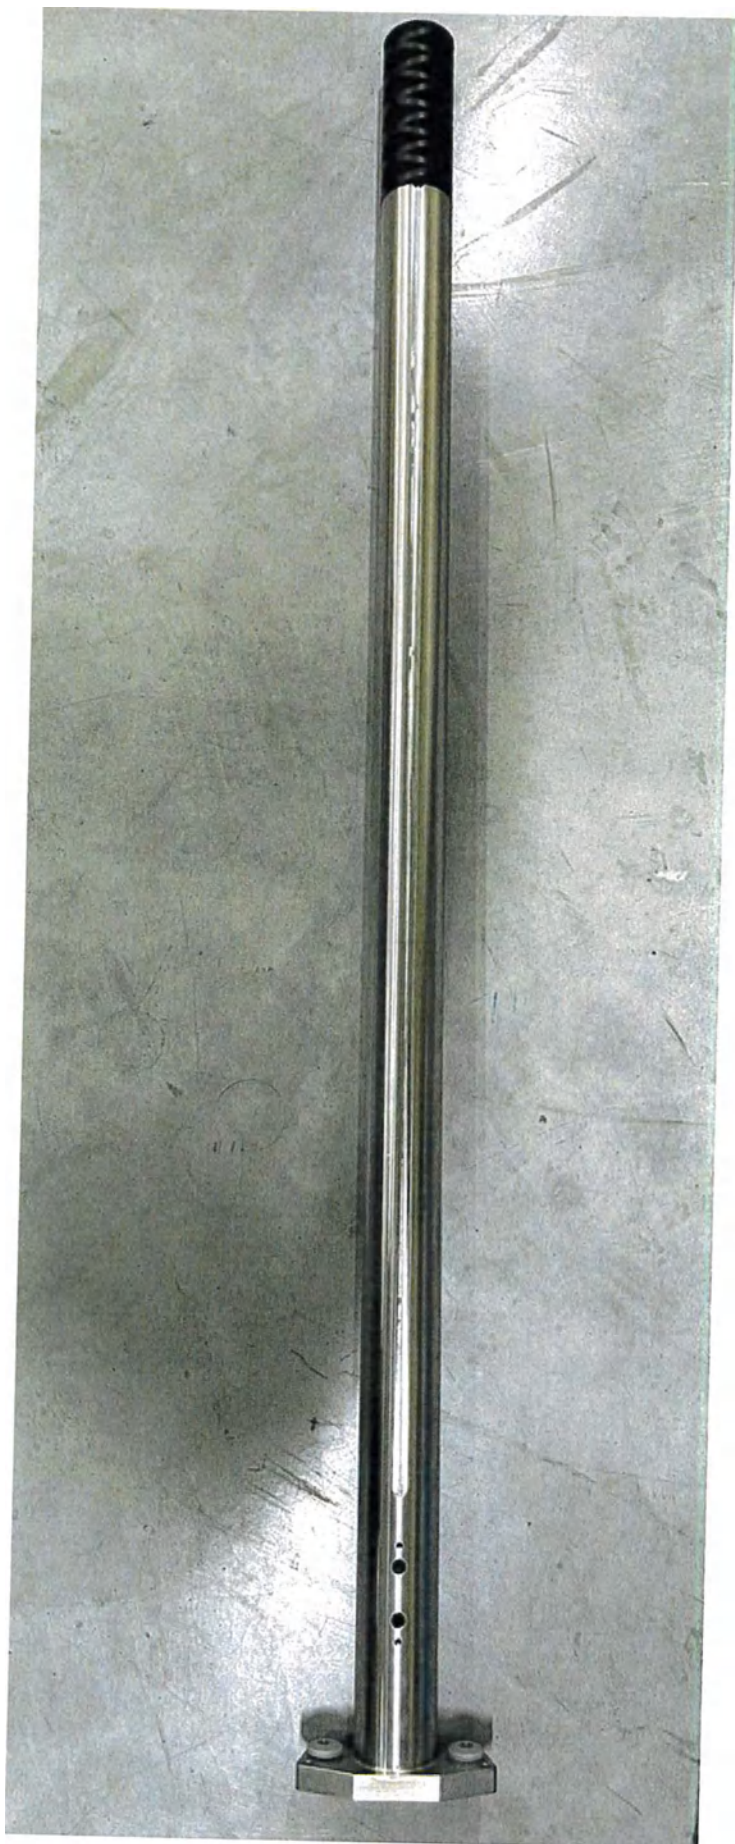


32.4 Держатель лотка

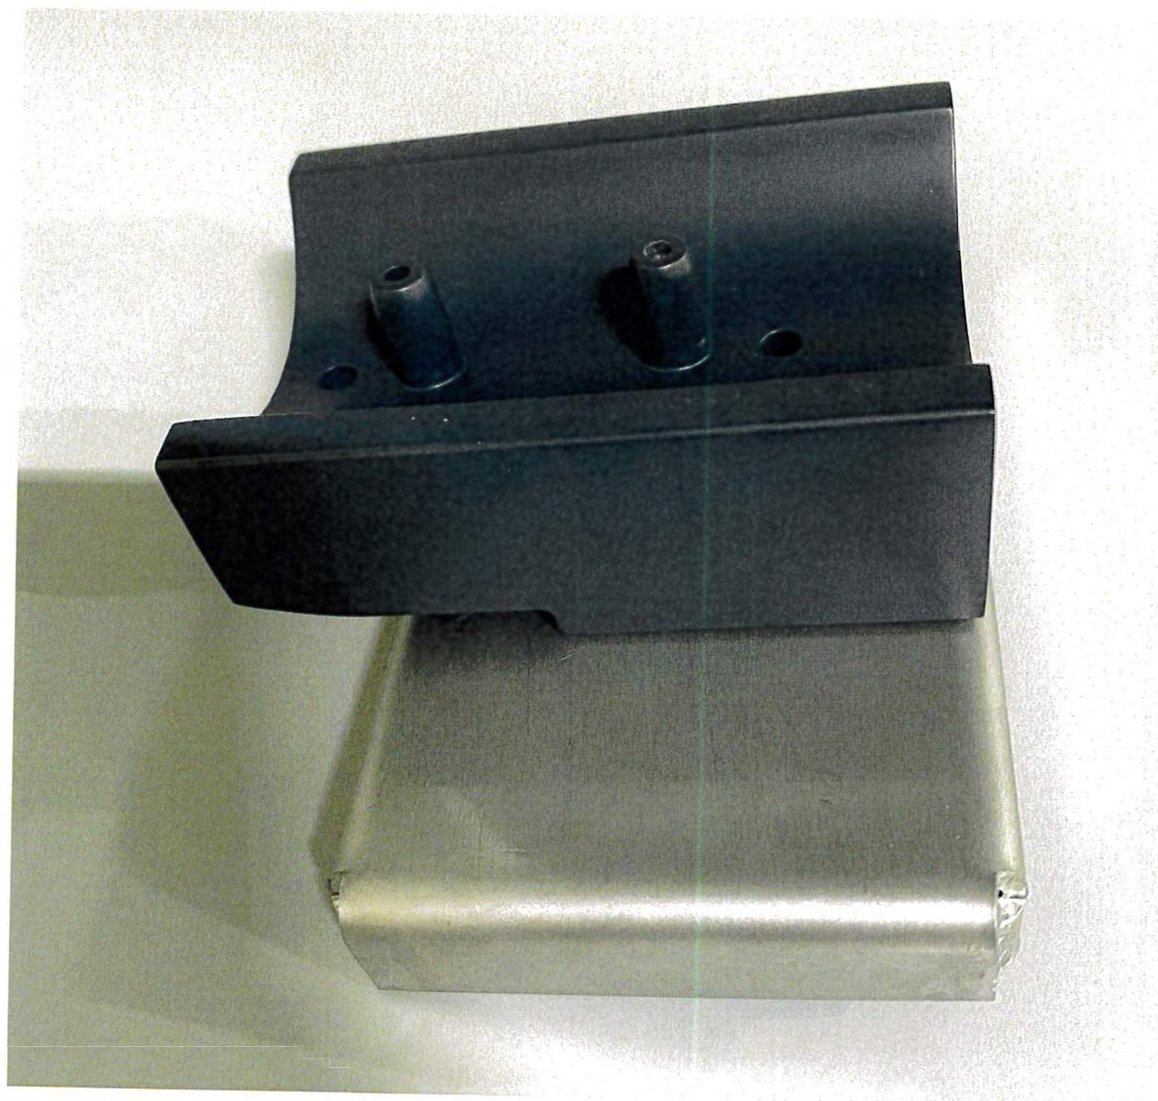

32.5 Лоток




32.6 Шайба

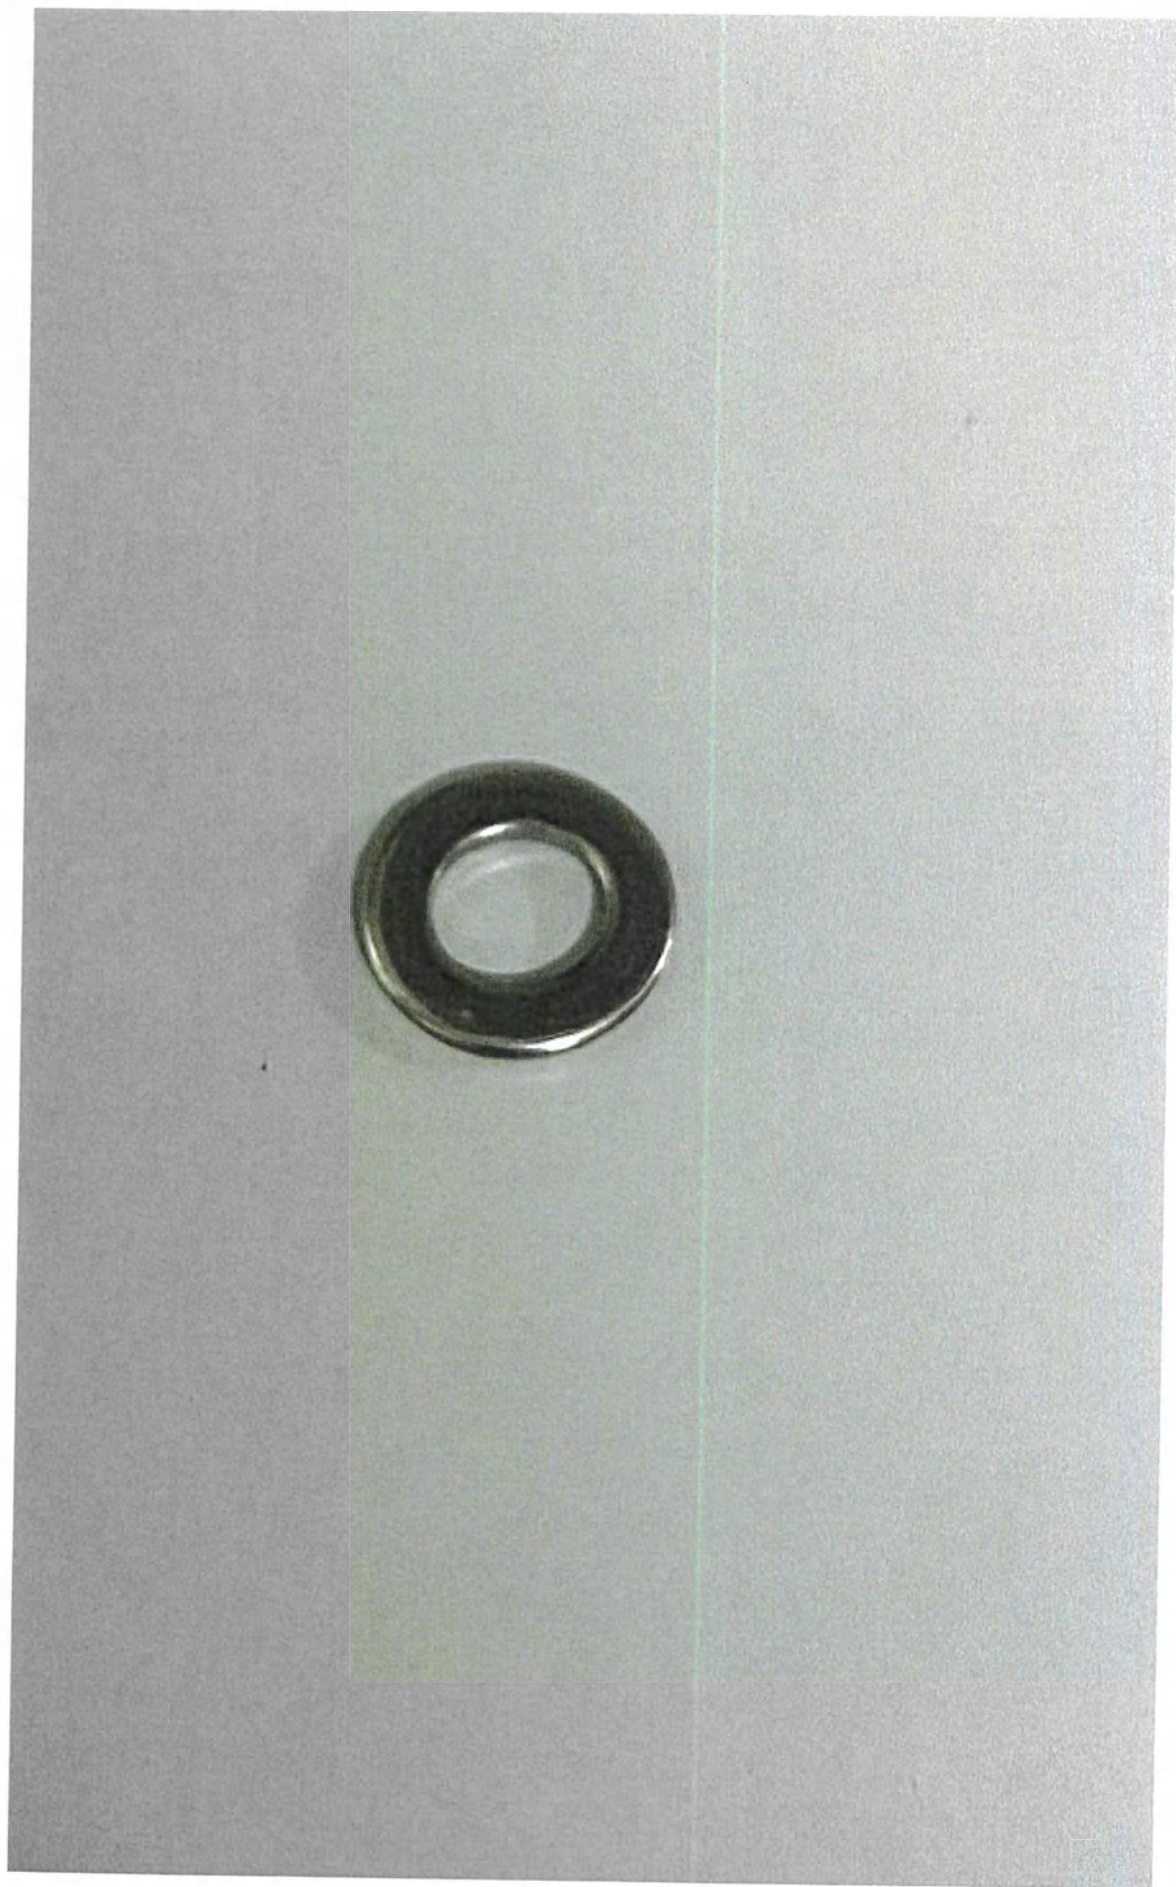

32.7 Пружинная шайба



32.8 Винт М4Х12

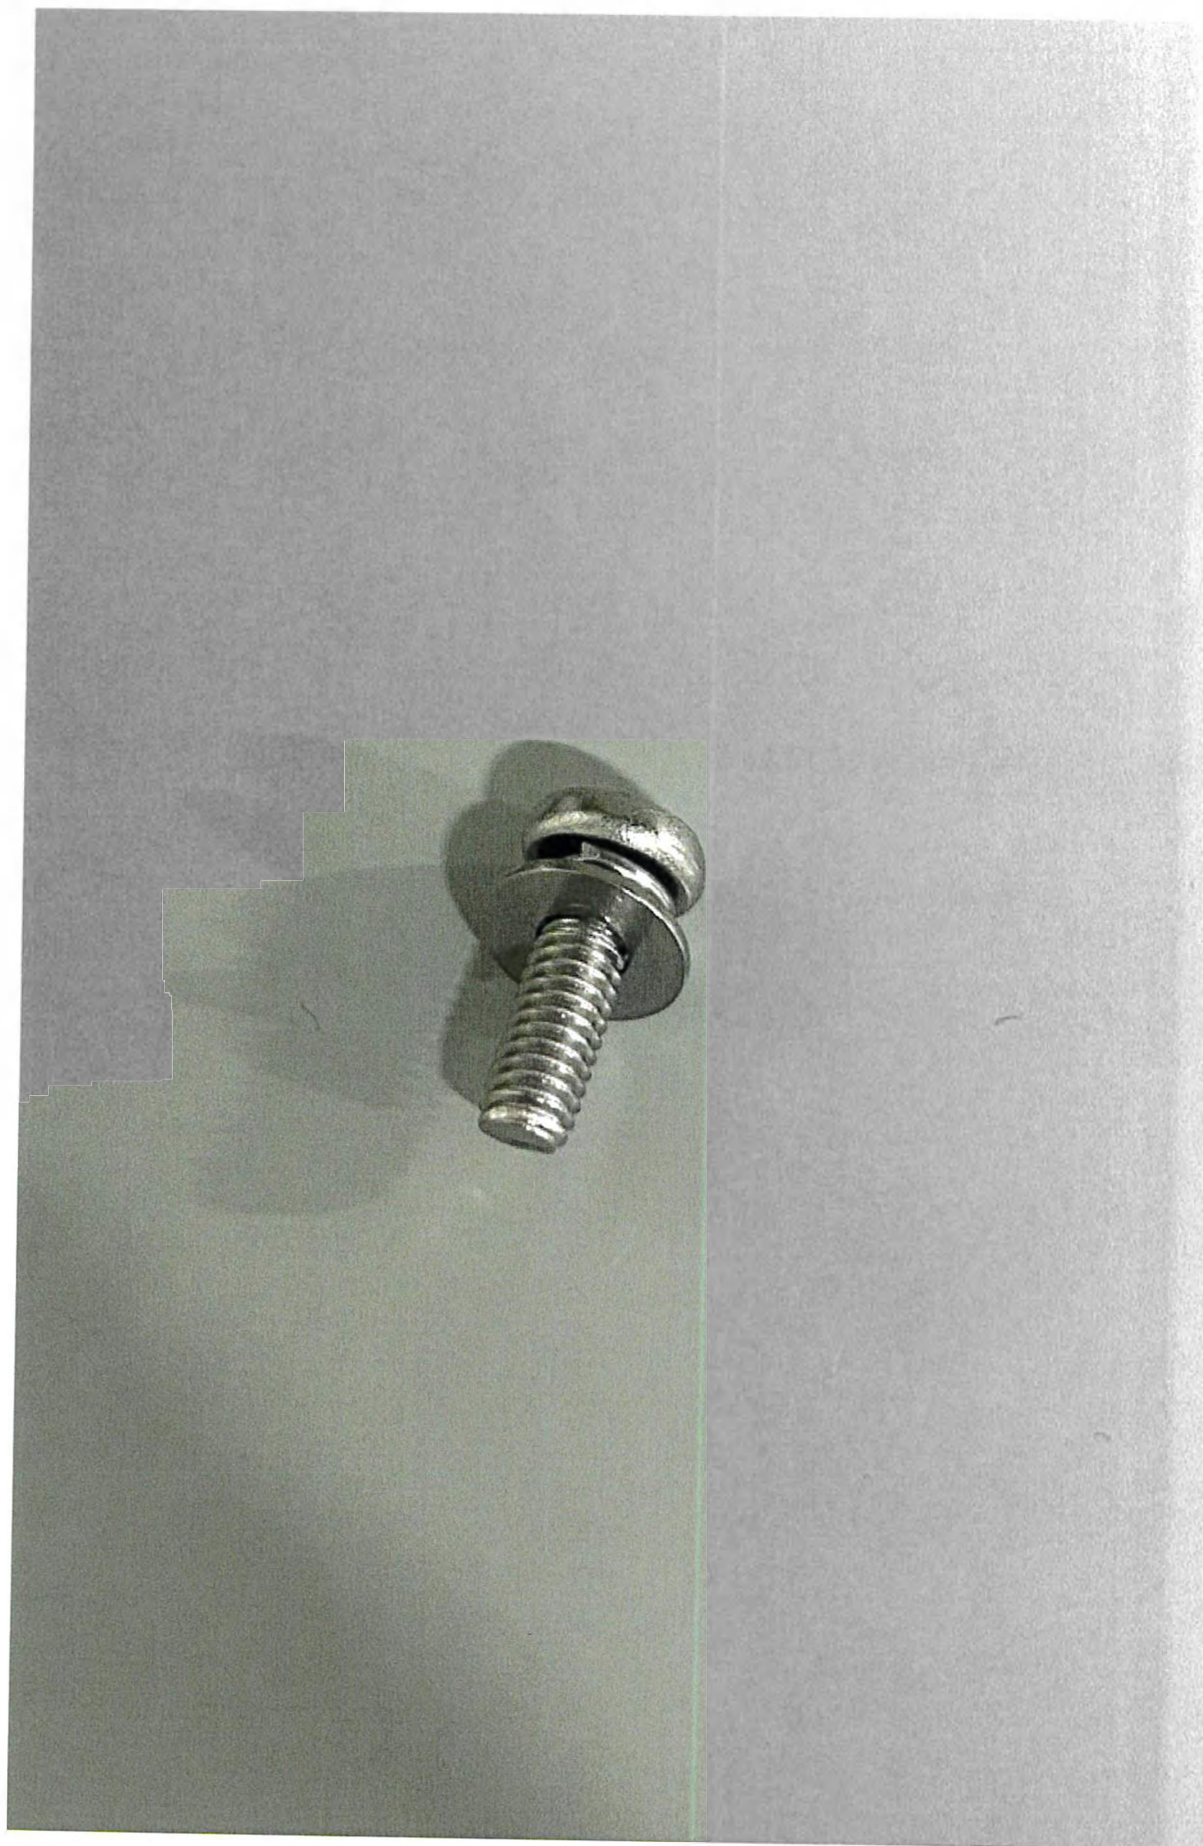

32.9 Винт шестигранный М6Х40



32.10 Защитная крышка



32.11 Маркировка упаковки тележки для генератора магнитного поля.

mindray

物料描述(Name):
Trolley for magnetic field generator

P / N: 
115-064843-00

Ordering No.: 
21385769 370




深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
地址: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层
电话: (0755)26582888 传真: (0755)26582680 邮编: 518057
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057 P.R. China Tel 86-755-26582888 Fax 86-755-26582680

Name: Trolley for magnetic field generator

Наименование: Тележка для генератора
магнитного поля

32.12 Маркировка тележки для генератора магнитного поля наносится на плечо в сборе.

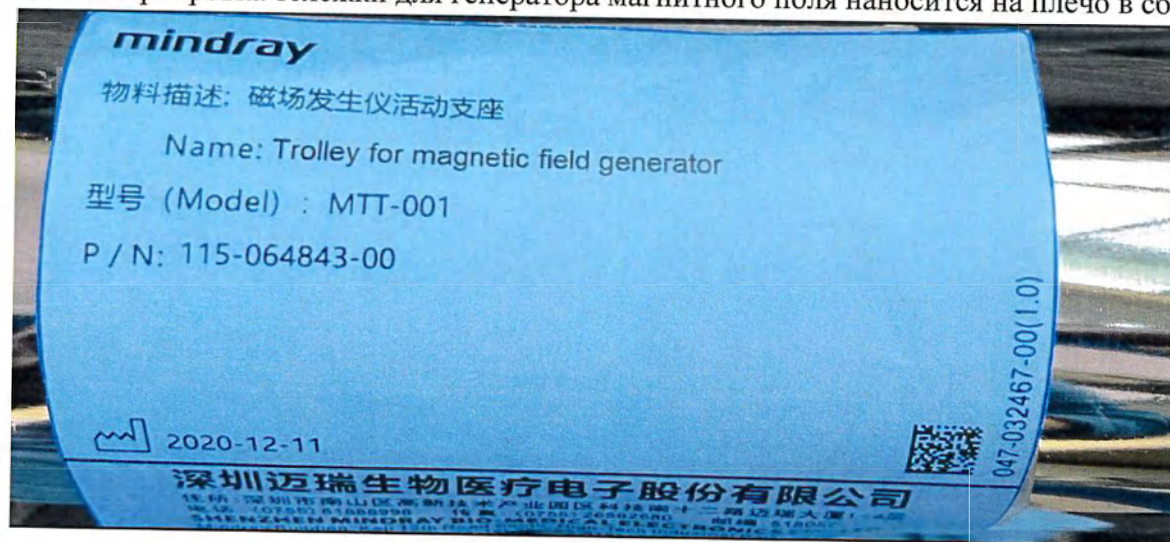


Name: Trolley for magnetic field generator


Наименование: Тележка для генератора
магнитного поля

33. Насадки – держатели для магнитной навигации, варианты исполнения:

33.1.1 Насадка-держатель NB-022 для магнитной навигации для серии датчиков SC6-1

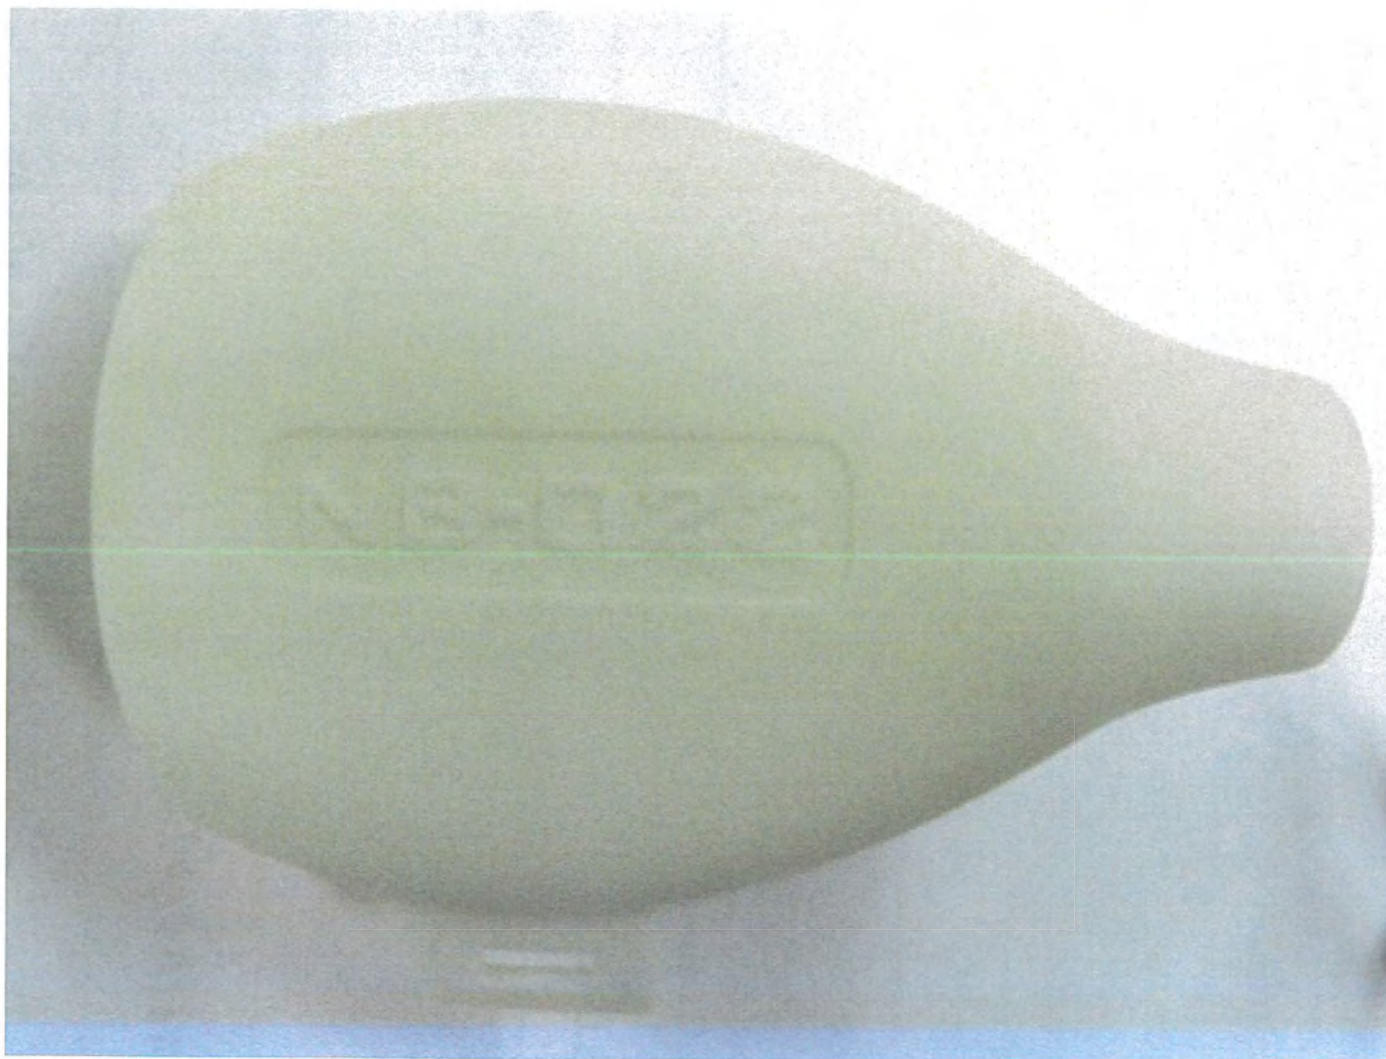

33.1.2 Упаковка

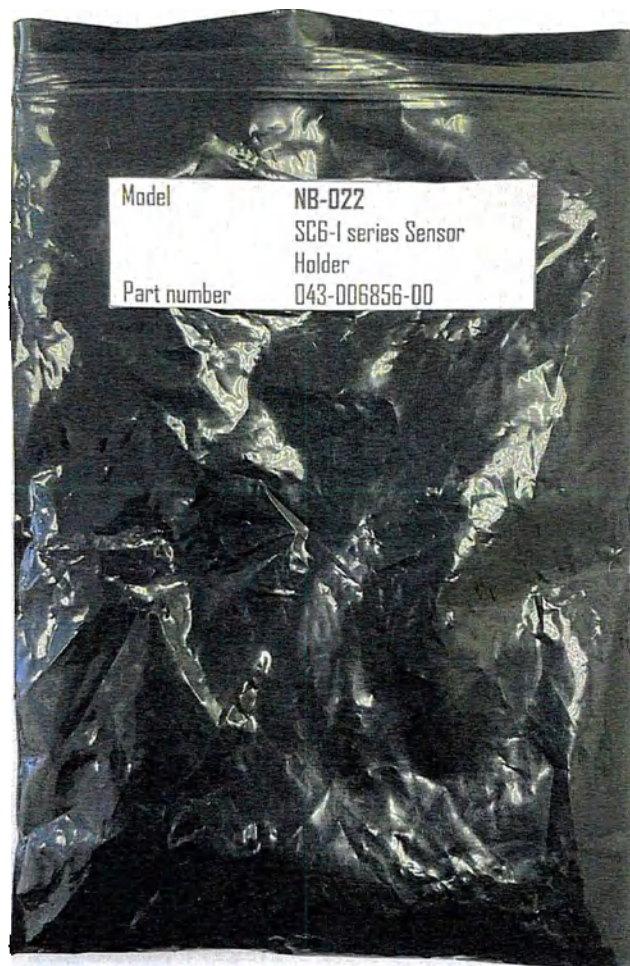


33.2.1 Насадка-держатель NB-024 для магнитной навигации для серии датчиков С6-2G



33.2.2 Упаковка



33.3.1 Насадка-держатель NB-051 для магнитной навигации для серии датчиков ELC13-4

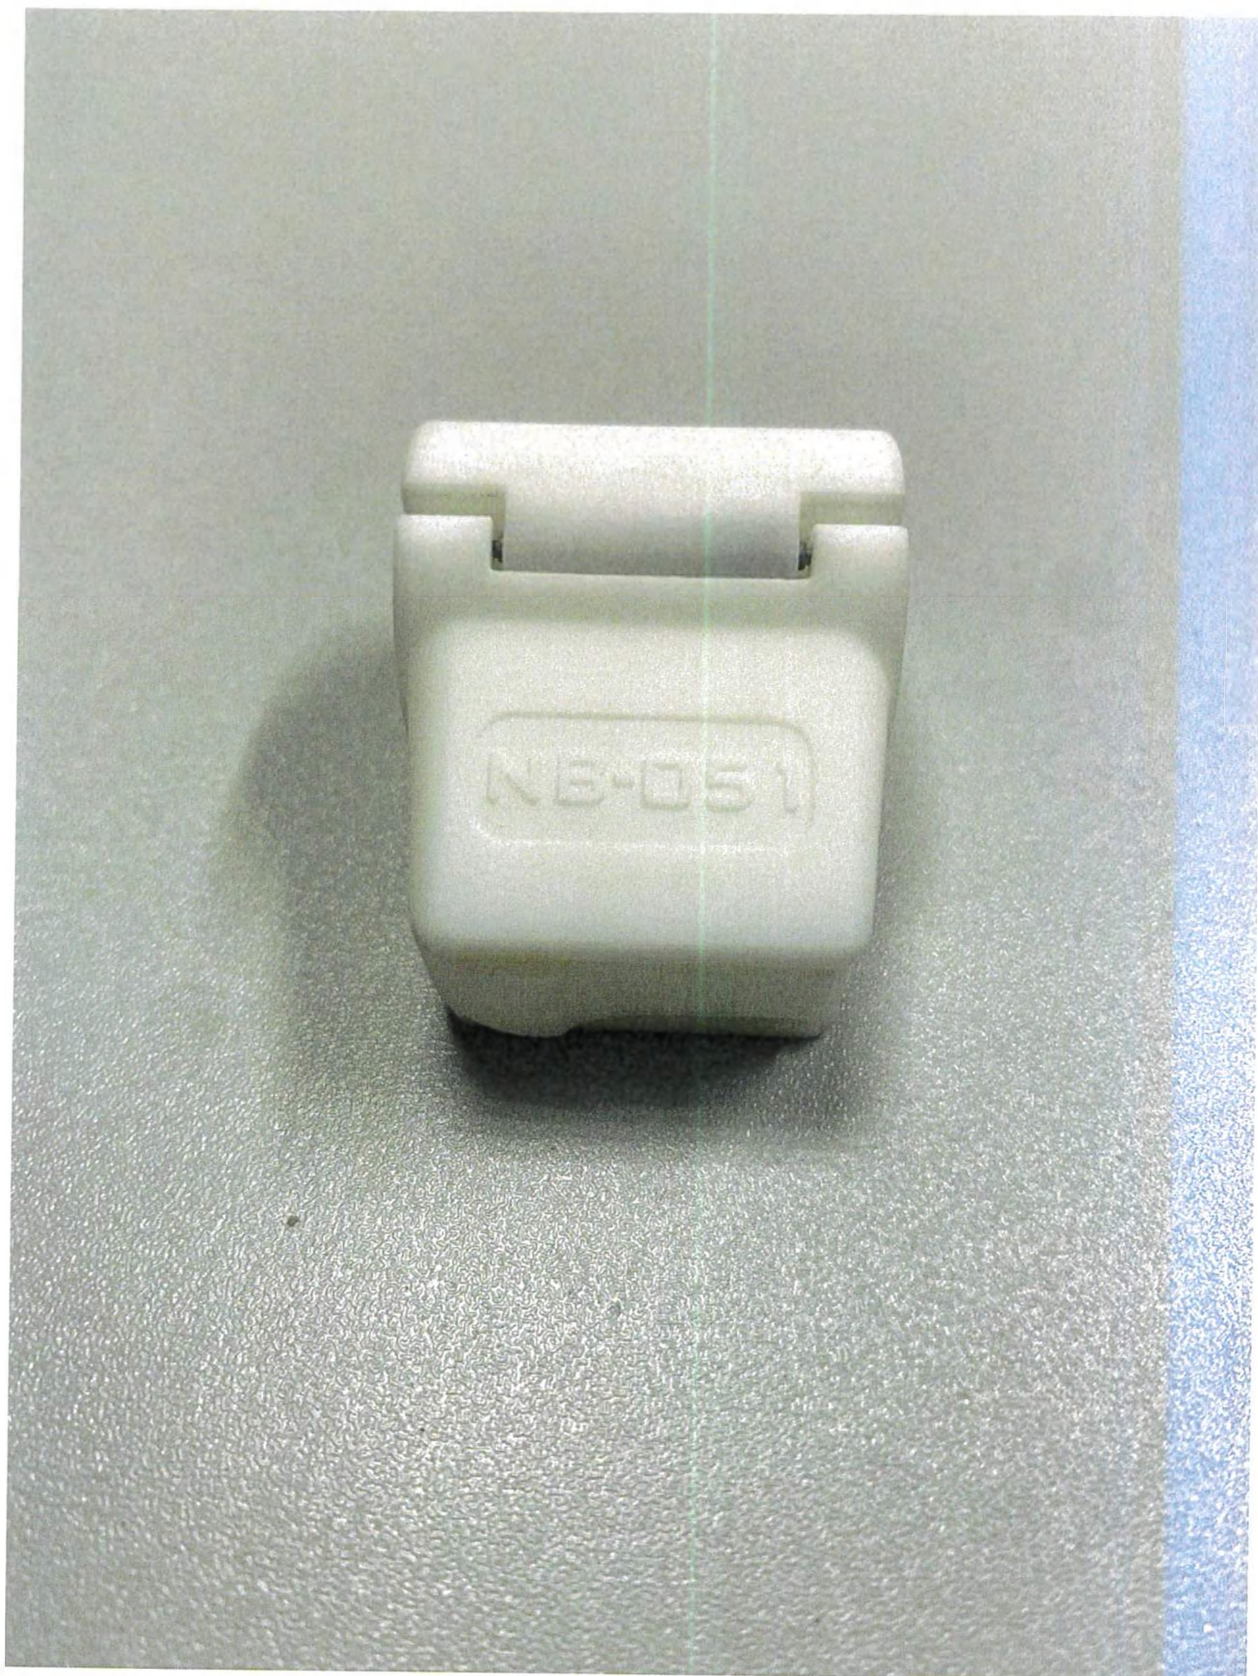

33.3.2 Упаковка




33.4.1 Насадка-держатель NB-054 для магнитной навигации для серии датчиков L14-3W



33.4.2 Упаковка




33.5.1 Насадка-держатель NB-029 для магнитной навигации для серии датчиков SC8-2

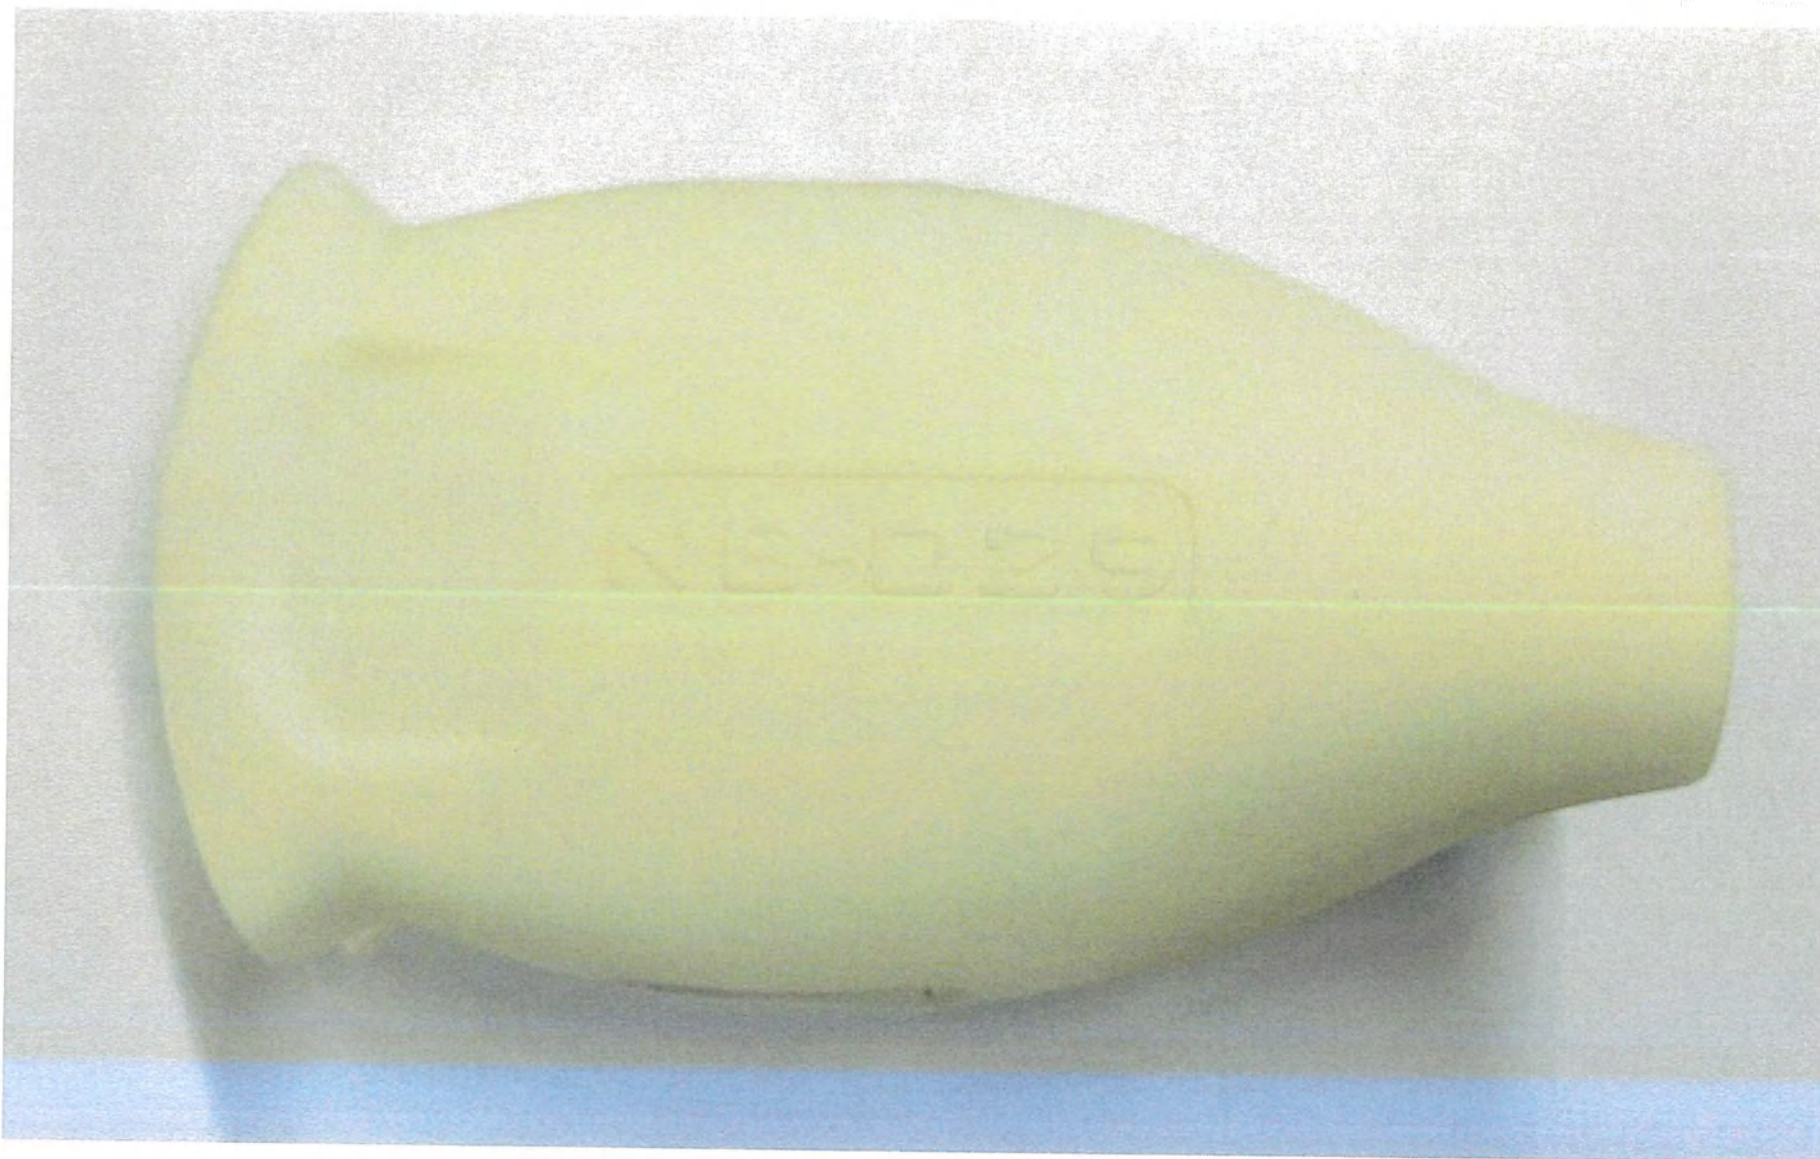

33.5.2 Упаковка



33.6.1 Насадка-держатель NB-011 для магнитной навигации для серии датчиков SP5-1

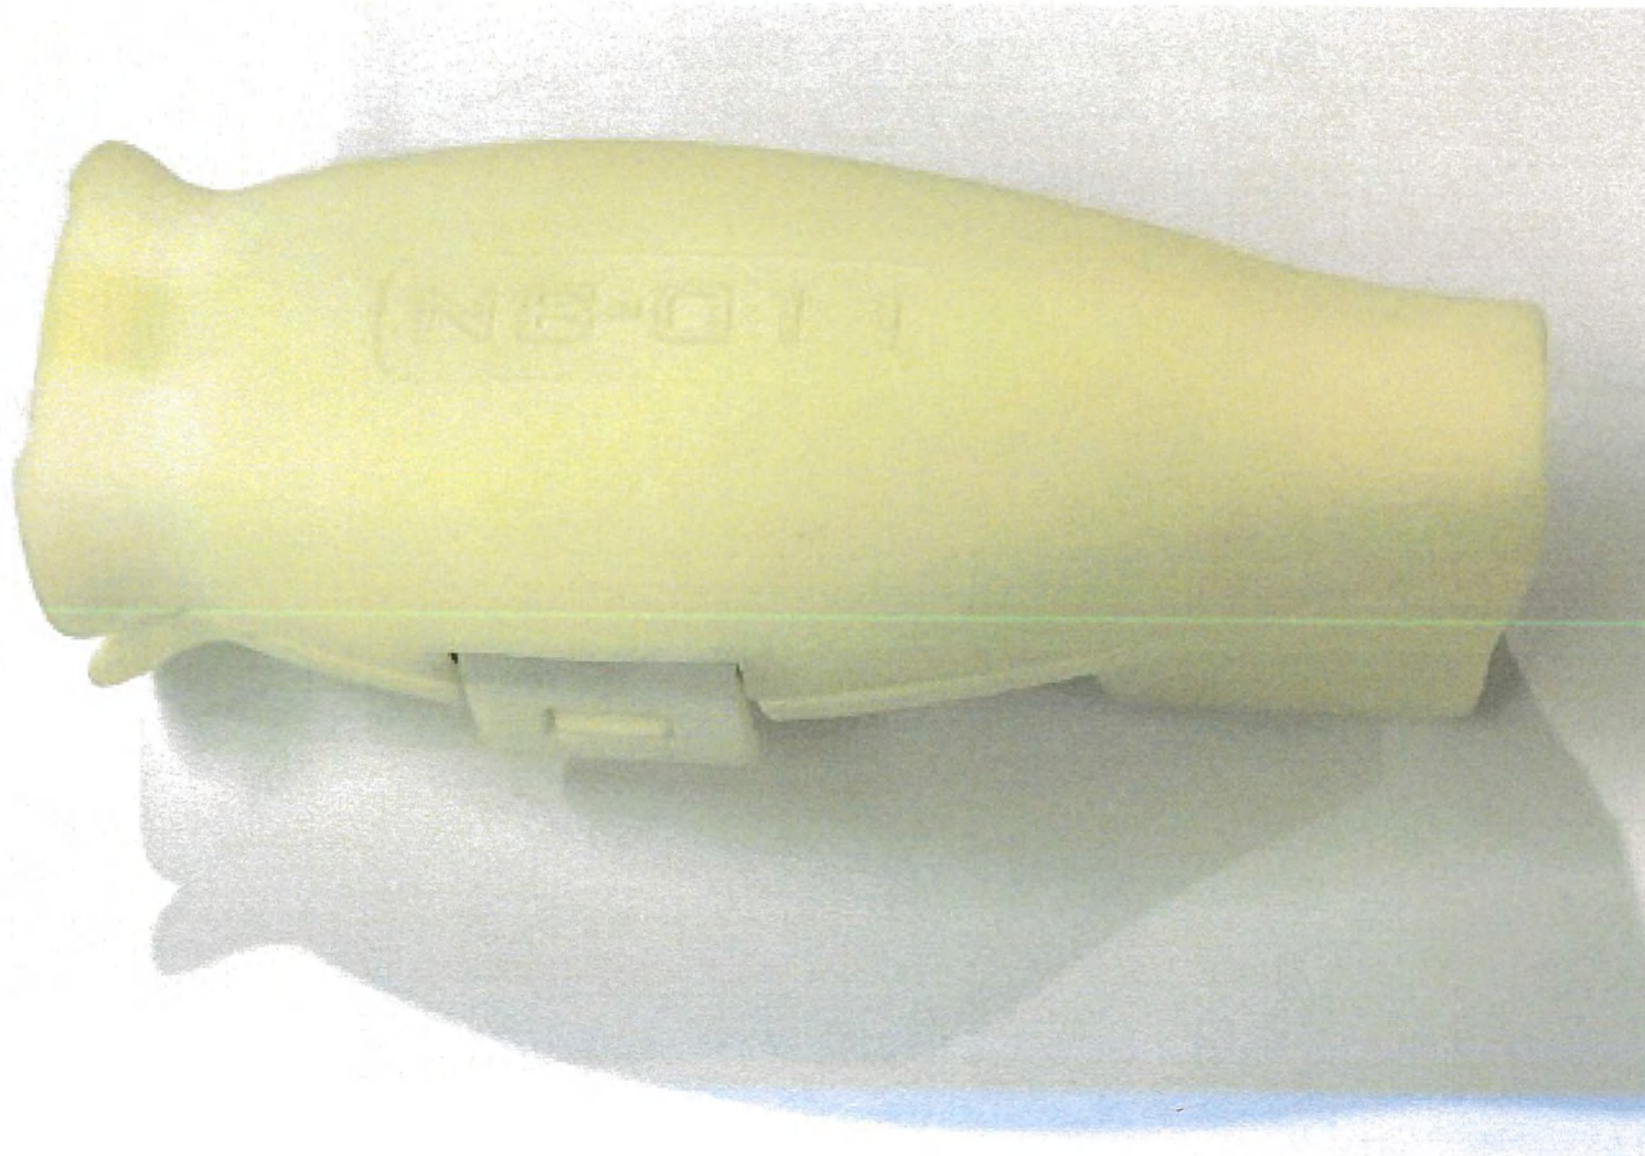

33.6.2 Упаковка



33.7.1 Насадка-держатель NB-025 для магнитной навигации для серии датчиков V11-3Н




33.7.2У паковка



33.8.1 Насадка-держатель NB-053 для магнитной навигации для серии датчиков L13-3N



33.8.2 Упаковка

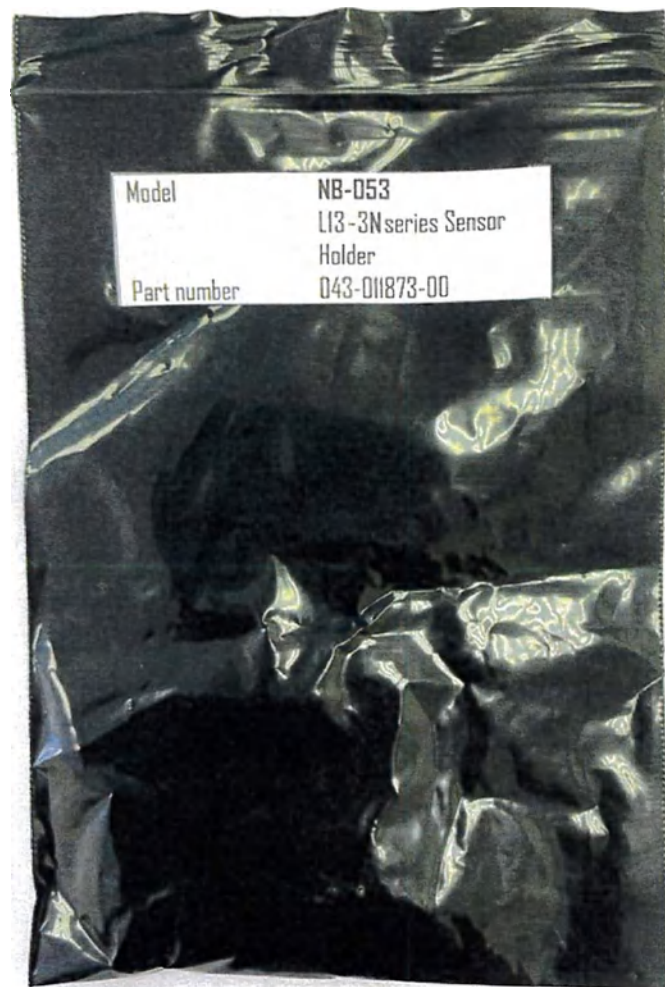

34. Датчики ультразвуковые, варианты исполнения:


34.1 Датчик ультразвуковой микроконвексный С11-3s



Маркировка датчика



C11-3s



W#: 94306947



P/N: 120-021880-00



SN LDK120009



2021-02-01



(01)06936415967758

(11)210201

(21)LDK120009

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.4 kg


G.W.: 1.6 kg

Qty.: 1

Size: 450mmx280mmx80mm

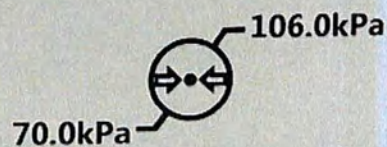

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel :+86-755-81888998 Fax :+86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made In China

34.2. Датчик ультразвуковой конвексный С6-2Gs.



Маркировка датчика

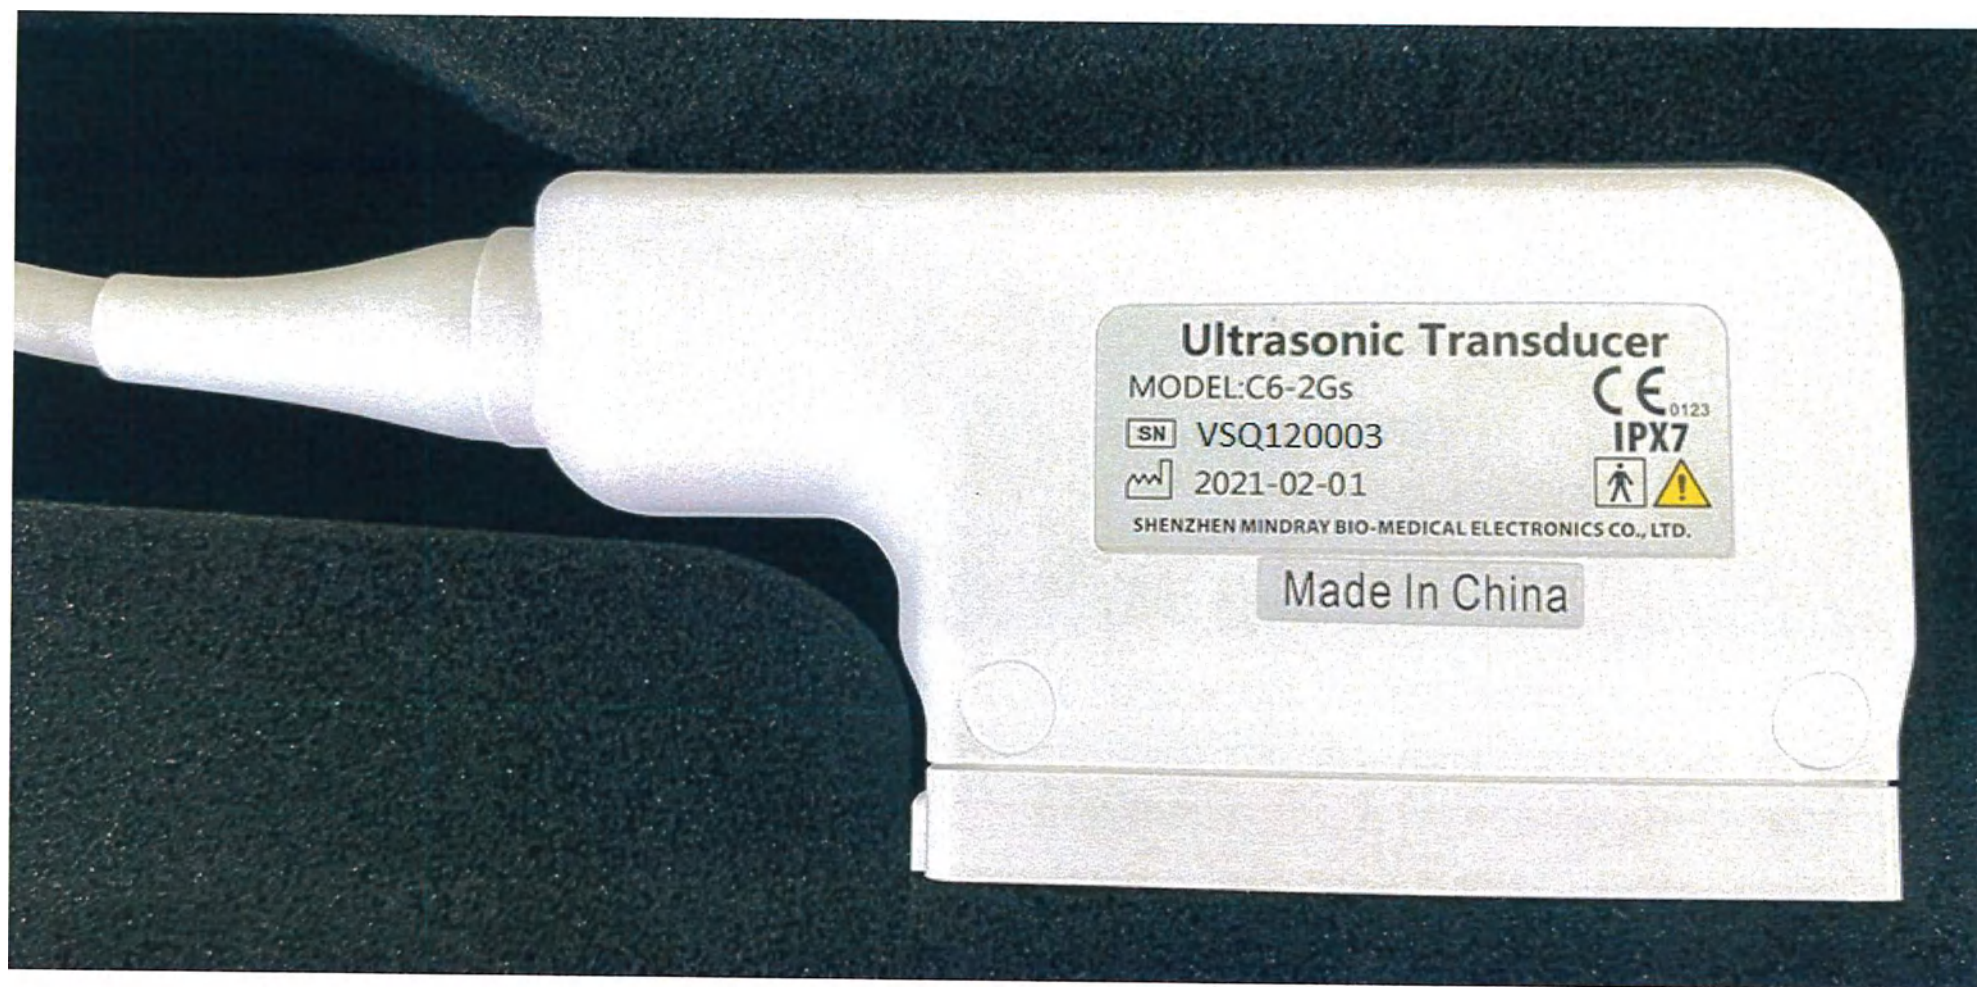

Маркировка упаковки датчика

C6-2Gs



W#: 94306948



P/N: 120-021897-00



SN VSQ120003



2021-02-01



(01)06936415967833

(11)210201

(21) VSQ120003

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.6 kg

G.W.: 1.9 kg

Qty.: 1


Size: 450mmx280mmx80mm

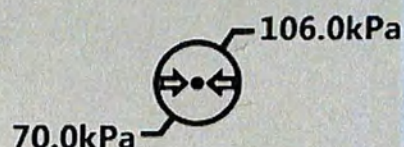

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel :+86-755-81888998 Fax :+86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)


Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made In China


34.3.1 Датчик ультразвуковой карандашный CW2s:

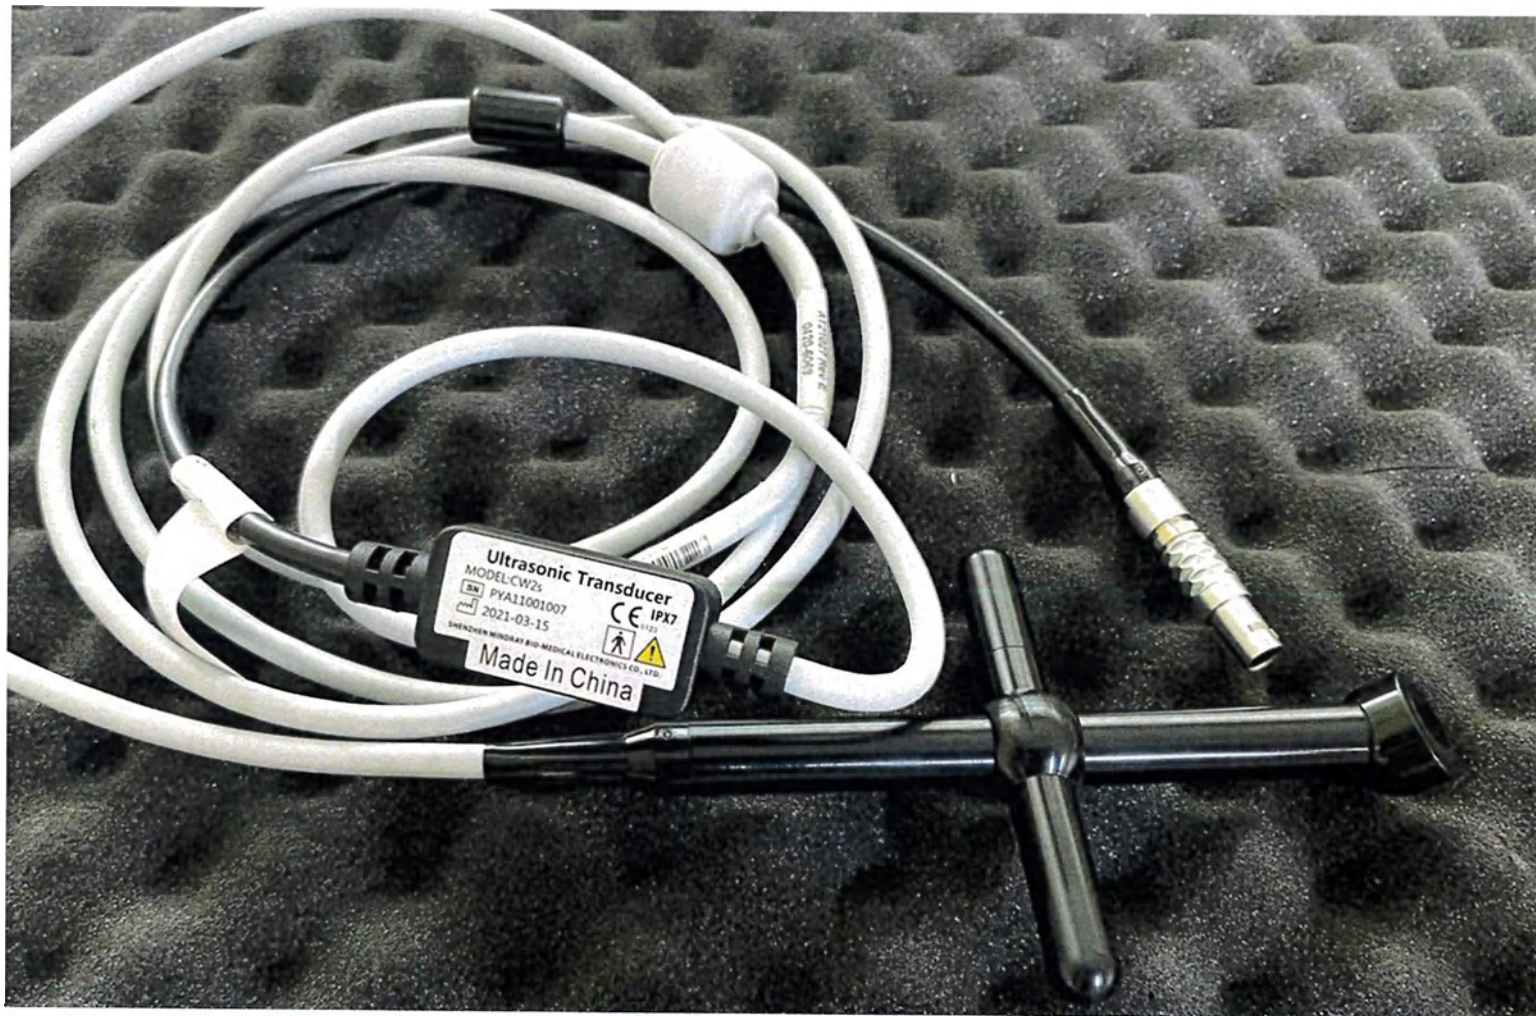

34.3.1 Вставка для держателя для датчика

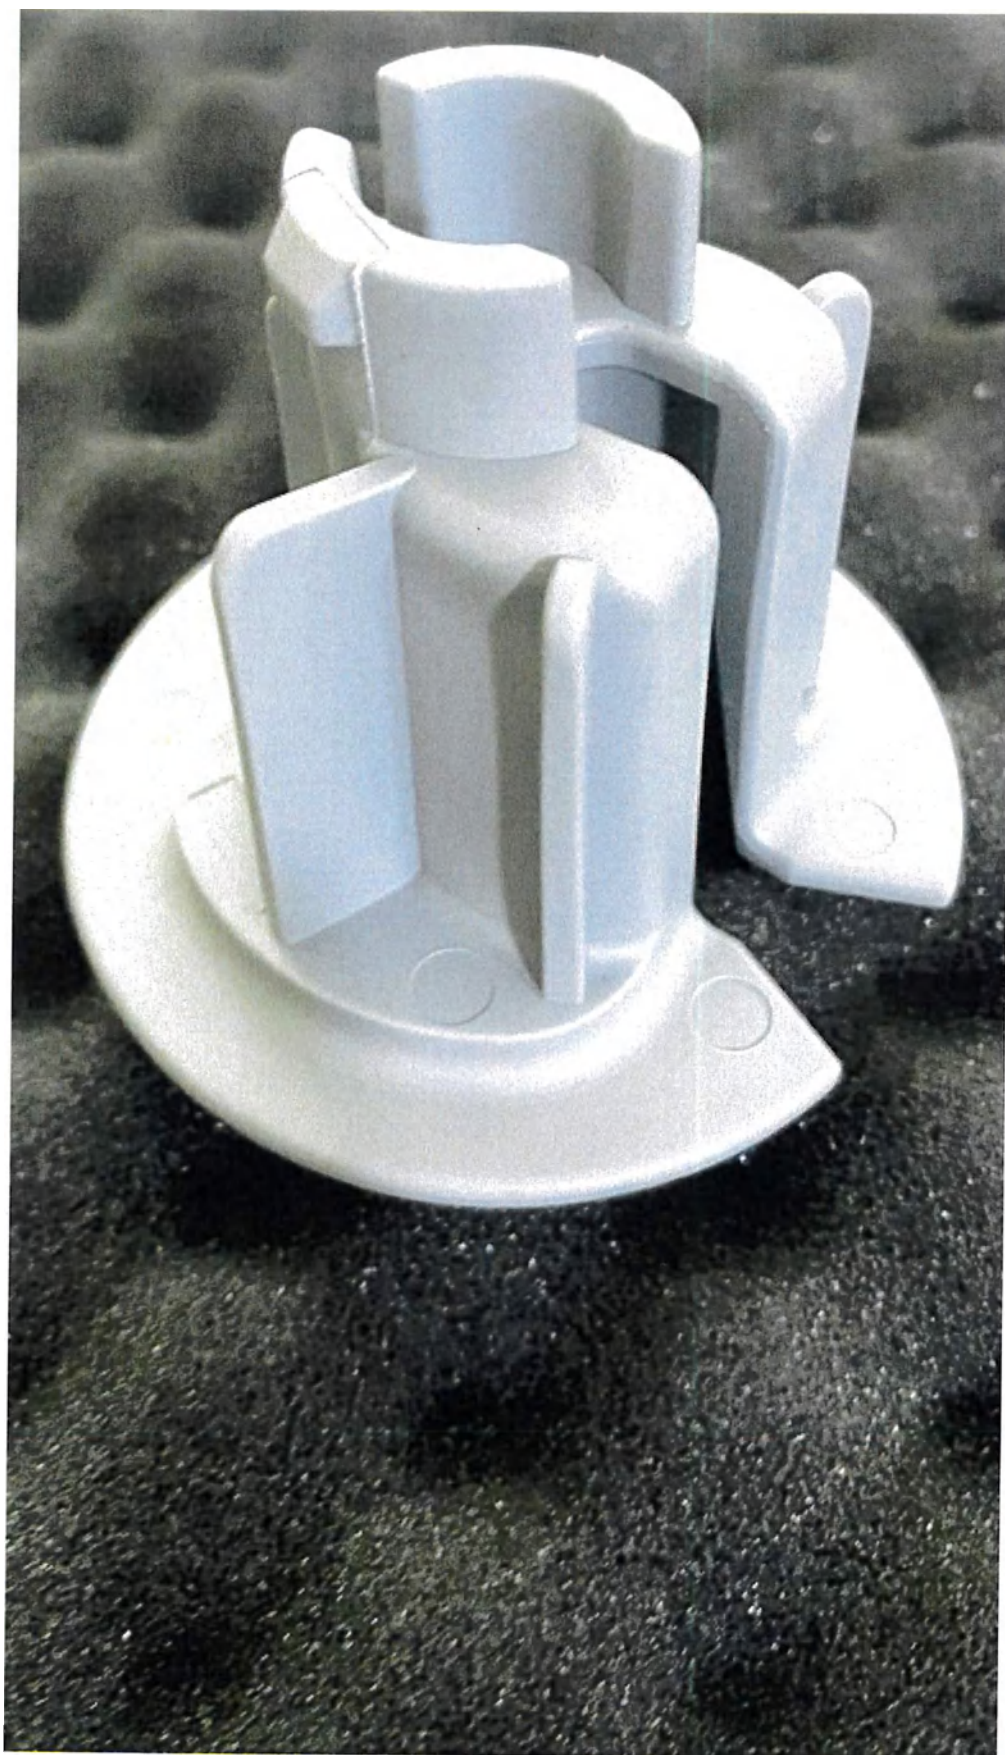

Маркировка датчика

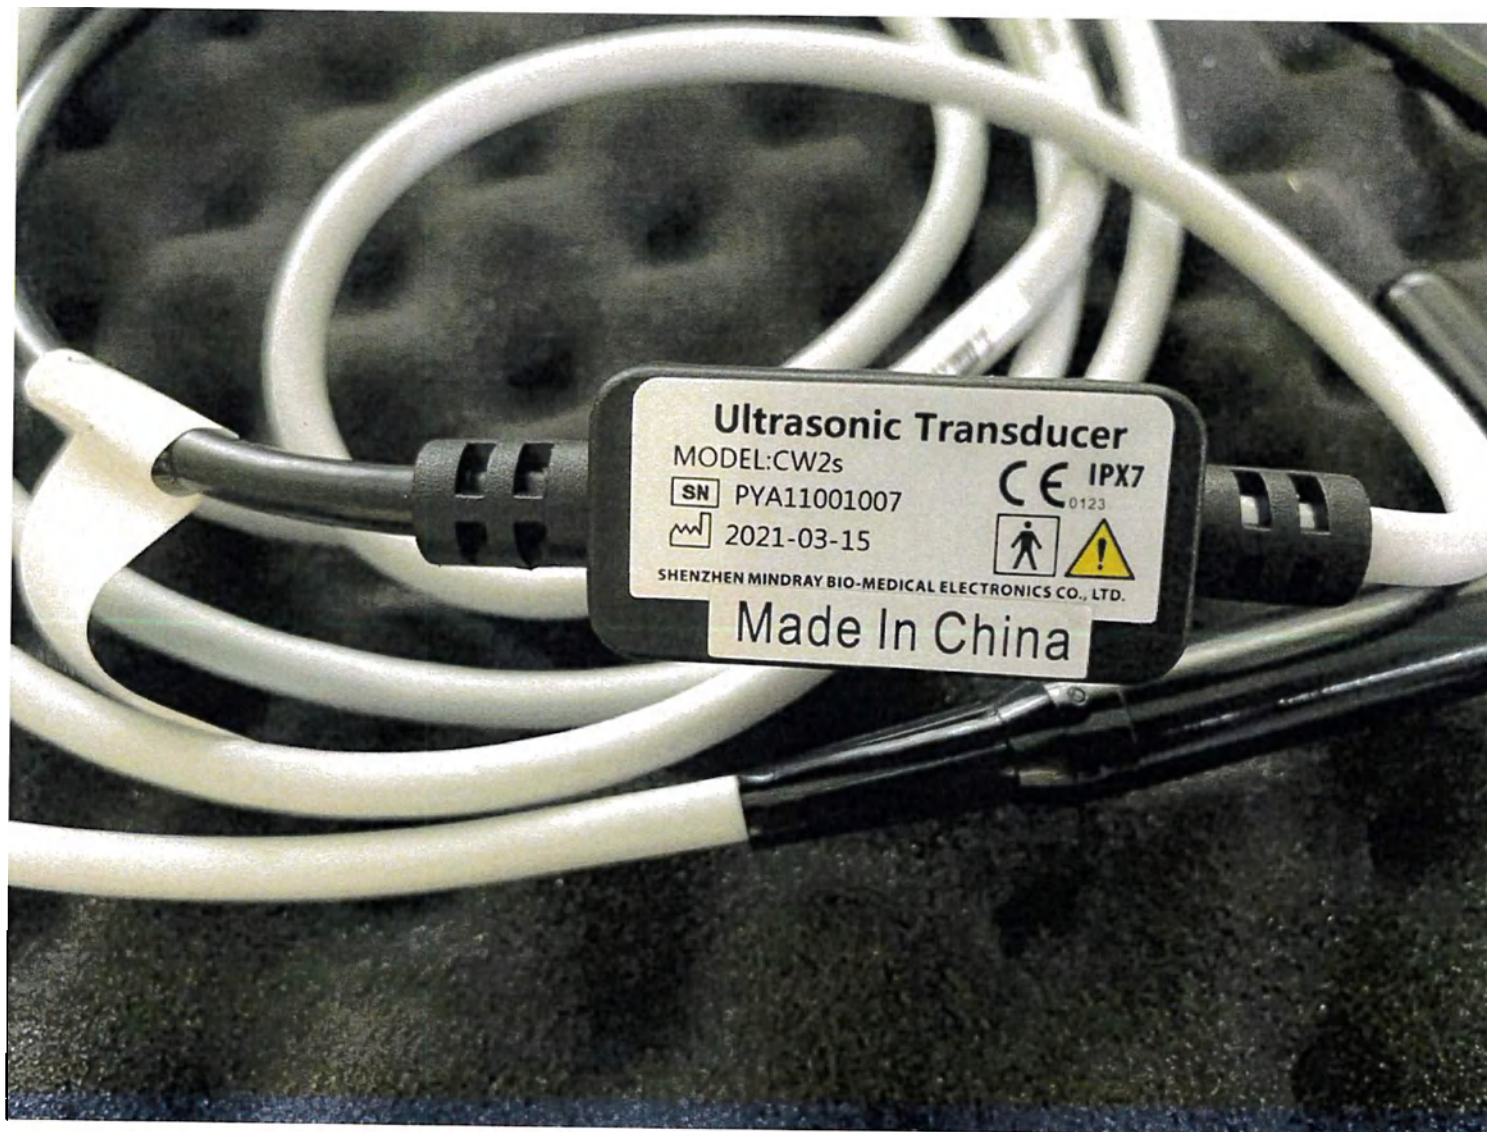

Маркировка упаковки датчика

Ultrasonic Transducer

mindray

Model: CW2s

Size: 470mmx290mmx82mm


Qty.: 1 N.W.: 0.6 kg G.W.: 1.1 kg



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel.: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



SN



PYA11001007



2021-03-15

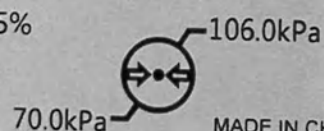

MADE IN CHINA



(01)06944904051246

(11)210315

(21)PYA11001007

W#:



94306954

P/N:



120-001445-00



0123



047-027962-00(2.0)

34.4 Датчик ультразвуковой карандашный CW5s, в составе:

34.4.1 Датчик ультразвуковой карандашный



1.5

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Resona I9 с принадлежностями, варианты исполнения основного блока: Resona I9 Easi

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика

Страна происхождения:

Китай

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А

Тел. +7 (499) 553-60-36

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

**ТОЛЬКО ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ**



1.6

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Resona I9 с принадлежностями, варианты исполнения основного блока: Resona I9 Nasa

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика

Страна происхождения:

Китай

Уполномоченный представитель в РФ:


ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А

Тел. +7 (499) 553-60-36

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

**ТОЛЬКО ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ**



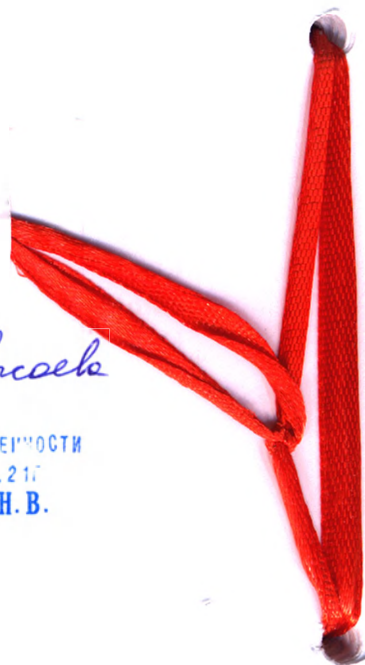

Сысоев

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
19.05.2017
СЫСОЕВ Н.В.