

Фотографические изображения медицинского изделия

**Электростимулятор чрескожный универсальный
БиоТЭНС**

по ТУ 26.60.13-030-44148620-2021

Электростимулятор чрескожный универсальный БиоТЭНС
по ТУ 26.60.13-030-44148620-2021 в составе:



Электростимулятор чрескожный универсальный БиоТЭНС
по ТУ 26.60.13-030-44148620-2021 (вид со стороны электрода)




**Электростимулятор чрескожный универсальный БиоТЭНС
по ТУ 26.60.13-030-44148620-2021 (вид со стороны экрана)**




Электростимулятор чрескожный универсальный БиоТЭНС
по ТУ 26.60.13-030-44148620-2021 (открытый батарейный отсек)



Электростимулятор чрескожный универсальный БиоТЭНС
по ТУ 26.60.13-030-44148620-2021 (кабель соединительный)

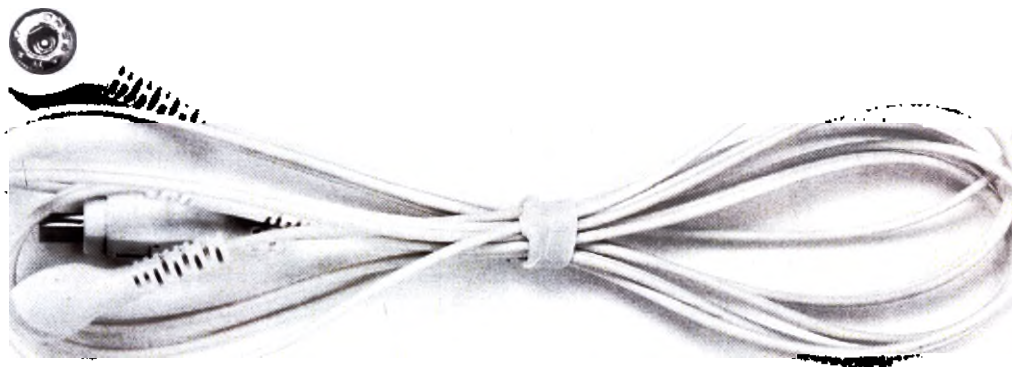

**Электростимулятор чрескожный универсальный БиоТЭНС
по ТУ 26.60.13-030-44148620-2021 (электроды самоклеящиеся)**

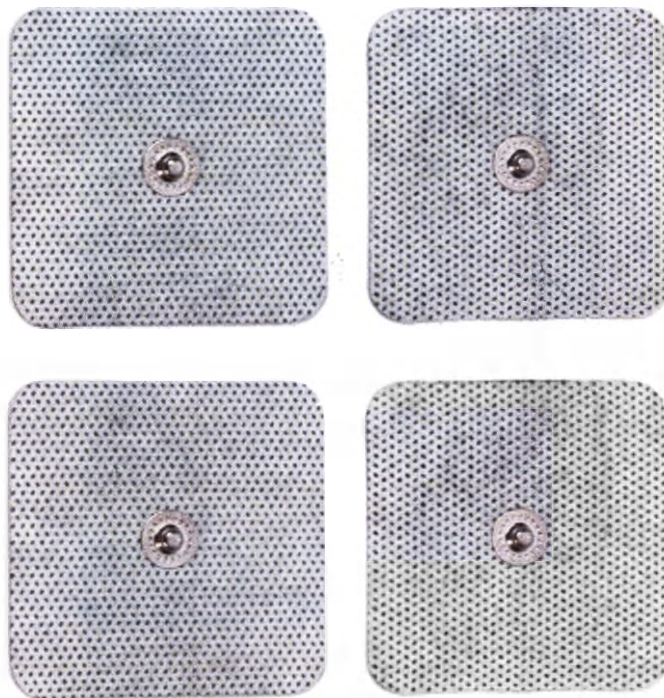

Электростимулятор чрескожный универсальный БиоТЭНС по ТУ 26.60.13-030-44148620-2021 (потребительская тара)



Элемент питания LR03/AAA, 1,5 В, 2 шт.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
9 (девять) листов
цифрами
Ген. директор ООО «ТРОНИТЕК»
С. Ю. Рязкин
« 18 » август 2021 г. М.П.





Общество с ограниченной ответственностью «ТРОНИТЕК»
(ООО «ТРОНИТЕК»)
620147, г. Екатеринбург, ул. Академика Постовского, 15
тел./факс: (343) 216-60-26; (343) 267-23-30
www.tronitek.ru, info@tronitek.ru
ИНН 6661060144, КПП 667101001, ОГРН 1026605232334
р/с 40702810204000039191 в Уральском филиале
АО «Райффайзенбанк» г. Екатеринбург
к/с 30101810100000000906, БИК 046577906

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ТРОНИТЕК»



 С.Ю. Рявкин
«05» июля 2021 г.

Электростимулятор чрескожный универсальный БиоТЭНС
по ТУ 26.60.13-030-44148620-2021

Проекты маркировок медицинского изделия

Проект маркировки, наносимый на аппарат, размер 40x30 мм:



Рисунок 1 – Этикетка внешняя 1 ТРПК 30.0-03.20-01 ЭТ

Проект маркировки, наносимый в батарейный отсек, размеры 35x20 мм:




Рисунок 2 – Этикетка в батарейный отсек ТРПК 30.0-03.21-01 ЭТ

Проект маркировки, наносимый в паспорт, размер 22x9 мм:




Рисунок 3 – Этикетка в паспорт ТРПК 23.0-03.23-01 ЭТ

Проект маркировки, наносимый на потребительскую тару, размер 20x10 мм



Рисунок 4 – Этикетка «Дата» РЦ АРТ 90.0-03.20-01

Поле «Серийный номер» этикеток ТРПК 30.0-03.20-01 ЭТ и ТРПК 23.0-03.23-01 ЭТ заполняются при заказе каждой партии в формате «AAA-000»

Поле «Дата изготовления» этикеток ТРПК 23.0-03.23-01 ЭТ, ТРПК 30.0-03.20-01 ЭТ и РЦ АРТ 90.0-03.20-01 заполняется при заказе каждой партии в формате «ММ.ГГГГ» (например, «07.2021»).

Проект маркировки потребительской тары электростимулятора чрескожного универсального БиоТЭНС



Проект маркировки верхней части потребительской тары:



 **ООО «ТРОНИТЕК»**
620147, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Академика Постовского, 15
+7 (343) 267-23-30
mail@tronitek.ru
tronitek.ru

Система управления качеством
предприятия соответствует
требованиям международного
стандарта ISO 13485

Сделано в России



Масса:
нетто 110±15 г
брутто 350±50 г

Габаритные
размеры:
195±5 x 60±5 x 35±5 мм

Срок службы – 3 года, гарантийный срок хранения – 2 года,
гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Оберегайте изделие от механических ударов и попадания влаги

Для очистки поверхности изделия от загрязнений используйте
стандартные средства дезинфекции и мягкие салфетки
без ворса

БиоТЭНС

Электростимулятор
чрескожный универсальный

Предназначен для нейроподобной динамической
электростимуляции (НЕЙРОДЭНС) в широком
диапазоне частот с возможностью применения
предустановленных автоматизированных программ
или подбора индивидуальной программы лечения

Электростимулятор чрескожный универсальный БиоТЭНС

предназначен для нейроподобной динамической электростимуляции (НЕЙРОДЭНС) в широком диапазоне частот, с возможностью применения предустановленных автоматизированных программ или подбора индивидуальной программы лечения.

Электрод выносной самоклеящийся
для электростимулятора чрескожного универсального БиоТЭНС
ТУ 26.60.13-030-44148620-2021



Поставщик
«AS-TEC GROUP
LIMITED» 8E Xinbaoyi Industrial
Zone, Houting Village, Shajing Baoan,
Shenzhen, China

Количество 4 шт

Габариты
 $50 \pm 1 \times 50 \pm 1$ мм

По заказу:

Масса 5 ± 2 г

ООО «ТРОНИТЕК»

Срок хранения

620147, Россия,

2 года

Г. Екатеринбург,

Ул. Академика Постовского, 15,


Телефон: +7 (343) 267-23-30

mail: mail@tronitek.ru

www.tronitek.ru



ММ. ГТГГ

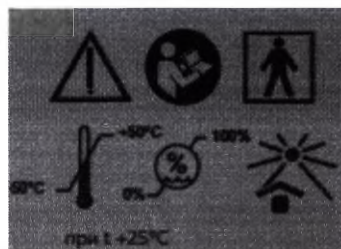

Проект маркировки, наносимой при поставке электродов самоклеящихся

Кабель соединительный
для электростимулятора чрескожного универсального
БиоТЭНС
ТУ 26.60.13-030-44148620-2021



Изготовитель

Габариты

ООО «ТРОНИТЕК»

140 ± 5 см

620147, Россия,

Масса 20 ± 2 г

г. Екатеринбург,

Ул. Академика Постовского, 15,

Телефон: +7 (343) 267-23-30

Срок хранения


mail: mail@tronitek.ru

2 года

www.tronitek.ru



ММ. ГТГГ



Проект маркировки, наносимой при поставке кабеля соединительного

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
6 (шесть) лист
цифрами

Ген. директор ООО «ТРОНИТЕК»
С. Ю. Рявкин
2021 г. М.П.

